核技术利用建设项目

常州市第一人民医院
新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目
环境影响报告表

常州市第一人民医院

2024 年 3 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

常州市第一人民医院
新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目
环境影响报告表

建设单位名称：常州市第一人民医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：常州市局前街 185 号

邮政编码：213000　　联系人：

电子邮箱　　联系电话

目　录

表 1　项目基本情况 ..... - 1 -
表 2　放射源 ..... - 5 -
表 3　非密封放射性物质 ..... - 5 -
表 4　射线装置 ..... - 6 -
表 5　废弃物（重点是放射性废弃物） ..... - 7 -
表 6　评价依据 ..... - 8 -
表 7　保护目标与评价标准 ..... - 11 -
表 8　环境质量和辐射现状 ..... - 21 -
表 9　项目工程分析与源项 ..... - 27 -
表 10　辐射安全与防护 ..... - 37 -
表 11　环境影响分析 ..... - 43 -
表 12　辐射安全管理 ..... - 61 -
表 13　结论与建议 ..... - 66 -
表 14　审批 ..... - 72 -
附图 1 常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目地理位置示意图 ..... - 73 -
附图 2 常州市第一人民医院平面布置和周围环境示意图 ..... - 74 -
附图 3 常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼核医学科平面布局示意图 ..... - 75 -
附图 6 常州市第一人民医院 9 号楼 4 楼平面布局示意图 ..... - 78 -
附图 7 常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼核医学科工作场所排风管道布设示意图 ..... - 79 -
附图 8 常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼核医学科工作场所专用下水管道布设示意图 ..... - 80 -
附件 1 项目委托书 ..... - 81 -
附件 2 非密封放射性物质、射线装置使用承诺书 ..... - 82 -
附件 3 工作场所屏蔽设计说明 ..... - 81 -
附件 4 辐射安全许可证正副本 ..... - 82 -
附件 5 医院现有核技术利用项目情况一览表 ..... - 94 -
附件 6 辐射环境现状监测报告 ..... - 100 -
附件 7 检测机构资质认定证书 ..... - 106 -
附件 8 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 ..... - 110 -

表 1　项目基本情况

<table>
<tr><td colspan="2">建设项目名称</td><td colspan="7">常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位</td><td colspan="7">常州市第一人民医院
（统一社会信用代码：123204004672858558）</td></tr>
<tr><td colspan="2">法人代表</td><td colspan="2"></td><td>联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册地址</td><td colspan="7">常州市局前街 185 号、99 号、常州市丁香路 16 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设地点</td><td colspan="7">常州市局前街 185 号
（常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼）</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项审批部门</td><td colspan="3">/</td><td>批准文号</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目总投资（万元）</td><td></td><td colspan="2">项目环保总投资（万元）</td><td></td><td>投资比例（环保投资/总投资）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目性质</td><td colspan="4">☐新建 ☐改建 ☑扩建 ☐其他</td><td>占地面积（m^2）</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">应用类型</td><td rowspan="2">放射源</td><td>☐销售</td><td colspan="6">☐Ⅰ类 ☐Ⅱ类 ☐Ⅲ类 ☐Ⅳ类 ☐Ⅴ类</td></tr>
<tr><td>☐使用</td><td colspan="6">☐Ⅰ类（医疗使用）☐Ⅱ类 ☐Ⅲ类 ☐Ⅳ类 ☐Ⅴ类</td></tr>
<tr><td rowspan="3">非密封放射性物质</td><td>☐生产</td><td colspan="6">☐制备 PET 用放射性药物</td></tr>
<tr><td>☐销售</td><td colspan="6">/</td></tr>
<tr><td>☑使用</td><td colspan="6">☐乙　☑丙</td></tr>
<tr><td rowspan="3">射线装置</td><td>☐生产</td><td colspan="6">☐Ⅱ类 ☐Ⅲ类</td></tr>
<tr><td>☐销售</td><td colspan="6">☐Ⅱ类 ☐Ⅲ类</td></tr>
<tr><td>☑使用</td><td colspan="6">☐Ⅱ类 ☑Ⅲ类</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="7">/</td></tr>
</table>

项目概述：

一、建设单位基本情况、项目建设规模及由来

常州市第一人民医院创建于 1918 年，坐落在江南古城常州市中心，经过百年的建设，已发展成为一所科室设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、学术水平较高，集医、教、研为一体的三级甲等综合性医院。医院占地面积近 7.5 万平方米，建筑面积近 32 万平方米。核定床位 2980 张，现实际开放床位 2732 张，年诊疗人次 245.81

万。医院设有45个临床科室、7个医技科室、2个科研机构和1个健康管理中心，现有职工3848人。

为了适应医院发展要求，更好地服务患者，常州市第一人民医院拟将9号楼放疗楼3楼现有放疗科工作场所改建成PET/CT和PET/MRI核医学科工作场所，并新增1台PET/CT（属III类射线装置）和1台PET/MRI。本项目拟使用放射性核素^{18}F配合PET/CT和1台PET/MRI开展核素显像诊断。PET/MRI机房内拟所使用的PET/MRI不属于射线装置，不在评价范围内。

表1-1 本项目放射性核素使用情况一览表

核素	用途	单个病人最大用量（mCi/人•次）	日最大病人量（人）	日最大操作量（Bq）	年工作天数（d）	年最大病人量（人）	年总用量（Bq）
^{18}F	PET/CT显像诊断	10	10	3.7×10^{9}	250	2500	9.25×10^{11}
	PET/MRI显像诊断	10	10	3.7×10^{9}	250	2500	9.25×10^{11}
	源的储存	日最大备药量4×（3.7×10^{9}+3.7×10^{9}）=2.96×10^{10}Bq					

注：考虑到放射性药物的衰变，核医学诊断项目单日人数较多时，将分上下午两次订购药物并分装，每次^{18}F最大备药量为单次使用平均用量10mCi×5人×2×4=1.48×10^{10}Bq，即日最大用药量为$2\times1.48\times10^{10}=2.96\times10^{10}$Bq

为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价工作。

受常州市第一人民医院的委托，南京瑞森辐射技术有限公司承担了该单位新增PET/CT和PET/MRI诊断项目的环境影响评价工作。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号），本次新增PET/CT和PET/MRI诊断项目属于“172 核技术利用建设项目”中的“乙丙级非密封放射性物质工作场所”项目，确定为编制环境影响报告表。我公司通过资料调研、项目工程分析、现场勘察及现场监测等工作的基础上,编制了该项目环境影响报告表。该医院新增PET/CT和PET/MRI诊断项目情况见下表：

表 1-2 常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目情况一览表

非密封放射性物质

序号	工作场所等级	核素名称	日等效最大操作量（Bq）	工作场所名称	使用情况	环评及审批情况	备注
1	丙级	^{18}F	3.7×10^6	9 号楼 3 楼核医学科	未使用	本次环评尚未许可	PET/CT 显像诊断
			3.7×10^6		未使用	本次环评尚未许可	PET/MRI 显像诊断
			2.96×10^6		未使用	本次环评尚未许可	备药

射线装置

序号	射线装置名称型号	数量	管电压（kV）	管电流（mA）	射线装置类别	工作场所名称	使用情况	环评及审批情况	备注
1	PET/CT（型号未定)	1 台	140	1000	III	核医学科	未使用	本次环评尚未许可	/

二、项目选址情况

常州市第一人民医院位于常州市局前街 185 号，医院东侧和南侧为唐家湾路，西侧为晋陵中路，北侧为局前街。本项目地理位置示意见附图 1。

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所位于医院 9 号楼放疗楼 3 楼。9 号楼地上 6 层，地下 2 层（负 2 楼至 3 楼为放疗科，4 楼至 6 楼为核医学科），其中 3 楼原场所有模拟机房、模型室、热疗室、主任办公室、淋浴间等，场所内现有设备拟搬迁至 3 号楼 H 层使用。医院 9 号楼现有辐射项目环保手续齐全，无历史遗留问题。9 号楼放疗楼东侧为 1 号楼门急诊大楼，南侧隔院内道路为 3 号楼综合病房大楼，西侧为院内停车场，北侧为 10 号楼锅炉房、11 号楼实验楼和护王府遗址。常州市第一人民医院周围环境示意图及总平面图见附图 2。

本项目 PET/CT 机房东侧为 PET/CT 操作间，南侧为患者通道，西侧为注射后候诊室，北侧无建筑，上方为 ECT 注射后候诊室，下方为物理室和验证设备间。本项目 PET/MRI 机房东侧为操作间，南侧为医生办公室，西侧为设备间，北侧患者通道，上方为 ECT 机房和操作室，下方为 TPS 计划室。本项目新建衰变池位于医院 9 号楼放疗楼 1 楼东北角空地地下。本项目 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所（9 号楼 3 楼）平面布置图见附图 3，9 号楼 3 楼现状平面布置图见附图 4，9 号楼 1 楼、2 楼及 4 楼平面布置图分别见附图 5~7。

本项目工作场所周围 50m 评价范围均位于医院内，无学校、居民区等环境敏感点。

项目运行后的环境保护目标主要为核医学辐射工作人员、评价范围内其他医务人员、病患及其他公众等。

三、实践正当性分析

本项目的运行，可为病人提供多种医疗诊断服务，并可提高当地医疗卫生水平，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全管理后，其获得的利益远大于对环境的影响，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的原则。

四、“三线一单”相符性分析

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）和《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然资函〔2023〕880 号）要求，经向江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于江苏常州市中心城区（天宁区）重点管控单元（编码：ZH32040223869）内，不在常州市生态保护红线内，评价范围内也不涉及优先保护单元和一般管控单元。根据现场监测和环境影响预测，项目建设满足环境质量底线要求，不会造成区域环境质量下降；对照江苏常州市中心城区（天宁区）重点管控单元管控要求，本项目为核技术利用项目，满足重点管控单元管控要求（详见附件 8，江苏省生态环境分区管控综合查询报告书）。

本项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。

五、原有核技术利用项目许可情况

常州市第一人民医院现持有江苏省生态环境厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：苏环辐证[01314]，许可种类和范围为“使用III类、V类放射源；使用II类、III类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所”，有效期至：2027 年 06 月 07 日。医院原有核技术利用项目均已许可和验收，无历史遗留问题。医院辐射安全许可证正本见附件 4。常州市第一人民医院现有核技术利用项目均已履行环保相关手续。医院现有核技术利用项目一览表见附件 5。

表 2　放射源

序号	核素名称	总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

表 3　非密封放射性物质

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大操作量（Bq）	日等效最大操作量（Bq）	年最大用量（Bq）	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
1	^{18}F	液态/低毒	使用	3.7×10^{9}	3.7×10^{6}	9.25×10^{11}	PET/CT 核素诊断	注射， 很简单操作	9 号楼 3 楼 核医学科	按需订购，核医学科使用
2	^{18}F	液态/低毒	使用	3.7×10^{9}	3.7×10^{6}	9.25×10^{11}	PET/MRI 核素诊断	注射， 很简单操作	9 号楼 3 楼 核医学科	按需订购，核医学科使用
2	^{18}F	液态/低毒	使用	2.96×10^{10}	2.96×10^{6}	7.4×10^{12}	核素诊断	源的贮存	9 号楼 3 楼 核医学科	按需订购，核医学科贮存

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表 4　射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量（MeV）	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h）	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（二）X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压（kV）	最大管电流（mA）	用途	工作场所	备注
1	PET/CT	III	1	待定	140	1000	显像诊断	9 号楼 3 楼核医学科	本次环评
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压（kV）	最大靶电流（μA）	中子强度（n/s）	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度（Bq）	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5　废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
沾有放射性核素的注射器、手套、擦拭废纸等	固体	^{18}F	/	约 12kg	约 144kg	/	存放于专用放射性废物铅桶与放射性废物间	暂存时间超过 30 天，经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平，α表面污染小于 0.08Bq/cm^2、β表面污染小于 0.8Bq/cm^2 的，可对废物清洁解控并作为医疗废物处理
含放射性核素的卫生间下水及清洗废水	液体	^{18}F	/	约 9m^3	约 108m^3	/	流入衰变池中	医院每年对衰变池中的放射性废液进行监测，衰变满足排放标准后流入医院污水处理系统作为医疗废水处理。
含有液态放射性药物分装时挥发的微量气溶胶	气体	^{18}F	/	微量	微量	微量	不暂存	在手套箱中操作，经专用通风管道内及屋顶排放口活性炭装置过滤后排放
臭氧和氮氧化物	气态	/	/	/	微量	微量	不暂存	通过排风系统排入外环境，臭氧在常温条件下约 50min 可自然分解为氧气
废活性炭	固体	^{18}F	/	少量	少量	/	更换后暂存在放射性废物间	暂存时间超过 30 天、经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平，α表面污染小于 0.08Bq/cm^2、β表面污染小于 0.8Bq/cm^2 的，作为医疗废物统一交由有资质的单位处理
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m^3；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m^3）和活度（Bq）。

表 6　评价依据

法规文件	（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版），中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版），中华人民共和国主席令 第二十四号，2018年12月29日发布施行； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令 第六号，2003年10月1日起实施； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令 第449号，2005年12月1日起施行；2019年修改，国务院令 第709号，2019年3月2日施行； （5）《建设项目环境保护管理条例》（修订版），国务院令 第682号，2017年10月1日发布施行； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），生态环境部部令 第20号，2021年1月4日起施行； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令 第18号，2011年5月1日起施行； （9）《关于发布〈射线装置分类〉的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年 第66号，2017年12月5日起施行； （10）《关于发布放射源分类办法的公告》，公告2005年第62号，国家环保总局，2005年12月23日发布； （11）《放射性废物安全管理条例》，中华人民共和国国务院令 第612号，2012年3月1日起施行； （12）《放射性物品道路运输管理规定》（2016年修正本），交通运输部令2016年第71号公布，2016年9月2日起施行； （13）《关于发布〈放射性废物分类〉的公告》，环境保护部、工业和信息化部、国防科工局公告 2017年公告第65号公布，自2018年1月1日起施行；

	（14）《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正本），江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第2号公告，2018年5月1日起实施； （15）《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》，环办辐射函[2016]430号，2016年3月7日起施行； （16）《关于发布<建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法>配套文件的公告》，生态环境部公告 2019年 第38号，2019年10月25日发布； （17）《关于启用环境影响评价信用平台的公告》，生态环境部公告 2019年 第39号，2019年10月25日发布； （18）《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部公告 2019年 第57号，2019年12月24日发布； （19）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部部令 第9号，2019年11月1日起施行； （20）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年修改），国家发展和改革委员会2023年令第7号，2024年2月1日起施行 （21）《江苏省辐射事故应急预案》（2020年修订版），苏政办函〔2020〕26号，2020年2月19日发布； （22）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资发〔2022〕142号，2018年6月9日发布，2022年8月16日发布； （23）《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》，苏自然资函〔2023〕880号，2023年10月10日发布。
技术标准	（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）； （2）《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）； （3）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB 11930-2010）； （4）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （5）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （6）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）； （7）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）；

	（8）《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）； （9）《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）； （10）《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）； （11）《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）； （12）《关于核医学标准相关条款咨询的复函》，辐射函〔2023〕20 号。
其他	**附图：** （1）常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目地理位置示意图； （2）常州市第一人民医院平面布置和周围环境示意图； （3）常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼核医学科平面布局示意图； （4）常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼现状平面布局示意图； （5）常州市第一人民医院 9 号楼 2 楼平面布局示意图； （6）常州市第一人民医院 9 号楼 4 楼平面布局示意图； （7）常州市第一人民医院 9 号楼 3 楼核医学科排风管道布设示意图。 **附件：** （1）项目委托书； （2）非密封放射性物质、射线装置使用承诺书； （3）工作场所屏蔽设计说明； （4）辐射安全许可证正副本； （5）医院现有核技术利用项目情况一览表； （6）辐射环境现状监测报告； （7）检测机构资质认定证书； （8）江苏省生态环境分区管控综合查询报告书。

表 7　保护目标与评价标准

评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射性药物生产及其他非密封放射性物质工作场所项目的评价范围，甲级取半径 500m 的范围，乙、丙级取半径 50m 的范围。放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的规定，结合本项目的特点，确定本项目评价范围为本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目工作场所实体屏蔽墙体边界外周围 50m 范围内区域，评价范围详见附图 2。

保护目标

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）和《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然资函〔2023〕880 号）要求，经向江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于江苏常州市中心城区（天宁区）重点管控单元（编码：ZH32040223869）内，不在常州市生态保护红线内，评价范围内也不涉及优先保护单元和一般管控单元。对照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022），本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

本项目主要考虑核医学科工作时可能对周围环境产生的辐射影响。本项目核医学工作场周围 50m 评价范围均位于医院内，内无学校、居民区等环境敏感点。项目运行后的环境保护目标主要为核医学科辐射工作人员、评价范围内其他医务人员、病患及其他公众等。详见表 7-1。

表 7-1 常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目保护目标一览表

保护对象类型	场所	环境保护目标	方位/位置	距本项目最近距离	人员规模
辐射工作人员	9 号楼 3 楼核医学科	核医学科工作人员	核医学科工作场所内	/	6 人
评价范围内公	9 号楼放疗楼	医护人员	本项目辐射工作场	约 2m	约 20 人

众		病患、其他公众	所四周、楼上及楼下		约 40 人
	1 号楼 门急诊大楼	病患、其他公众	门急诊医技楼东侧	约 30m	流动人员
	3 号楼 综合病房大楼	病患、其他公众	门急诊医技楼南侧	约 50m	流动人员
	院内停车场	病患、其他公众	门急诊医技楼西侧	约 10m	流动人员
	10 号楼锅炉房	其他公众	门急诊医技楼北侧	约 10m~20m	流动人员
	11 号楼 实验楼	病患、其他公众	门急诊医技楼北侧	约 50m	流动人员

根据现场监测和环境影响预测，项目建设满足环境质量底线要求，不会造成区域环境质量下降；对照江苏常州市中心城区（天宁区）重点管控单元管控要求，本项目为核技术利用项目，满足重点管控单元管控要求（详见附件 8，江苏省生态环境分区管控综合查询报告书）。本项目拟使用放射性核素 ^{18}F 配合 PET/CT 和 PET/MRI 开展核素显像诊断，不会降低评价范围内的水、气、土壤的环境功能类别和环境质量，本项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。

评价标准

1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）：

工作人员职业照射和公众照射剂量限值

对象	要求
职业照射剂量限值	应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv； ③眼晶体的年当量剂量，150mSv； ④四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。
公众照射剂量限值	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，lmSv； ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 lmSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。
剂量约束值通常应在公众照射剂量限值 10%～30%（即 0.1mSv/a～0.3 mSv/a）的范围之内。	

1.2 非密封源工作场所的分级

级　别	日等效最大操作量/Bq
甲	$>4\times10^9$

乙	2×10^7～4×10^9
丙	豁免活度值以上～2×10^7

辐射工作场所的分区

应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

控制区：

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

监督区：

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

表 B11 工作场所放射性表面污染控制水平 单位：Bq/cm^2

表面类型		α放射性物质		β放射性物质
		极毒性	其他	
工作台、设备、墙壁、地面	控制区	4	4×10	4×10
	监督区	4×10^{-1}	4	4
工作服、手套、工作鞋	控制区	4×10^{-1}	4×10^{-1}	4
	监督区			
手、皮肤、内衣、工作袜		4×10^{-2}	4×10^{-2}	4×10^{-1}

2、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）：

3、《操作非密封源的辐射防护规定》（GB 11930-2010）；

4、《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）：

5.1.1 在医疗机构内部区域选择核医学场址，应充分考虑周围场所的安全，不应邻接产科、儿科、食堂等部门，这些部门选址时也应避开核医学场所。尽可能做到相对独立布置或集中设置，宜有单独出、入口，出口不宜设置在门诊大厅、收费处等人群稠密区域。

5.1.2 核医学工作场所平面布局设计应遵循如下原则：

a）使工作场所的外照射水平和污染发生的概率达到尽可能小；

b）保持影像设备工作场所内较低辐射水平以避免对影像质量的干扰；

c）在核医学诊疗工作区域，控制区的入口和出口应设置门锁权限控制和单向门等安全措施，限制患者或受检者的随意流动，保证工作场所内的工作人员和公众免受不必要的照射；

d）在分装和给药室的出口处应设计卫生通过间，进行污染检测。

5.1.3 核医学工作场所从功能设置可分为诊断工作场所和治疗工作场所。其功能设置要求如下：

a）对于单一的诊断工作场所应设置给药前患者或受检者候诊区、放射性药物贮存室、分装给药室（可含质控室）、给药后患者或受检者候诊室(根据放射性核素防护特性分别设置)、质控（样品测量）室、控制室、机房、给药后患者或受检者卫生间和放射性废物储藏室等功能用房；

b）对于单一的治疗工作场所应设置放射性药物贮存室、分装及药物准备室、给药室、病房（使用非密封源治疗患者）或给药后留观区、给药后患者专用卫生间、值班室和放置急救设施的区域等功能用房；

c）诊断工作场所和治疗工作场所都需要设置清洁用品储存场所、员工休息室、护士站、更衣室、卫生间、去污淋浴间、抢救室或抢救功能区等辅助用房；

d）对于综合性的核医学工作场所，部分功能用房和辅助用房可以共同利用；

5.1.4 核医学放射工作场所应划分为控制区和监督区。控制区一般包括使用非密封源核素的房间（放射性药物贮存室、分装及（或）药物准备室、给药室等）、扫描室、给药后候诊室、样品测量室、放射性废物储藏室、病房（使用非密封源治疗患者）、卫生通过间、保洁用品储存场所等。监督区一般包括控制室、员工休息室、更衣室、医务人员卫生间等。应根据 GB 18871 的有关规定，结合核医学科的具体情况，对控制区和监督区采取相应管理措施。

5.1.5 核医学工作场所的布局应有助于开展工作，避免无关人员通过。治疗区域和诊断区域应相对分开布置。根据使用放射性药物的种类、形态、特性和活度，确定核医学治疗区（病房）的位置及其放射防护要求，给药室应靠近病房，尽量减少放射性药物和给药后患者或受检者通过非放射性区域。

5.1.6 通过设计合适的时间空间交通模式来控制辐射源（放射性药物、放射性废物、给药后患者或受检者）的活动，给药后患者或受检者与注射放射性药物前患者或受检者不交叉，给药后患者或受检者与工作人员不交叉，人员与放射性药物通道不交叉。合理设置放射性物质运输通道，便于放射性药物、放射性废物的运送和处理；便于放射性污染的清理、清洗等工作的开展。

5.1.7 应通过工作场所平面布局的设计和屏蔽手段，避免附近的辐射源（核医学周边场所内的辐射装置、给药后患者或受检者）对诊断区设备成像、功能检测的影响。

5.2 放射防护设施要求

5.2.1 核医学的工作场所应按照非密封源工作场所分级规定进行分级，并采取相应防护措施。

5.2.2 应依据计划操作最大量放射性核素的加权活度对开放性放射性核素工作场所进行分类管理，把工作场所分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。不同类别核医学工作场所用房室内表面及装备结构的基本放射防护要求见表 1，核医学工作场所分类的加权活度计算方法见附录 G。

表 1 不同核医学工作场所用房室内表面及装备结构的基本放射防护要求

种类	分类		
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
结构屏蔽	需要	需要	不需要
地面	与墙壁接缝无缝隙	与墙壁接缝无缝隙	易清洗

表面	易清洗	易清洗	易清洗
分装柜	需要	需要	不必须
通风	特殊的强制通风	良好通风	一般自然通风
管道	特殊的管道[a]	普通管道	普通管道
盥洗与去污	洗手盆[b]和去污设备	洗手盆[b]和去污设备	洗手盆[b]

[a]下水道宜短，大水流管道应有标记以便维修检测。

[b]洗手盆应为感应式或脚踏式等手部非接触开关控制。

5.2.3 核医学工作场所的通风按表 1 要求，通风系统独立设置，应保持核医学工作场所良好的通风条件，合理设置工作场所的气流组织，遵循自非放射区向监督区再向控制区的流向设计，保持含放射性核素场所负压以防止放射性气体交叉污染，保证工作场所的空气质量。合成和操作放射性药物所用的通风橱应有专门的排风装置，风速应不小于 0.5m/s。排气口应高于本建筑物屋顶并安装专用过滤装置，排出空气浓度应达到环境主管部门的要求。

5.3 工作场所的防护水平要求

5.3.1 核医学工作场所控制区的用房，应根据使用的核素种类、能量和最大使用量，给予足够的屏蔽防护。在核医学控制区外人员可达处，距屏蔽体外表面 0.3m 处的周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h，控制区内屏蔽体外表面 0.3m 处的周围剂量当量率控制目标值应不大于 25μSv/h，宜不大于 2.5μSv/h；核医学工作场所的分装柜或生物安全柜，应采取一定的屏蔽防护，以保证柜体外表面 5cm 处的周围剂量当量率控制目标值应不大于 25μSv/h；同时在该场所及周围的公众和放射工作人员应满足个人剂量限值要求。屏蔽计算中所涉及的常用放射性药物理化特性参见附录 H。PET 相关房间的辐射屏蔽计算方法和示例参见附录 I。自屏蔽回旋加速器机房的屏蔽计算方法由回旋加速器在所有工作条件下所产生中子的最大通量（取决于加速器的类型、能量、粒子类型以及使用的靶等）决定。

5、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）：

6.1 屏蔽要求

6.1.5 距核医学工作场所各控制区内房间防护门、观察窗和墙壁外表面 30cm 处的周围剂量当量率应小于 2.5μSv/h，如屏蔽墙外的房间为人员偶尔居留的设备间等区域，其周围剂量当量率应小于 10μSv/h。

6.1.6 放射性药物合成和分装的箱体、通风柜、注射窗等设备应设有屏蔽结构，以保证设备外表面 30cm 处人员操作位的周围剂量当量率小于 2.5μSv/h，放射性药物合成和分装箱体非正对人员操作位表面的周围剂量当量率小于 25μSv/h。

6.2 场所安全措施要求

6.2.1 核医学工作场所的放射性核素操作设备的表面、工作台台面等平整光滑，室内地面与墙壁衔接处应无接缝，易于清洗、去污。

6.2.2 操作放射性药物场所级别达到乙级应在手套箱中进行，丙级可在通风橱内进行。应为从事放射性药物操作的工作人员配备必要的防护用品。放射性药物给药器应有适当的屏蔽，给药后患者候诊室内、核素治疗病房的床位旁应设有铅屏风等屏蔽体，以减少对其他患者和医护人员的照射。

6.2.3 操作放射性药物的控制区出口应配有表面污染监测仪器，从控制区离开的人员和物品均应进行表面污染监测，如表面污染水平超出控制标准，应采取相应的去污措施。

6.2.4 放射性物质应贮存在专门场所的贮存容器或保险箱内，定期进行辐射水平监测，无关人员不应入内。贮存的放射性物质应建立台账，及时登记，确保账物相符。

6.3 密闭和通风要求

6.3.1 核医学工作场所应保持良好的通风，工作场所的气流流向应遵循自清洁区向监督区再向控制区的方向设计，保持工作场所的负压和各区之间的压差，以防止放射性气体及气溶胶对工作场所造成交叉污染。

6.3.4 放射性物质的合成、分装以及挥发性放射性核素的操作应在手套箱、通风橱等密闭设备中进行，防止放射性液体泄漏或放射性气体及气溶胶逸出。手套箱、通风橱等密闭设备应设计单独的排风系统，并在密闭设备的顶壁安装活性炭或其他过滤装置。

6.3.5 通风橱应有足够的通风能力。制备放射性药物的回旋加速器工作区域、碘-131 治疗病房以及设有通风橱、手套箱等场所的通风系统排气口应高于本建筑物屋顶，尽可能远离邻近的高层建筑。

7.2 固体放射性废物的管理

7.2.3 固体放射性废物处理

7.2.3.1 固体放射性废物暂存时间满足下列要求的，经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平，α表面污染小于 0.08Bq/cm^2、β表面污染小于 0.8Bq/cm^2 的，可对废物清洁解控并作为医疗废物处理：

a）所含核素半衰期小于 24 小时的放射性固体废物暂存时间超过 30 天；

b）所含核素半衰期大于 24 小时的放射性固体废物暂存时间超过核素最长半衰期的 10 倍；

c）含碘-131 核素的放射性固体废物暂存超过 180 天。

7.3 液态放射性废物的管理

7.3.3 放射性废液排放

7.3.3.1 对于槽式衰变池贮存方式：

a）所含核素半衰期小于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 30 天后可直接解控排放；

b）所含核素半衰期大于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 10 倍最长半衰期（含碘-131 核素的暂存超过 180 天），监测结果经审管部门认可后，按照 GB 18871 中 8.6.2 规定方式进行排放。放射性废液总排放口总α不大于 1Bq/L、总β不大于 10Bq/L、碘-131 的放射性活度浓度不大于 10Bq/L。

7.3.3.2 对于推流式衰变池贮存方式，所含核素半衰期大于 24 小时的，每年应对衰变池中的

放射性废液进行监测，碘-131 和最长半衰期核素的放射性活度浓度应满足 GB 18871 附录 A 表 A1 的要求。

7.3.3.3 放射性废液的暂存和处理应安排专人负责，并建立废物暂存和处理台账，详细记录放射性废液所含的核素名称、体积、废液产生起始日期、责任人员、排放时间、监测结果等信息。

8.2 工作场所监测

8.2.2 核医学工作场所辐射监测点位、内容和频次应包括但不限于表 1 的内容。

表 1 核医学工作场所辐射监测关注点位

监测内容	监测点位	监测频次
辐射水平	控制区和监督区所有工作人员和公众可能居留的有代表性的点位和存有放射性物质的装置/设备的表面	不少于 1 次/月
表面放射性污染	放射性核素操作台面、设备表面、墙壁和地面，给药后患者候诊室，核素治疗场所的设施、墙壁和地面等，放射性废物桶和包装袋表面，工作人员的手、皮肤暴露部分及工作服、手套、鞋、帽等。	每次工作结束（出现放射性药物洒落应及时进行监测）

6、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）：

6 X 射线设备机房防护设施的技术要求

6.1 X 射线设备机房布局

6.1.1 应合理设置 X 射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

6.1.2 X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

6.1.3 每台固定使用的 X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；每台牙椅独立设置诊室的，诊室内可设置固定的口内牙片机，供该设备使用，诊室的屏蔽和布局应满足口内牙片机房防护要求。

6.1.4 移动式 X 射线机（不含床旁摄影机和急救车配备设备）在使用时，机房应满足相应布局要求。

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的 X 射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 2 的规定。

表 2 X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

机房类型	机房内最小有效使用面积 [d] m^2	机房内最小单边长度 [e] m
CT 机（不含头颅移动 CT）	30	4.5
双管头或多 X 射线设备 [a]（含 C 形臂）	30	4.5

单管头 X 射线设备[b]（含 C 形臂，乳腺 CBCT）	20	3.5

6.2 X 射线设备机房屏蔽

6.2.1 不同类型 X 射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表 3 的规定。

表 3 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型	有用线束方向铅当量 mmPb	非有用线束方向铅当量 mmPb
标称 125kV 以上的摄影机房	3.0	2.0
标称 125kV 及以下的摄影机房	2.0	1.0
C 形臂 X 射线设备机房	2.0	2.0
CT 机房（不含头颅移动 CT） CT 模拟定位机房	2.5	

6.3 X 射线设备机房屏蔽体外剂量水平

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a）具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h；测量时，X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；

b）CT 机、乳腺摄影、乳腺 CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔 CBCT 和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h；

c）具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如 DR、CR、屏片摄影）机房外的周围剂量当量率应不大于 25μSv/h，当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于 0.25mSv；

d）车载式诊断 X 射线设备工作时，应在车辆周围 3m 设立临时控制区，控制区边界的周围剂量当量率应符合 6.3.1 中 a）～c）的要求。

6.4 X 射线设备工作场所防护

6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。

6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。

6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

6.4.8 模拟定位设备机房防护设施应满足相应设备类型的防护要求。

6.4.9 CT 装置的安放应利于操作者观察受检者。

6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。

6.4.11 车载式诊断X射线设备工作场所的选择应充分考虑周围人员的驻留条件，X射线有用线束应避开人员停留和流动的路线。

6.4.12 车载式诊断X射线设备的临时控制区边界上应设立清晰可见的警告标志牌（例如：“禁止进入X射线区”）和电离辐射警告标志。临时控制区内不应有无关人员驻留。

6.5 X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求

6.5.1 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

6.5.2 车载式诊断X射线设备机房个人防护用品和辅助防护设施配置要求按照其安装的设备类型参照表4执行。

6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。

6.5.4 应为儿童的X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.5mmPb。

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

6.5.6 对于移动式X射线设备使用频繁的场所（如：重症监护、危重病人救治、骨科复位等场所），应配备足够数量的移动铅防护屏风。

7 X射线设备操作的防护安全要求

7.8 介入放射学和近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备操作的防护安全要求。

7.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备应满足其相应设备的防护安全操作要求。

7.8.2 介入放射学用X射线设备应具有记录受检者剂量的装置，并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中，需要时，应能追溯到受检者的受照剂量。

7.8.3 除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留；对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其他人员在机房内停留。

7.8.4 穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员，其个人剂量计佩戴要求应符合GBZ 128的规定。

7.8.5 移动式C形臂X射线设备垂直方向透视时，球管应位于病人身体下方；水平方向透视时，工作人员可位于影像增强器一侧，同时注意避免有用线束直接照射。

7、项目管理目标

综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）、《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）及《关于核医学标准相关条款咨询的复函》（辐射函〔2023〕20号）确定本项目的管

理目标，本项目剂量约束值为：职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超 0.1mSv。核医学科工作场所（PET/CT 和 PET/MRI 工作场所）各控制区内房间防护门、观察窗和墙壁外表面 30cm 处的周围剂量当量率应小于 2.5μSv/h；控制区内屏蔽体外表面 0.3m 处的周围剂量当量率控制目标值应不大于 25μSv/h。

核医学工作场所的放射性表面污染控制水平要求见下表：

表面类型		β放射性物质（Bq/cm^2）
工作台、设备、墙壁、地面	控制区	4×10
	监督区	4
工作服、手套、工作鞋	控制区	4
	监督区	
手、皮肤、内衣、工作袜		4×10^{-1}

8、参考资料：

（1）《辐射防护导论》，方杰主编。

（2）《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第 13 卷第 2 期，1993 年 3 月），江苏省环境监测站。

江苏省环境天然γ辐射（空气吸收）剂量率（单位：nGy/h）

	原野剂量率	道路剂量率	室内剂量率
测值范围	33.1~72.6	18.1~102.3	50.7~129.4
均值	50.4	47.1	89.2
标准差（s）	7.0	12.3	14.0

注：测量值已扣除宇宙射线响应值，评价时采用“测量范围”作为辐射现状评价的参考数值。

表 8　环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状

一、项目位置、布局和周边环境

常州市第一人民医院位于常州市局前街 185 号，医院东侧和南侧为唐家湾路，西侧为晋陵中路，北侧为局前街。

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所位于医院 9 号楼放疗楼 3 楼，9 号楼放疗楼东侧为 1 号楼门急诊大楼，南侧隔院内道路为 3 号楼综合病房大楼，西侧为院内停车场，北侧为 10 号楼锅炉房、11 号楼实验楼和护王府遗址。

本项目 PET/CT 机房东侧为 PET/CT 操作间，南侧为患者通道，西侧为注射后候诊室，北侧无建筑，上方为 ECT 注射后候诊室，下方为物理室和验证设备间。本项目 PET/MRI 机房东侧为操作间，南侧为医生办公室，西侧为设备间，北侧患者通道，上方为 ECT 机房和操作室，下方为 TPS 计划室。本项目衰变池位于医院 9 号楼放疗楼 1 楼东北角空地地下。本项目工作场所周围 50m 评价范围均位于医院内，无学校、居民区等环境敏感点。项目运行后的环境保护目标主要为核医学辐射工作人员、评价范围内其他医务人员、病患及其他公众等。

本项目新增 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所周围环境见图 8-1~图 8-6。



图 8-1　本项目 PET/CT 机房拟建址



图 8-2　本项目 PET/MRI 机房拟建址



图 8-3 核医学科拟建址东侧



图 8-4 核医学科拟建址西侧









图 8-5 核医学场所拟建址楼下



图 8-6 核医学场所拟建址楼上

二、辐射环境现状调查

根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）相关方法和要求，在进行环境现场调查时，于医院改建核医学诊断项目拟建址周围进行布点，测量辐射现状剂量率，监测结果见表 8-1~表 8-2，监测点位示意图见图 8-7。

监测单位：南京瑞森辐射技术有限公司

监测日期：2023 年 11 月 27 日

监测因子：γ辐射剂量率、β表面污染水平

天气：多云

温度：0℃

湿度：37%RH

监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）有关布点原则进行布点。

质量控制：本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过计量认证（证书编号：221020340350，检测资质见附件 7），具备有相应的检测资质和检测能力，监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）的要求，实施全过程质量控制。

数据记录及处理：开机预热，手持仪器。保持仪器探头中心距离地面（基础面）为1m。仪器读数稳定后，每个点位读取10个数据，读取间隔不小于10s。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。根据环境γ辐射剂量率测量结果按照《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）中公式$\dot{D}_\gamma = k_1 \times k_2 \times R_\gamma - k_3 \times \dot{D}_c$计算，其中$k_1$为仪器检定/校准因子，取1.01；$k_2$为仪器检验源效率因子，取1；$R_\gamma$为仪器测量读数值均值（使用$^{137}Cs$和$^{60}Co$作为检定/校准参考辐射源时，换算系数分别取1.20 Sv/Gy 和1.16 Sv/Gy），取1.20 Sv/Gy；k_3为建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子，楼房取0.8，平房取0.9，原野、道路取1；$\dot{D}_c$为测点处宇宙射线响应值，取30nGy/h。

监测人员、监测仪器及监测结果：监测人员均经过考核，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过校准或检验，监测报告实行三级审核。

评价方法：参照江苏省天然γ辐射剂量水平调查结果，评价项目周围的辐射环境质量。

1、γ辐射剂量率

检测仪器：6150 AD 6/H+6150 AD-b/H型X-γ辐射监测仪（设备编号：NJRS-126，检定有效期：2023年10月30日～2024年10月29日，检定单位：江苏省计量科学研究院，检定证书编号：Y2023-0173796）

能量响应：20keV～7MeV

测量范围：1nSv/h～99.9μSv/h

表8-1 常州市第一人民医院新增PET/CT和PET/MRI诊断项目拟建址周围现状辐射剂量率

测点编号	测点描述	测量结果（nGy/h）	备注
1	核医学科拟建址内 （现状为走道、主任办公室）	111	室内
2	核医学科拟建址内 （现状为走道、热疗室）	110	室内
3	核医学科拟建址内 （现状为CT SIM室）	103	室内
4	核医学科拟建址内 （现状为走道、粒子治疗室）	111	室内
5	核医学科拟建址内 （现状为走道）	106	室内

6	核医学科拟建址上方 （走道、注射候诊室）	83	室内
7	核医学科拟建址下方 （走道、验证设备间）	111	室内
8	9 号楼东侧道路	67	道路
9	9 号楼南侧道路	59	道路
10	9 号楼西侧道路	71	道路
11	9 号楼北侧道路	65	道路

注：1、测量结果已扣除宇宙射线响应值；

2、检测时，拟建址上方即 9 号楼 4 楼内 ECT 未开机且无放射性药物。

由表 8-1 监测结果可知，常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MR 诊断项目拟建址及其周围环境室内γ辐射剂量率在 59nGy/h～111nGy/h 之间，检测结果位于江苏省环境天然贯穿辐射水平涨落区间。

2、β表面污染水平

检测仪器：CoMo 170 型α、β表面污染测量仪（设备编号：NJRS-129，检定有效期：2023 年 3 月 27 日～2024 年 3 月 26 日，检定单位：江苏省计量科学研究院，检定证书编号：Y2023-0042629）。

测量范围：0cps～20000cps

表 8-2 常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目拟建址周围β表面污染水平

测点编号	测点描述	测量结果（Bq/cm²）
1	核医学科拟建址内 （现状为走道、主任办公室）	0.11
2	核医学科拟建址内 （现状为走道、热疗室）	0.12
3	核医学科拟建址内 （现状为 CT SIM 室）	0.12
4	核医学科拟建址内 （现状为走道、粒子治疗室）	0.12
5	核医学科拟建址内 （现状为走道）	0.15

注：1、β表面放射性污染水平仪器探测下限（LLD）为 0.07Bq/cm^2；

2、监测点位见图 8-7。

由表 8-2 监测结果可知，常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目拟建址及其周围环境β表面放射性污染水平为 0.11Bq/cm^2~0.15Bq/cm^2。

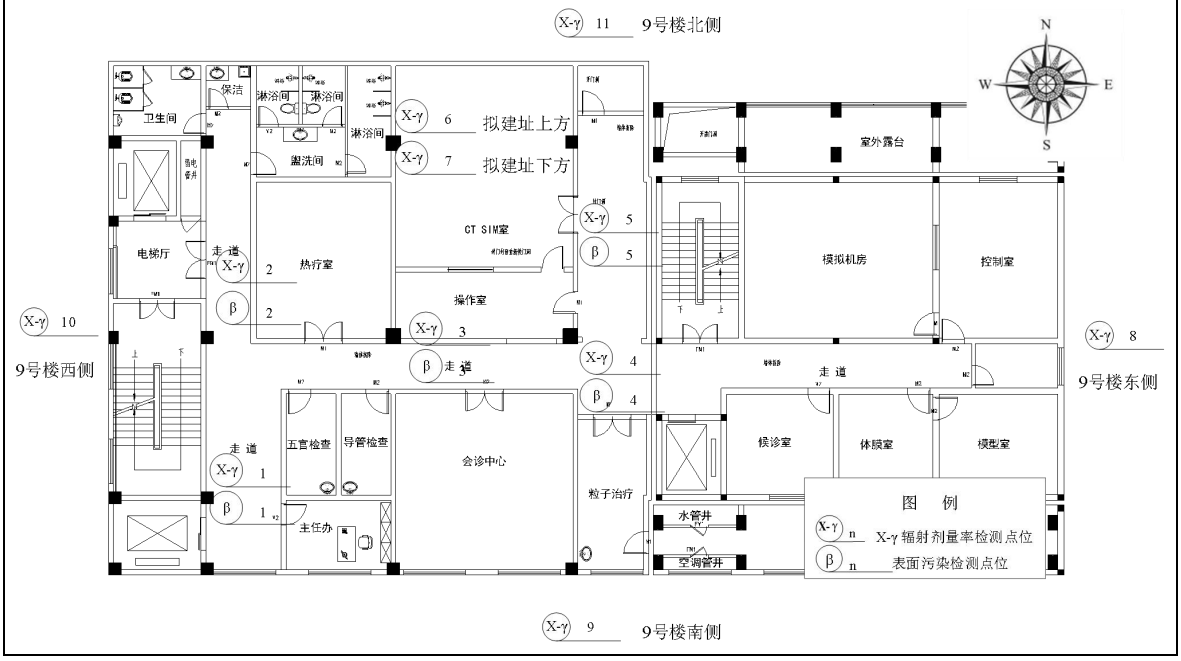


图 8-7 常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目
拟建址周围γ辐射剂量率及β表面污染水平监测点位示意图

表 9　项目工程分析与源项

工程设备与工艺分析

一、工程设备

常州市第一人民医院拟将 9 号楼放疗楼 3 楼现有放疗科工作场所改建成 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所，并新增 1 台 PET/CT（属III类射线装置）和 1 台 PET/MRI。本项目拟使用放射性核素 ^{18}F 配合 PET/CT 和 1 台 PET/MRI 开展核素显像诊断。

PET/CT 是将 PET 与 CT 融为一体，由 PET 提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息，而 CT 提供病灶的精确解剖定位。PET 系统的主要部件包括机架、环形探测器、符合电路、检查床及工作站等。探测系统是整个正电子发射显像系统中的主要部分，它采用的块状探测结构有利于消除散射、提高计数率。CT 主要有扫描部分、计算机系统、图像显示和存储系统组成，其中扫描部分由 X 线管、探测器和扫描架组成。PET/CT 结构示意图见图 9-1。

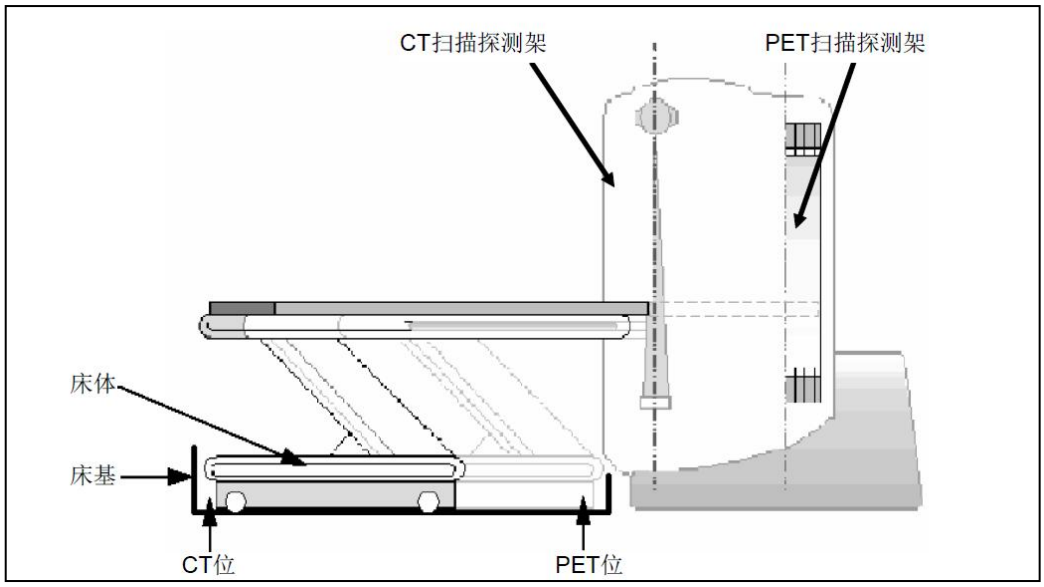


图 9-1 PET/CT 结构示意图

本项目拟新增的 1 台 PET/CT 主要设备技术参数见表 9-1。

表 9-1　PET/CT 主要设备技术参数表

名称	技术参数
型号	型号未定
位置	9 号楼放疗楼 3 楼 PET/CT 机房
额定管电压	≤140kV

额定管电流	≤1000mA
X 射线球管固有滤过	不低于 2.5mmAl
X 射线球管到等中心距离	≥60cm
泄漏辐射	≤0.8mGy/h
用途	显像诊断

注：*设备技术参数根据建设单位招标意向及主流供货商的常用参数确定，实际采购设备的源强参数不大于表列源强参数。

根据医院提供的预估工况分别核算其放射性核素日最大操作量和年总用量。根据《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）附录 A 表 A.1 及表 A.2，得到该核素的毒性组别及操作方式，根据核素的日最大操作量，经过毒性组别及操作方式的双重修正，得到整个非密封放射性物质工作场所的日等效操作量，判断其工作场所等级。

放射性核素的日等效操作量等于放射性核素的实际日操作量（Bq）与该核素毒性组别修正因子的积除以与操作方式有关的修正因子所得的商。放射性核素的毒性组别修正因子及操作方式有关的修正因子分别见表 A.1 和表 A.2，本项目核医学科放射性核素使用情况见表 1-1，所使用的放射性核素日等效最大操作量核算见表 9-2。

表 A.1 核医学常用放射性核素毒性组别修正因子

毒性组别	常用核素名称	毒性组别修正因子
高毒	^{90}Sr	1
中毒	^{22}Na、^{32}P、^{63}Ni、^{67}Ga、^{90}Y、^{99}Mo、^{111}In、^{125}I、^{131}I、^{153}Sm	0.1
低毒	^{3}H、^{11}C、^{11}CO、$^{11}CO_2$、^{14}CO、$^{14}CO_2$、^{18}F、^{51}Cr、^{99m}Tc、^{111m}In、^{123}I、^{133}Xe、^{201}Tl	0.01

表 A.2 核医学常见放射性核素状态与操作放射修正因子

活动类型	核素及状态	操作方式界定	操作方式修正因子
发生器淋洗	母体（液态）	贮存	100
	子体（液态）	简单操作	1
医疗机构使用	^{18}F、^{99m}Tc（液态）	很简单操作	10
	^{125}I 籽源（固态）	很简单操作	100
放射性药品生产	分装、标记（液态）	简单操作	1
	分装、标记（固体）	简单操作	10
核素治疗	^{131}I（液态）	简单操作	1

表 9-2 本项目所使用的放射性核素日等效最大操作量核算

核素	日最大操作量(Bq)	毒性组别 修正因子	操作方式 修正因子	日等效最大操作量（Bq）
^{18}F	7.4×10^{9}	低毒 0.01	液态、很简单操作 10	7.4×10^{6}
^{18}F	2.96×10^{10}	低毒 0.01	液态、源的贮存 100	2.96×10^{6}
合计				1.036×10^{7}

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）非密封源工作场所的分级原则，同时结合医院现有核技术利用项目非密封放射性物质使用情况可知，本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所日等效最大操作量合计为 1.036×10^{7}Bq，属于“豁免活度值以上~2×10^{7}”Bq，确定该工作场所为丙级非密封放射性物质工作场所。

二、工作原理及工作流程

1、PET/CT 工作原理

PET/CT（Positron Emission Tomography and Computer Tomography），全称正电子发射断层与计算机断层诊断技术，是在 PET（Positron Emission Tomography）和 CT（Computer Tomography）的基础上发展起来的新设备，充分结合了 PET 高灵敏度和 CT 高分辨率的优势。CT 利用人体各种组织对 X 线的吸收能力不等的特性，X 线通过人体衰减，经重建计算获得图像矩阵。CT 对组织的密度分辨率较高。PET 其原理是通过正电子核素或其标记的示踪剂，示踪人体内特定生物物质的生物活动，采用多层、环形排列于发射体周围的探头，由体外探测正电子示踪剂湮灭辐射所产生的光子，然后将获得的信息，通过计算机处理，以解剖影像的形式及其相应的生理参数，显示靶器官或病变组织的状况，藉此诊断疾病，又称为生化显像或功能分子显像，是目前唯一可以在活体分子水平完成生物学显示的影像技术；同时结合应用高档多排 CT 技术进行精确定位，可精确地提供靶器官的解剖和功能双重信息，并能够独立完成多排螺旋 CT 的临床显像，大大提高临床使用价值。

正电子发射是放射性核素衰变的方式之一。这类核素在自发的从不稳定状态向基态衰变过程中，从核内释放出与普通电子一样但电荷相反的粒子，即正电子。正电子是一种反物质，从核内放出后很快与环境中自由电子碰撞湮灭，转化为一对方向相反、能量为 0.511MeV 的γ光子。如果在这对光子飞行方向上对置一对探测器，便可以几乎同时接受到这两个光子，并可推定光子发源（即正电子发射）点在两探头间连线上。

通过环绕360°排列的多组配对探头，经探头对之间符合线路检验判定每只探头信号时间耦合性，排除其他来源射线的干扰，得到探头对连线上的一维信息，再用滤波反投射方式，将信号按探头对的空间位置向中心点反投射，便可形成与探头组连线轴平行的断层面正电子发射示踪剂分布图像。这种探测方式一次只反映一个层面的信息。实用中常用多层排列的探头对，配合层间符合线路，以利探测并重建更多层面的图像。



图 9-2 常见的 PET/CT 外观图

2、PET/MRI 工作原理

PET/MRI（Positron Emission Tomography and Magnetic Resonance Imaging），全称正电子发射断层与磁共振成像技术，是在 PET（Positron Emission Tomography）和 MRI（Magnetic Resonance Imaging）的基础上发展起来的新设备，该设备将两大医学影像高端检查手段一体化设计，同时具有 PET 功能代谢显像和 MRI 高分辨率的检查功能，使其不但具有完整的、先进的 MRI 功能，而且能够实现 PET 的所有功能。可实现优势互补。同时获取全身 PET 和 MRI 数据，缩短检查时间，是医学成像领域的巨大飞跃，为诊断和了解疾病开启了新大门。

PET/MRI 扫描过程中 PET 对进入体内的正电子核素进行扫描并显像，可获得代谢显像，而 MRI 可对 PET 图像做放射性的衰减校正，提供解剖学和组织学特征，两者结合可以看到组织功能和新陈代谢，提供比传统成像方式更优质的影像结果。系统还可以分别收集 PET 和 MRI 影像。PET/MRI 属于核磁类装置。常见的 PET/MRI 外观图见图 9-3。



图 9-3 常见的 PET/MRI 外观图

本项目拟使用放射性同位素 ^{18}F 配合新增的 PET/CT 和 PET/MRI 进行诊断。当某种放射性核素 ^{18}F 通过注射等方式进入体内后，依其化学及生物学特性不同，随血流等进入某些特定的组织器官，参与或模仿某些生命物质在人体内的病理生理、引流代谢的过程。由于正常组织和病变组织在这个过程中的差异，使其聚集这种放射性核素或其标记物的能力发生了变化。利用 PET 来探测这种放射性核素发射的γ射线在体内的分布状态并还原成图像，其影像不仅可以显示脏器和病变的位置、形态、大小等解剖结构，更重要的是可以显示脏器的功能、代谢情况，提供有关脏器的血流、功能、代谢和引流等方面定性的和定量的信息。而血流、功能和代谢的异常，常是疾病的早期变化，出现在形态结构发生改变之前。因此，PET 放射性核素显像有助于疾病的早期诊断。

3、PET 诊断工作流程、产污环节及污染因子

PET 诊断具体工作流程如下：

①接收患者，开具 PET 诊断单并告知患者诊断过程存在辐射危害；

②医生根据病情确定使用核素的剂量；与患者预约，按需订购放射性药物；

③医院接受检查药物并登记签字，医护人员在注射操作室手套箱内进行药物分装、测量活度；

④病人先进行埋针，然后通过注射将放射性药物摄入。在药品摄入过程中存在γ

射线污染，同时会产生放射性废水、固废(注射器、棉球、药品盒)；

⑤病人注射完药物后进入注射后候诊室内等待观察（一般注射放射性药物后需等待约 30min），待药物代谢至靶器官，进入检查室，经医护人员摆位后，接受扫描，每次扫描约 10～20 分钟。扫描完成后，病人在留观室休息，留观一段时间后，若无其他情况，从病人专用通道离开。此过程病人带有γ射线。

PET/CT 诊断工作流程及产污环节分析见图 9-4。

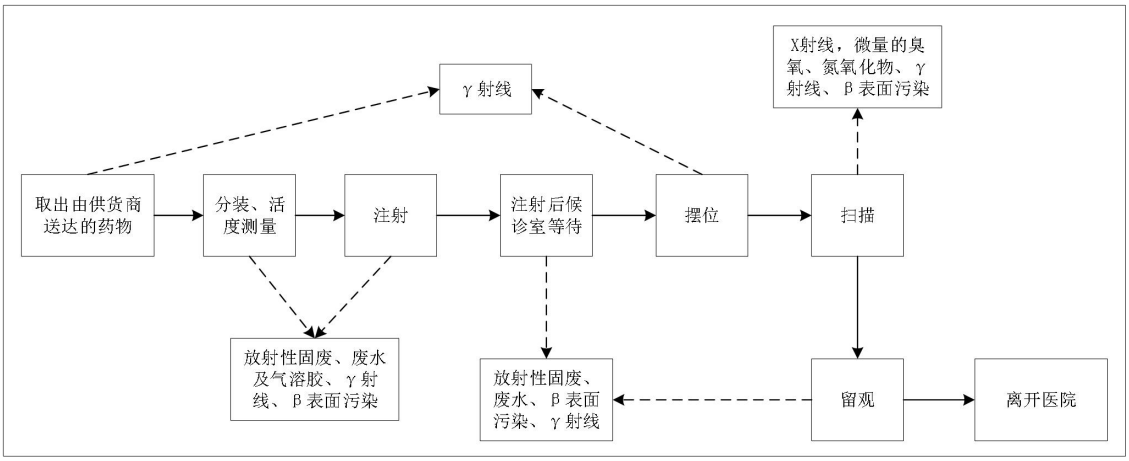


图 9-4 本项目工作流程及产污环节分析示意图

因此，用 ^{18}F 进行 PET 显像主要环境影响为分装、注射对工作人员产生的外照射；注射过程对工作台面、地面等造成的表面污染；操作过程产生的放射性固体废物，如使用放射性药物的注射器、注射针头、可能沾染放射性药物的试管、棉签、手套、口罩、污染擦拭或清洗物等放射性固体废物；操作过程产生的放射性废水，如洗涤废水、注射放射性药物患者的排泄物；PET/CT 扫描时产生的 X 射线。

4、核医学科人流、物流路径规划

本次工作场所控制区和监督区内患者及医护人员均具有独立的出入口和流动路线，同时医院拟采取向患者发放告知单及叫号等措施，合理安排患者就诊时间，避免患者在核医学科工作场所内的随意走动，减少患者间的交叉而受到额外的辐射影响。核医学科工作场所区域划分及患者、医护人员流动路线见图 9-5。

医护人员路径：1、本项目核素操作人员从工作场所西南角的电梯进入核医学科，出电梯后由过厅向北通过卫生通道进入注射操作室，工作完成后原路返回；2、PET/CT 操作人员从工作场所中部的电梯进入核医学科，出电梯后向东通过注射前候诊室再向北通过过道，向西通过骨密度室操作间进入 PET/CT 操作间，进行扫描操作，工作完成后原路返回；3、PET/MRI 操作人员从从西南角的电梯进入核医学科，出电梯后向

东通过过厅和医生办公室向北进入 PET/MRI 操作间。

患者路径：患者从工作场所中部的电梯进入核医学科至预约登记时登记，进入注射前候诊室等待叫号；向西通过患者通道到达注射操作室窗口，接受给药后进入注射后候诊室等待，等待约 10~20min 后再进入 PET/CT 机房或 PET/MRI 机房进行显像检查，检查完毕后在观察室休息约 10min 后离开。该诊断区域内设有专用卫生间，患者在专用卫生间内如厕，不随意走动；诊断期间，患者根据叫号系统提示到相应的位置进行诊断检查。

放射性药物路径：^{18}F 放射性药物由厂商在患者受检前，从工作场所西南角的电梯进入核医学科，出电梯后由过厅向北通过卫生通道进入注射操作室，将药物暂存于注射操作室的手套箱内。

废物路径：每日核医学诊断项目患者离开后，产生的放射性废物从各房间收集后，经缓冲间、注射操作室集中到放射性废物库中，分别标记、分开贮存，在放射性废物间中的铅桶内自然衰变 30 天后，从工作场所西南角的电梯送出。

本次核医学诊断项目相关配套布局能够保证各项工作程序沿着相关房间开展，减少了人员的流动性，有助于实施工作程序；医护人员与患者有各自独立的通道；注射室与检查室分开，给药后候诊室内设置有患者专用卫生间。医院拟采取向患者发放告知单及叫号等措施，避免患者在核医学科工作场所内的随意走动，减少患者间的交叉而受到额外的辐射影响。工作人员离开工作室前洗手和做表面污染监测，如其污染水平超过规定限值，应采取去污措施。从控制区取出任何物件都应进行表面污染水平监测，以保证超过规定限值的物件不携出控制区。本项目丙级非密封放射性物质工作场所布局满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中关于临床核医学工作场所的要求以及《操作非密封源的辐射防护规定》（GB 11930-2010）要求。

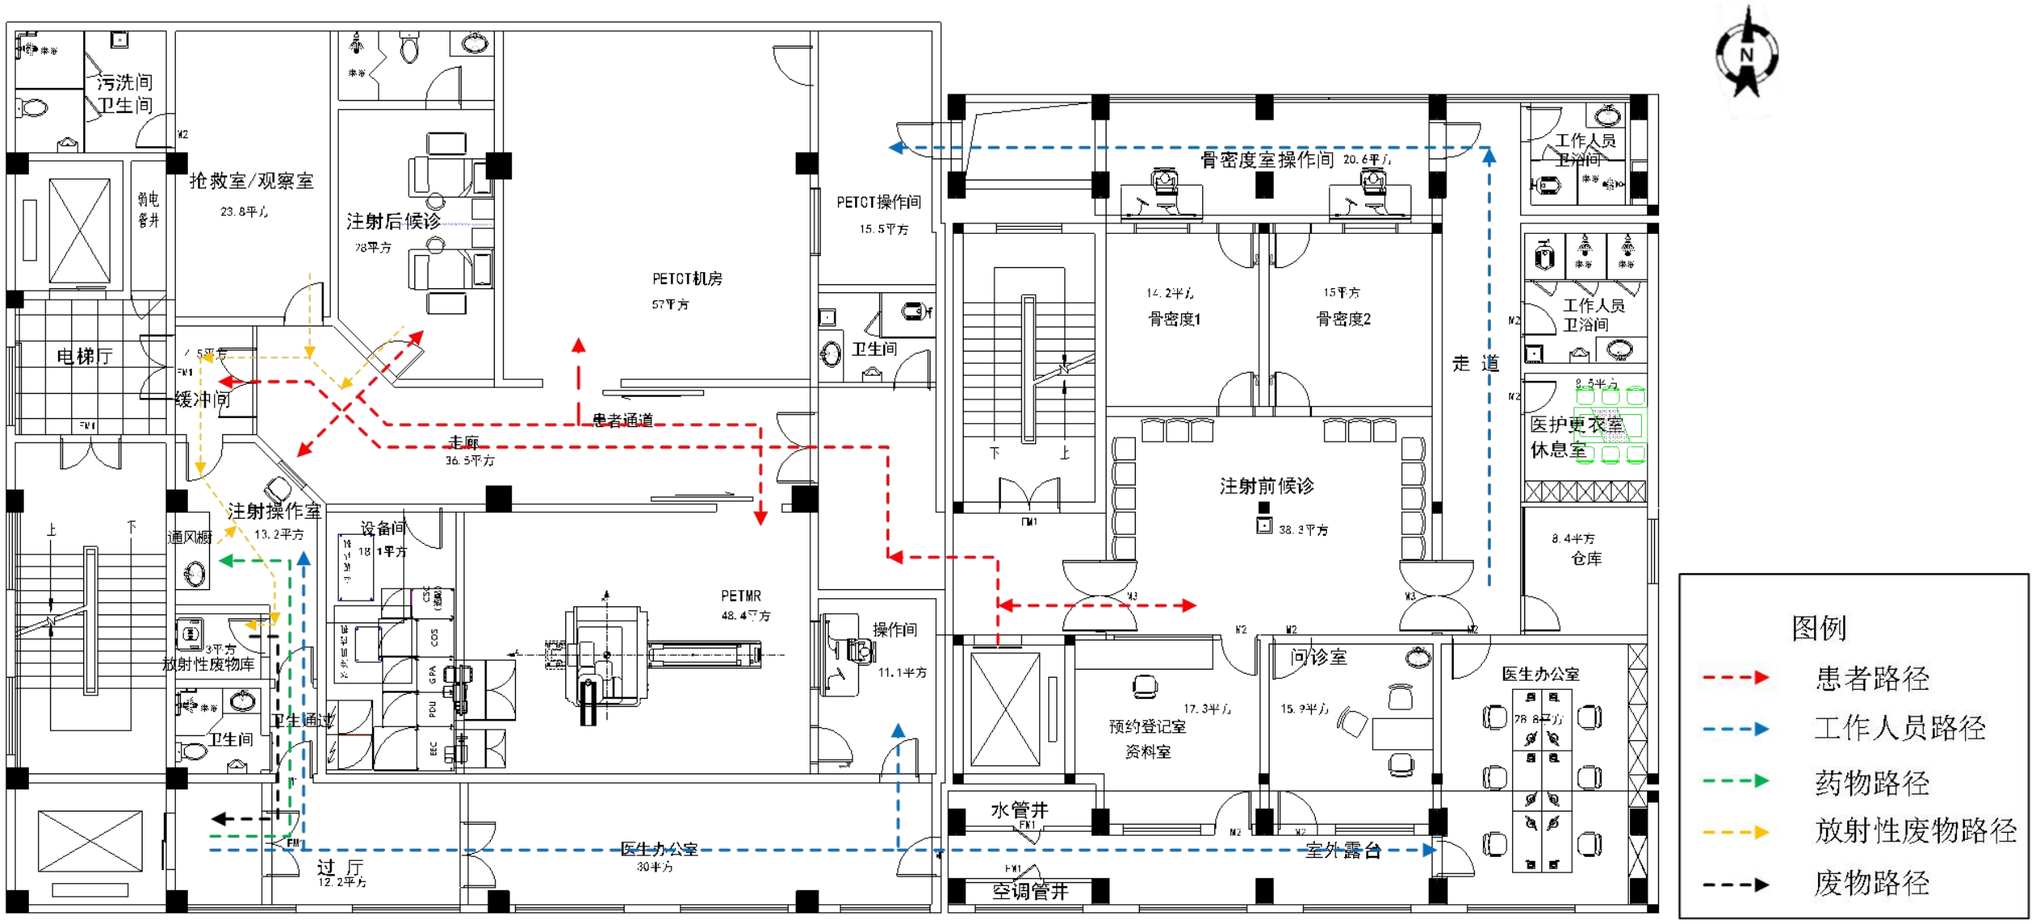


图 9-5　9 号楼 3 楼核医学科工作场所病人、医护人员流动路线图

污染源项描述

一、放射性污染

1、辐射

PET/CT 扫描时产生的 X 射线，能量最大为 140kV；PET 显像检查用 ^{18}F 放射性核素为β^+衰变，在取药、分装、注射、注射后候诊、扫描等操作过程中会产生能量约为 0.63MeV 的β射线，衰变时同时伴随发射能量为 0.511MeV 的γ射线，以上射线会造成医务人员和公众的外照射；在进行 ^{18}F 放射性核素操作过程中，引起操作台面、设备、墙壁、地面、工作服、手套等放射性沾污，造成β放射性表面污染。

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目拟使用的放射性核素种类及其特性见表 9-3。

表 9-3 放射性核素特性一览表

核素名称	半衰期	衰变模式	α/β最大能量（MeV）	光子能量（MeV）	周围剂量率当量率常数（裸源）*（μSv·m²/MBq·h）
^{18}F	109.8min	β^+，EC	0.63（+）	0.511	0.143

*：该数据来源于《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）。

PET/CT 扫描时 CT 发出能量最大为 140kV 的 X 射线，其贯穿能力远弱于放射性核素发出的γ射线，在γ射线得到充分屏蔽的条件下，CT 发出的 X 射线也能够得到足够的屏蔽。β射线穿透能力较弱，对周围环境影响很小，其对周围环境的辐射影响较放射性核素可忽略不计。而放射性核素衰变过程中产生的γ射线穿透能力较强，会对工作场所及周围环境产生一定的外照射影响。故核医学科主要考虑放射性核素发出的γ射线的辐射影响。

2、放射性废气

^{18}F 放射性核素在操作过程中，由于空气的流动而“挥发”出的微量放射性废气，被医务人员或公众吸入体内造成的内照射影响。

3、放射性废水

含有放射性核素的患者排泄物和工作场所清洗废水等。

结合医院现有核医学工作场所开展情况及参考《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中“表 3.2.2”内容，本项目所在建筑物为医院 9 号楼，其中负 2 楼至 2 楼为放疗科，不涉及放射性废水排放；4~6 楼为现有核医学科，其放射性废水统一排

至医院现有长衰变期衰变池组（位于9号楼东北角地下）；3楼为本项目新建核医学科工作场所，其放射性废水排至医院拟新建的1组短半衰期衰变池组（位于9号楼东北角地下现有衰变池南侧）。本次拟新增PET/CT和PET/MRI诊断项目日最大接诊量均为10人次，放射性废水产生量按8L/人次计算，3楼核医学科工作场所每天的清洗废水约为150L，则3楼放射性废水排放总量为310L/d（10人/次×2×8L/人次+150L/d）。

4、放射性固体废物

^{18}F放射性核素操作过程中产生的如注射器、一次性手套、棉签、滤纸等带微量放射性核素的医疗固体废弃物，通风管道内更换下来的废活性炭，污染途径为操作过程中及收集固废过程中和贮存衰变时对医务人员产生的外照射。本项目日接诊量最大为20人次，放射性固体废物产生量按0.02kg/人次计算，则放射性固体废物产生量为0.4kg/d（0.02kg/人×20人/d）。

二、非放射性污染

1、废气

PET/CT机房内的空气在X射线、γ射线作用下，分解产生少量的臭氧、氮氧化物等气体。

2、废水

主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理系统。

3、固体废物

主要是工作人员产生的生活垃圾，分类收集。

表 10　辐射安全与防护

项目安全措施

一、工作场所布局及分区

常州市第一人民医院拟将 9 号楼放疗楼 3 楼现有放疗科工作场所改建成 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所，并新增 1 台 PET/CT（属III类射线装置）和 1 台 PET/MRI。本项目拟使用放射性核素 ^{18}F 配合 PET/CT 和 1 台 PET/MRI 开展核素显像诊断。

常州市第一人民医院本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目拟将 PET/CT 机房、PET/MRI 机房、注射操作室、注射后候诊室、放射性废物库、抢救室/观察室、淋浴间及衰变池等作为辐射防护控制区，将操作间、设备间、过厅、医生办公室、电梯厅及缓冲间等作为辐射防护监督区。本项目工作场所平面布局及辐射防护分区见附图 3。

常州市第一人民医院核医学科工作场所位于 9 号楼放疗楼 3 楼，整个诊断工作场所相对独立，与其他科室有明显的界限。本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目人流及物流具有相对的独立通道，且出入口避开了人流量较大的区域，避免了对公众不必要的照射。

本项目辐射工作场所符合工作要求且有利于辐射防护和环境保护进行布局，功能分区明确，既能有机联系，又不互相干扰，且最大限度避开了人流量较大的门诊区或其它人流活动区；在设计阶段，辐射工作场所进行了合理的优化布局，同时兼顾了病人就诊的方便性，从辐射安全和防护角度分析，其总平面布局合理，满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）中关于临床核医学工作场所的要求以及《核医学防护与安全要求》（HJ 1188-2021）、《操作非密封源的辐射防护规定》（GB 11930-2010）的标准要求。

二、工作场所分级和分类

根据《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）的要求，本项目 9 号楼 3 楼核医学科注射操作室、PET/CT 机房、PET/MRI 机房、注射后候诊室等属于丙级工作场所。该工作场所用房室需要结构屏蔽、地面与墙壁接缝无缝隙、表面易清洗、需要分装柜、保持良好通风、下水管道为普通管道、需要洗手盆（洗手盆应为感应式或脚踏式等手部非接触开关控制）和去污设备。

根据《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）的要求，本项目核医学工

作场所的放射性核素操作设备的表面、工作台台面等平整光滑，室内地面与墙壁衔接处应无接缝，易于清洗、去污。操作放射性药物场所级别达到丙级可在手套箱内进行。应为从事放射性药物操作的工作人员配备必要的防护用品。

三、辐射防护屏蔽设计

根据医院提供的本项目设计资料，本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目工作场所屏蔽设计如表 10-1：

表 10-1 本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目工作场所屏蔽设计一览表

工作场所	屏蔽设计参数（厚度及材质①）				
	四周墙体	顶部	地面	防护门	观察窗
PET/CT 机房	8mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅当量硫酸钡涂料②	8mmPb	8mmPb
PET/MRI 机房	8mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅当量硫酸钡涂料	8mmPb	8mmPb
注射操作室	10mm 铅板	150mm 混凝土+8mm 铅板	150mm 混凝土+8mm 铅当量硫酸钡涂料	10mmPb	40mmPb
抢救室/观察室	8mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅当量硫酸钡涂料	8mmPb	/
注射后候诊室	8mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅当量硫酸钡涂料	8mmPb	/
注射后病人专用卫生间	8mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅板	150mm 混凝土+6mm 铅当量硫酸钡涂料	8mmPb	/
放射性废物库	10mm 铅板	150mm 混凝土+8mm 铅板	150mm 混凝土+8mm 铅当量硫酸钡涂料	10mmPb	/
手套箱	40mmPb 铅当量				

注：①：铅 11.3g/cm^3，混凝土密度为 2.35g/cm^3，硫酸钡涂料 4.5g/cm^3；
②：硫酸钡地面施工：将搅拌好的硫酸钡水泥倒在处理过的施工地面上并使用专用工具将其均匀铺涂，涂刷完第一遍后待完全硬干后再开始涂第二遍。

四、辐射安全措施

1、电离辐射警告标志

医院拟将核医学科划分为控制区和监督区，在控制区入口处（PET/CT 机房、注射操作室、放射性废物库、注射后候诊室、抢救室/观察室等）均拟设置有符合规范的电离辐射警告标志。

2、工作状态指示灯、闭门装置

PET/CT 机房门口拟设置工作状态指示灯，且工作状态指示灯与机房相通的门设

置联锁装置，用于提示机房内设备的运行状态；平开机房门应设有自动闭门装置，推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施。

3、语音对讲、监控装置

医院拟在PET/CT机房与控制室内设置双向语音对讲装置和监控系统，且PET/CT机房控制台处安装有观察窗，在诊断过程中医务人员可以及时观察患者情况和与患者交流，保证诊断质量和防止意外情况的发生。

4、对控制区内带药患者的监督管理

医院拟做好本项目控制区的监督管理工作，防止无关人员入内；拟在控制区出入口设置单向门禁系统，实现“入口只进不出，出口只出不进”的单向路线；加强对控制区内注射放射性药物患者的监督管理，避免其给药后随意走动；同时应告知检查完成后患者离开路线，防止其对公众造成不必要照射。

5、核医学科工作场所安全防护措施管理规定

工作人员离开控制区前洗手和做表面污染监测，如其污染水平超过规定限值，应采取去污措施。从控制区取出任何物件都应进行表面污染水平监测，以保证超过规定限值的物件不携出控制区。满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）的相关要求。

6、工作人员防护用品

医院拟为本项目工作人员配备的辐射防护装置及个人防护用品主要有放射性污染防护服、剂量报警仪、个人剂量计等。

五、监测仪器和防护用品

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，开展放射诊疗的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

常州市第一人民医院已配备1台辐射巡测仪，并为核医学科配备1台表面沾污仪，拟为本项目配备4台个人剂量报警仪。辐射工作人员工作时将佩带个人剂量计，以监测累积受照情况。医院拟定期组织放射工作人员进行职业健康体检，并将按相关要求建立放射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

表10-2 个人防护用品和辅助防护设置配置符合性

场所类型	分项	《核医学放射防护要求》（GBZ120-2020）要求	本项目拟采取措施

正电子放射性药物	工作人员	必备	放射性污染防护服	放射性污染防护服若干
		选备	/	/
	患者或受检者		/	/

六、工作制度及人员配置

工作制度：本项目辐射工作人员年工作天数为250天，实行8小时工作制。

人员配置：本项目拟配置辐射工作人员6人（核医学医生2名、核医学影像学专业技术人员2名、护士2名），均从医院内部调配，配置至本项目后，不从事其他辐射工作。后期随着工作量的不断增加，医院也计划持续引进技术熟练的核医学科医生、技师及护士，医院应做好辐射工作人员管理工作。

三废治理

一、放射性三废

本项目运行期产生的主要放射性三废为核医学工作场所使用非密封性同位素过程中产生的含放射性固废、放射性废水和含放射性核素气溶胶，核医学诊断工作场所拟采取以下“三废”防治措施。

（1）含放射性核素气溶胶

核医学科药品室内的手套箱有独立排风管道，放射性药物的各项操作均在手套箱内进行，手套箱由专业厂商提供，根据《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）中“合成和操作放射性药物所用的手套箱，工作中应有足够风速（一般风速不小于0.5m/s）”要求，医院购买的手套箱排风口处风速不得低于0.5m/s；本项目PET/CT工作场所区域注射操作室、PET/CT机房和PET/MRI机房等均有排风管道连接，要确保非密封放射性物质工作为负压工作场所，工作场所各排风管道须密封良好，不与其他排风管道相通，排风管道布设如附图7所示。

医院拟在排风管道末端处配置高效排风过滤器+活性炭吸附装置二级处理设施，为保证过滤效率的有效性，建设单位需根据设备特性定期进行过滤器维护和校准，过滤器及活性炭需定期更换（1～2次/年），更换后的废活性炭经贮存自然衰变30天后作为医疗废物处置。

常州市第一人民医院9号楼核医学科产生的废气将通过专用排风管引至本楼楼顶排放，排方口高于楼屋顶面和周围建筑，排口不朝向周围高层建筑及周围环境保护目

标，本项目不新增独立排放口；同时为防止公众进入楼顶，建设单位拟将 9 号楼顶划为管控区域，并进行管理。

（2）放射性废水

本项目核医学科产生的含放射性废水包括：工作人员操作过程手部受到微量污染的清洗废水，清扫工作台面、地坪的清洁工具清洗时可能会有带有微量放射性的废水，以及患者冲洗排便用水。

本项目核医学科拟设置有独立的病人专用卫生间，且设置有独立的排水系统，由独立下水管道（详见附图 8）统一集中到医院拟新建的短衰变期衰变池组中（衰变池位于 9 号楼东北角空地地下），衰变池避开了人群集中活动区域。工作场所产生的放射性废水通过预埋好的管道排至现有衰变池系统内，本项目核医学科辐射污水管道均由铅皮包裹并位于建筑体内，对公众的辐射影响较小。该衰变池系统末端设计自动取样监测系统，衰变池结构示意见图 10-1。

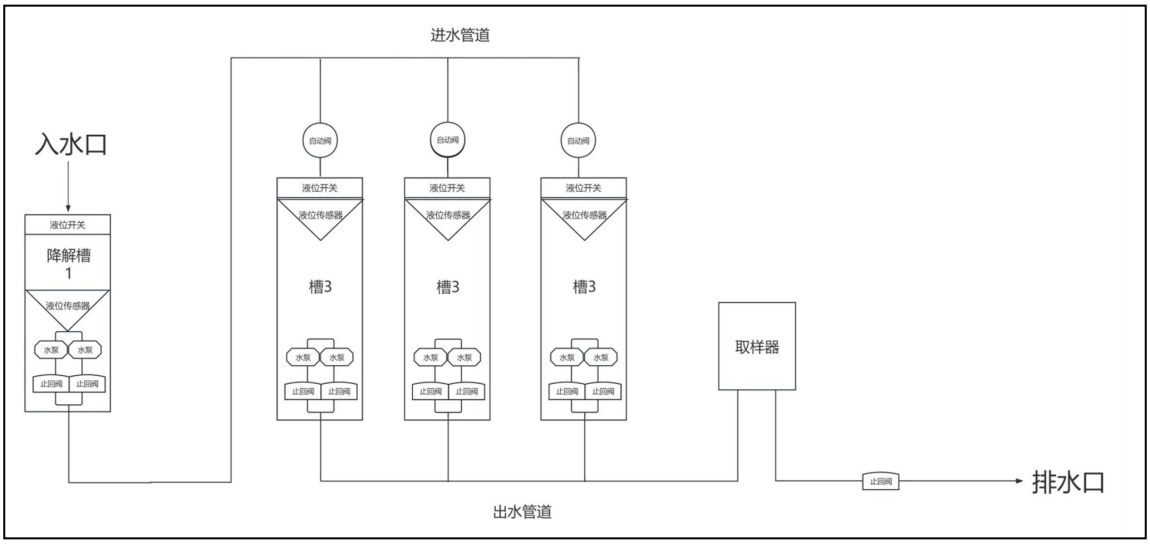


图 10-1 衰变池结构示意图

本项目新建短半衰期衰变池组建设在原衰变池南侧，采用 3 级衰变的混凝土池体，每个衰变池采用不低于 30cm 混凝土浇筑，单个槽体容积≥6m³（2m×1.5m×2m）。各个池体并联设计，当第一个槽体注满后，自动关闭（开始计算衰变期），开启第二个槽体，当第二个槽体注满后，自动关闭，开启第三个槽体，在第三个槽体未注满前第一个槽体达到规定存储时间后开始排放，当第三个槽体注满后，自动关闭，开启第一个槽体，依次循环；整体运行由控制系统进行监控管理。系统末端设计自动取样监测系统，废液经检测符合国家要求后方排放。

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目日最大接诊量均为 10 人次，放射性废水

产生量按 8L/人次计算，3 楼核医学科工作场所每天的清洗废水约为 150L，则 3 楼放射性废水排放总量为 310L/d（10 人/次×2×8L/人次+150L/d）。

根据该放射性废水衰变池设计原理，该衰变系统（衰变池容积为 18m^3）内可存放放射性废水约 58d，故本项目衰变系统能够满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中“所含核素半衰期小于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 30 天后可直接解控排放”的要求。

为进一步保证衰变池的长效可靠运行及人员安全，医院应切实做好衰变池排放台账，记录每次排放时间、排放量及监测结果情况并由专人负责管理。

（3）放射性固废

本项目产生的放射性废物主要为：工作人员操作过程产生的一次性卫生用品、垫料等（约 0.4kg/d），以及定期更换下的废高效过滤器滤芯及废活性炭等。工作场所拟将上述放射性固体废物（废活性炭除外）采用专用塑料包装袋专门收集，包装袋要标明收贮时间、种类及数量等内容，按序封闭暂存于放射性衰变桶（10mm 铅当量）内，最后转移至废物间内，让放射性物质自行衰变，经检测符合排放标准后，按照医疗废物交由有资质单位进行处置。更换下来的废活性炭暂存在废物间内，待其暂存满 30d 后作为医疗废物处置。

二、非放射性三废

（1）废气：核素操作过程中，空气因电离产生的少量臭氧和氮氧化物可通过核医学科工作场所均拟设置的排风系统排至室外，常温下臭氧约 50min 可自动分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

（2）废水：工作人员产生的医疗废水和生活污水，将进入医院污水处理系统，处理达标后排入城市污水管网，对周围环境影响较小。

（3）固体废物：产生的医疗废物集中收集后交资质单位处置；生活垃圾经分类收集后，交由市政环卫部门处理，对周围环境影响较小。

表 11　环境影响分析

建设阶段对环境的影响

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目工作场所建设时主要工作为建筑施工、墙体隔断与内饰装潢，将产生施工噪声、扬尘和建筑垃圾污染，建设施工时对环境会产生如下影响：

1、大气：本项目在建设施工期需进行的墙体隔断等作业，各种施工将产生地面扬尘，另外机械作业时排放废气和扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施：及时清扫施工场地，设立围挡，并保持施工场地一定的湿度。

2、噪声：整个建筑施工阶段，如墙体拆除、墙体连接等施工中都将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准，尽量采用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。

3、固体废物：项目施工期间，会产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托由有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。

医院在施工阶段计划采取上述污染防治措施，将施工期的影响控制在医院院区内部，对周围环境影响较小。

运行阶段对环境的影响

一、辐射环境影响分析

根据本项目的工程分析可知，PET/CT 和 PET/MRI 核素诊断项目辐射影响主要包括护士分装、取药和活度测量（保守按照 2min 估算）、药物注射（保守按照 1min 估算）、病人候诊（等候约 20min）和病人扫描（扫描过程约 20min）4 个过程，主要污染因子为 ^{18}F 放射性核素在取药、注射、注射后候诊、扫描等操作过程中产生的β、γ射线；PET/CT 装置 CT 扫描时产生的 X 射线，主要对工作人员及室外公众产生外照射辐射影响。

1、β射线辐射影响分析

β射线的穿透性能较差，根据《辐射防护手册（第三分册）》，β射线在不同物质

中与最大射程对应的防护厚度为：

$$d=\frac{1}{2\rho}E_{\rho\max}$$ 公式 11-1

式中：$E_{\beta max}$—β射线的能量，MeV；

ρ—物质的密度，g/cm^3。

d—与最大射程对应的防护厚度，cm。

主要计算参数及结果见表 11-1。

表 11-1 与最大射程对应的防护厚度计算参数及结果

核素	β射线最大能量（MeV）	屏蔽材料	材料密度（g/cm^3）	对应的防护厚度（cm）
^{18}F	0.63	铅	11.3	0.03
		混凝土	2.35	0.14
		硫酸钡水泥	4.5	0.07

本项目手套箱采用铅板及铅玻璃进行防护，工作场所墙体和顶部均采用铅板，地面采用硫酸钡涂料，各防护门均采用铅防护门，观察窗均为铅玻璃观察窗进行辐射防护，本项目 ^{18}F 放射性核素β射线在上述屏蔽材料中射程均极短。

综上所述，本项目涉及使用的 ^{18}F 放射性核素在整个过程中均采取了有效的屏蔽措施屏蔽β射线，同时在整个使用过程中辐射工作人员还穿戴有 0.5mm 铅当量的防护铅服，且周围公众与放射性核素之前还采取了距离隔离措施，因此β射线对辐射工作人员和周围公众辐射影响很小。

2、γ射线辐射影响分析

参考《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）附录 I 中第 1.2 款 ^{99m}Tc 诊断、^{131}I 治疗、PET 等工作场所的屏蔽计算，保守起见，所有核素（如 ^{99m}Tc、^{131}I、^{18}F 等）工作场所的屏蔽，可采用瞬时剂量率计算方法。

$$x=TVL\times\lg(\frac{A\cdot\Gamma}{\dot{H}_p\times r^2})$$ （I.1）

式中：x—屏蔽厚度，mm；

TVL—γ射线的十分之一值层厚度，mm；

A—单个患者或者受检者所用放射源的最大活度，MBq；

Γ—距源 1m 处的周围剂量当量率常数，μSv·m²/MBq·h；

$\dot{H}_p$—屏蔽体外关注点剂量率，μSv/h；

R—放射源到考察点的距离，m。

由公式 I.1 推导可得：

$$\dot{H}_p = \frac{A \cdot \Gamma}{r^2} 10^{(-\frac{x}{TVL})} \qquad \text{公式 11-2}$$

由《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）查出铅、混凝土和实心砖对 ^{18}F 什值层见表 11-2。

表 11-2 常用核素屏蔽材料十分之一值层厚度（*TVL*）

核素	铅（11.3g/cm³）	砖（1.65g/cm³）	混凝土（2.35g/cm³）
^{18}F	16.6mm	263mm	176mm

根据工程分析可知，核医学诊断项目辐射影响主要包括药物分装（含质控的活度测量过程）、注射、患者候诊、扫描和留观等过程，主要对核医学科工作人员及室外公众产生外照射辐射影响，根据公式 11-2 可估算出核医学科项目周围各参考点处的辐射水平，各参考点位置见图 11-1，预测结果见表 11-3。

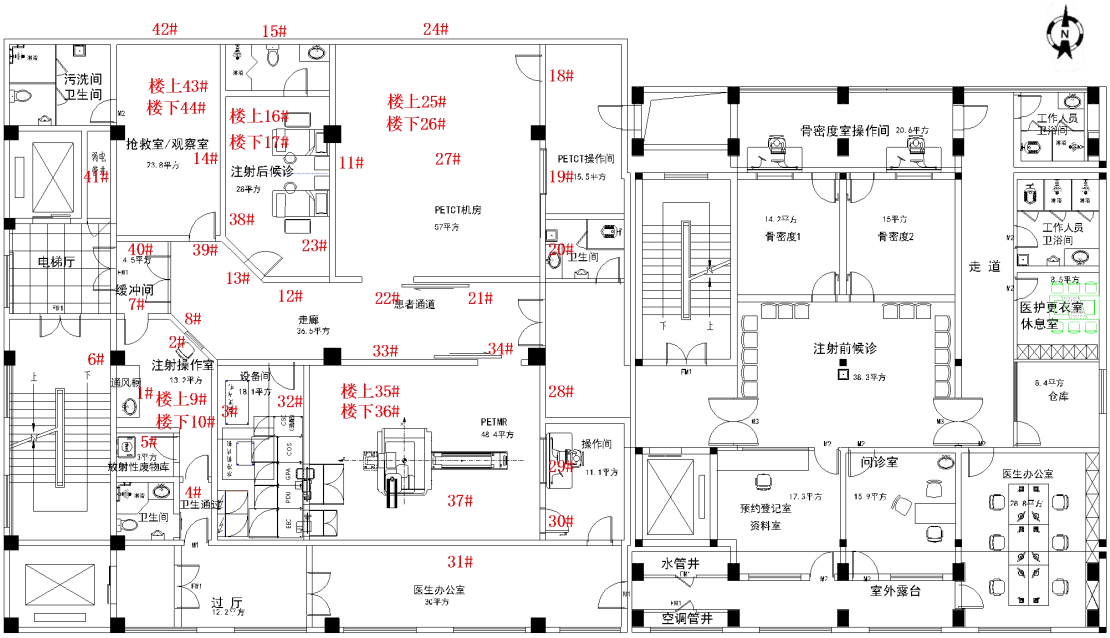


图 11-1 本项目核医学场所剂量率估算点位示意图

表 11-3 本项目核医学工作场所辐射水平估算结果

点位		参考点位置	源强（Bq）	与源的距离（m）	屏蔽材料及厚度[1)]	透射比	参考点辐射水平（μSv/h）	控制目标值（μSv/h）	备注
本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目	1	手套箱东侧取药工作位[2)]	2.96×10^{10}	0.5	40mmPb+40mmPb	1.52×10^{-5}	0.003	/	铅罐为 40mmPb，手套箱为 40mmPb
	2	注射位	$10\times3.70\times10^{7}$	0.5	0.5mmPb+40mmPb	3.63×10^{-3}	0.769	/	铅服为 0.5mmPb，注射窗为 40mmPb
	3	注射操作室东墙外 30cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	2.33	10mmPb	2.50×10^{-1}	2.435	2.5	/
	4	注射操作室南侧防护门外 30cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	3.80	10mmPb	2.50×10^{-1}	0.915	2.5	/
	5	注射操作室南墙外 30cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	1.97	10mmPb	2.50×10^{-1}	3.406	25	/
	6	注射操作室西墙外 30cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	2.70	10mmPb	2.50×10^{-1}	1.813	2.5	/
	7	注射操作室北侧防护门外 30cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	2.78	10mmPb	2.50×10^{-1}	1.710	25	/
	8	注射操作室东北墙外 30cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	2.54	10mmPb	2.50×10^{-1}	2.049	25	/
	9	注射操作室楼上地面 100cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	3.35	150mm 混凝土+8mmPb	4.63×10^{-2}	0.218	2.5	/
	10	注射操作室楼下地面 170cm 处	$10\times3.70\times10^{7}$	2.65	150mm 混凝土+硫酸钡涂料 6mmPb	6.11×10^{-2}	0.461	2.5	/
	11	注射后候诊室东墙外 30cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	2.40	8mmPb	3.30×10^{-1}	3.896	25	假设有 2 人候诊
	12	注射后候诊室南墙外 30cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	3.92	8mmPb	3.30×10^{-1}	1.461	25	
	13	注射后候诊室西南侧防护门外 30cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	3.55	8mmPb	3.30×10^{-1}	1.781	25	
	14	注射后候诊室西墙外 30cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	2.20	8mmPb	3.30×10^{-1}	4.637	25	
	15	注射后候诊室北墙外 30cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	5.19	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.833	2.5	

	16	注射后候诊室楼上地面 100cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	3.35	150mm 混凝土+6mmPb	6.11×10^{-2}	0.371	2.5	
	17	注射后候诊室楼下地面 170cm 处	$20\times3.70\times10^{7}$	2.65	150mm 混凝土+硫酸钡涂料 6mmPb	6.11×10^{-2}	0.593	2.5	
	18	PET/CT 机房东侧防护门外 30cm 处	3.06×10^{8}	5.24	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.338	2.5	假设 1 人检查，经 30min 候诊等待，病人体内核素活度为 3.06×10^{8}Bq
	19	PET/CT 机房东侧观察窗外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.08	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.558	2.5	
	20	PET/CT 机房东墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	5.03	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.367	2.5	
	21	PET/CT 机房南墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.68	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.424	25	
	22	PET/CT 机房南侧防护门外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.72	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.417	25	
	23	PET/CT 机房西墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.09	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.555	25	
	24	PET/CT 机房北墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.55	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.449	2.5	
	25	PET/CT 机房楼上地面 100cm 处	3.06×10^{8}	3.35	150mm 混凝土+6mmPb	6.11×10^{-2}	0.153	2.5	
	26	PET/CT 机房楼下地面 170cm 处	3.06×10^{8}	2.65	150mm 混凝土+硫酸钡涂料 6mmPb	6.11×10^{-2}	0.245	2.5	
	27	摆位/取消摆位	3.06×10^{8}	1.0	铅服 0.5mmPb	9.33×10^{-1}	26.278	/	
	28	PET/MRI 机房东墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.90	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.387	2.5	假设 1 人检查，经 30min 候诊等待，病人体内核素活度为 3.06×10^{8}Bq
	29	PET/MRI 机房东侧观察窗外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.28	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.507	2.5	
	30	PET/MRI 机房东侧防护门外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.78	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.406	2.5	
	31	PET/MRI 机房南墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	3.26	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.874	2.5	
	32	PET/MRI 机房西墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.74	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.413	2.5	

	33	PET/MRI 机房北墙外 30cm 处	3.06×10^{8}	3.80	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.643	25	
	34	PET/MRI 机房北侧防护门外 30cm 处	3.06×10^{8}	4.40	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.480	25	
	35	PET/MRI 机房楼上地面 100cm 处	3.06×10^{8}	3.35	150mm 混凝土+6mmPb	6.11×10^{-2}	0.153	2.5	
	36	PET/MRI 机房楼下地面 170cm 处	3.06×10^{8}	2.65	150mm 混凝土+硫酸钡涂料 6mmPb	6.11×10^{-2}	0.245	2.5	
	37	摆位/取消摆位	3.06×10^{8}	1.0	铅服 0.5mmPb	9.33×10^{-1}	26.278	/	
	38	抢救室/观察室东墙外 30cm	5.40×10^{8}	2.00	8mmPb	3.30×10^{-1}	4.092	25	假设 2 人留观，经 30min 候诊等待、20min 扫描，病人体内核素活度为 5.40×10^{8}Bq
	39	抢救室/观察室南侧防护门外 30cm	5.40×10^{8}	4.26	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.902	25	
	40	抢救室/观察室南墙外 30cm	5.40×10^{8}	4.11	8mmPb	3.30×10^{-1}	0.969	2.5	
	41	抢救室/观察室西墙外 30cm	5.40×10^{8}	2.60	8mmPb	3.30×10^{-1}	2.421	2.5	
	42	抢救室/观察室北墙外 30cm	5.40×10^{8}	3.53	8mmPb	3.30×10^{-1}	1.313	2.5	
	43	抢救室/观察室楼上地面 100cm 处	5.40×10^{8}	3.35	150mm 混凝土+6mmPb	6.11×10^{-2}	0.270	2.5	
	44	抢救室/观察室楼下地面 170cm 处	5.40×10^{8}	2.65	150mm 混凝土+硫酸钡涂料 6mmPb	6.11×10^{-2}	0.432	2.5	

注：1、本项目透射比是根据核素对不同材料的什值层厚度计算得出，铅板密度为 11.34g/cm^3，混凝土密度为 2.35g/cm^3，硫酸钡水泥密度为 4.5g/cm^3；

2、手套箱内药物最多 2.96×10^{10}Bq；

3、核医学科 PET/CT 诊断项目核素分装、注射阶段，周围剂量当量率常数（裸源）取 0.143μSv·m^2/MBq·h，注射后带药患者候诊、扫描、留观阶段，患者体内单位放射性活度所致体外 1m 处的周围剂量当量率保守按裸源取 0.143μSv·m^2/MBq·h；

4、核医学科注射后候诊室各休息位之间有铅板隔离，计算时选取距离参考点最近的休息位作为源强位置；

5、本次计算，考虑病人注射后候诊 30min，在机房内扫描 20min，计算核素活度的衰减。

由表 11-3 的理论估算结果可以看出，由于有 40mm 铅当量手套箱屏蔽，^{18}F 药物取药、分装过程中对操作人员的躯干辐射影响较小，但由于需要用手操作，手部剂量较高。^{18}F 药物针剂外设有铅套、同时操作中工作人员穿戴铅防护服。^{18}F 药物在操作过程中及患者在显像过程中对注射操作室、注射后候诊室、抢救室/观察室、PET/CT 机房及 PET/MRI 机房外的环境影响较小，注射操作室、注射后候诊室、抢救室/观察室、PET/CT 机房及 PET/MRI 机房的防护设计均能够满足 ^{18}F 核素的辐射防护要求。候诊期间由于患者相对集中，医院必须采取分批预约、分批注射、分批候诊的方式，严格按要求控制候诊室内患者的数量，减少对患者与对外环境的辐射影响。

3、CT 环境影响分析

本项目按额定管电压 140kV 核算 PET/CT 机房各屏蔽部位屏蔽材料的等效铅当量厚度。本项目 PET/CT 机房辐射防护设计及其等效铅当量见表 11-4。

表 11-4 核医学科 PET/CT 机房辐射防护设计及其等效铅当量一览表

参数		设计厚度 1)	铅当量 2)	屏蔽要求	评价
PET/CT 机房	四周墙体	8mm 铅板	8mm	CT 机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向、非有用线束方向铅当量 2.5mm。	满足
	防护门	8mm 铅板	8mm		满足
	观察窗	8mm 铅当量	8mm		满足
	顶部	150mm 混凝土+8mm 铅板	9.63mm		满足
	地面	150mm 混凝土+ 6mm 铅当量硫酸钡涂料	7.63mm		满足
	面积	57.07m^2，最小单边长度为 7.1m		CT 机房内最小有效新建面积不小于 30m^2，单边长度不小于 4.5m。	满足

注：1、混凝土密度为 2.35g/cm^3，铅板密度为 11.34g/cm^3，硫酸钡水泥密度为 4.5g/cm^3；

2、混凝土参照 GBZ 130-2020 中表 C.5 及表 C.6 中等效铅当量厚度数值采用插值法求得。

由上表可知，核医学科 PET/CT 机房屏蔽防护措施能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的标准要求。

本项目 PET/CT 机房辐射屏蔽主要考虑散射辐射与泄漏辐射的影响。本项目 PET/CT，以 CT 模式运行时，其常用最大管电流约为 200mA、最大管电压为 140kV，根据《辐射防护手册（第一分册）》P448 的能量散射公式计算一次散射能量与初级射线能量的比值，140kV 射线经过一次散射后的射线能量约为 109.9kV，故本项目保守按 120kV 进行计算。

（1）关注点处散射辐射空气比释动能率计算

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平 潘自强著）给出的X射线机散射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.10）进行推导，得到散射线在关注点处的比释动能率 H_s 的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1）：

$$H_s = \frac{H_0 \cdot I \cdot a \cdot (s/400) \cdot B_s}{d_0^2 \cdot r^2} \qquad \text{公式 11-3}$$

式中：H_0—X 射线机发射率常数（当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1m 处由主束产生的比释动能率），$mGy \cdot m^2 \cdot mA^{-1} \cdot min^{-1}$，具体数值可根据 X 射线机管电压、过滤片等条件从《辐射防护导论》附图 3 查取，按本项目 CT 的最大管电压为 140kV、过滤片为 2.5mmAl 的条件从《辐射防护导论》附图 3 查得 H_0 为 $15mGy \cdot m^2 \cdot mA^{-1} \cdot min^{-1}$，即 $900000\mu Gy \cdot m^2 \cdot mA^{-1} \cdot h^{-1}$；

I—管电流，mA；本项目 CT 模式下正常使用的最大管电流为 200mA；

a—人体对 X 射线的散射照射量与入射照射量之比值，查《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1，本项目最大常用管电压为 140kV，采用内插法查取散射角 90º时 140kV 对应的 a 值为 0.0016；

S—主束在受照人体上的散射面积，本项目取 $314cm^2$；

d_0—源至受照点的距离，本项目保守取 0.6m；

r—受照体至关注点的距离；

B_s—屏蔽材料对散射线的透射因子，无量纲，计算公式见式 11-4：

$$B_s = \left[\left(1+\frac{\beta}{\alpha}\right)e^{\alpha\gamma X} - \frac{\beta}{\alpha}\right]^{-\frac{1}{\gamma}} \qquad \text{公式 11-4}$$

式中：X—铅厚度，本项目机房屏蔽体的铅厚度见表 11-4；

α、β、γ—铅对不同管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数，具体见表 11-5。

表 11-5 铅对不同管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数

管电压	α	β	γ
140kV（CT）	2.009	3.99	0.342
120kV（CT）	2.246	5.730	0.5470

（2）关注点处泄漏辐射空气比释动能率计算

泄漏辐射剂量率$\dot{H}_L$采用下式计算：

$$\dot{H}_L = \frac{H_i \cdot B}{r^2}$$ 公式 11-5

式中：H_i—距靶 1m 处泄漏射线的空气比释动能率，mGy/h；本项目 1m 处泄漏射线的空气比释动能率取 0.8mGy/h。

B—屏蔽材料对散射线的透射因子，无量纲，计算公式见式 11-4。

按照公式 11-5 计算屏蔽物质的屏蔽透射因子 B，机房外关注点处的辐射剂量率理论估算结果汇总见表 11-6。

表 11-6 PET/CT 机房 CT 出束状态下参考点处及叠加 ^{18}F 放射性药物的辐射剂量率核算值

点位	参考点位置	r（m）	散射辐射 H_s		泄漏辐射 H_L		剂量率估算值 H（μSv/h）	^{18}F 致参考点辐射水平（μSv/h）	^{18}F 与 CT 叠加致参考点辐射水平（μSv/h）	控制目标值（μSv/h）	是否满足
			B_s	H_s（μGy/h）	B	H_L（μGy/h）					
18	PET/CT 机房东侧防护门外 30cm 处	5.24	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.338	0.338	2.5	满足
19	PET/CT 机房东侧观察窗外 30cm 处	4.08	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.558	0.558	2.5	满足
20	PET/CT 机房东墙外 30cm 处	5.03	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.367	0.367	2.5	满足
21	PET/CT 机房南墙外 30cm 处	4.68	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.424	0.424	25	满足
22	PET/CT 机房南侧防护门外 30cm 处	4.72	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.417	0.417	25	满足
23	PET/CT 机房西墙外 30cm 处	4.09	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.555	0.555	25	满足
24	PET/CT 机房北墙外 30cm 处	4.55	1.55×10^{-9}	＜0.001	4.31×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.449	0.449	2.5	满足
25	PET/CT 机房楼上地面 100cm 处	3.35	3.99×10^{-11}	＜0.001	1.62×10^{-10}	＜0.001	＜0.001	0.153	0.153	2.5	满足
26	PET/CT 机房楼下地面 170cm 处	2.65	3.56×10^{-9}	＜0.001	9.08×10^{-9}	＜0.001	＜0.001	0.245	0.245	2.5	满足

注：PET/CT 机房 CT 出束状态下参考点处剂量率估算值 $H=H_S\cdot K_S+H_L\cdot K_L$，式中：$K_S$、$K_L$ 为有效剂量与空气比释动能转换系数，查《用于光子外照射放射防护的剂量转换系数》（GBZ/T 144-2002）表 B2，K_S 取 1.69，K_L 取 1.64。

计算结果表明，PET/CT 以 CT 模式运行（工况：140kV/200mA）时，叠加放射性药物的辐射影响，机房四周墙体、顶部及防护门处的辐射剂量率为（0.153～0.555）μSv/h，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中的要求。

4、保护目标的有效剂量估算

根据表 11-6 的各关注点处辐射剂量率，结合工作时间，辐射工作人员和公众停留概率，即可得到各关注点处公众及辐射工作人员的年受照剂量，见表 11-7。

表 11-7 本项目工作场所公众及辐射工作人员年有效剂量估算

点位	参考点位置	参考点辐射水平（μSv/h）	参考点处受放射性核素影响的时间	居留因子	参考点人员有效剂量（mSv/a）	关注对象	位置
1	取药工作位	0.003	取药 1min×20 次×250 天	1	<0.001	工作人员	注射操作室
2	注射位	0.769	注射 1min×20 次×250 天	1	0.064	工作人员	注射操作室
3	注射操作室东墙外 30cm 处	2.435	注射 1min×20 次×250 天	1/16	0.013	工作人员	设备间
4	注射操作室南侧防护门外 30cm 处	0.915	注射 1min×20 次×250 天	1/8	0.010	工作人员	卫生通过间
5	注射操作室南墙外 30cm 处	3.406	注射 1min×20 次×250 天	1/4	0.071	工作人员	放射性废物库
6	注射操作室西墙外 30cm 处	1.813	注射 1min×20 次×250 天	1/40	0.004	公众	楼梯
7	注射操作室北侧防护门外 30cm 处	1.710	注射 1min×20 次×250 天	1/8	0.018	公众	缓冲间
8	注射操作室东北墙外 30cm 处	2.049	注射 1min×20 次×250 天	1/5	0.034	公众（患者）	患者通道
9	注射操作室楼上地面 100cm 处	0.218	注射 1min×20 次×250 天	1	0.018	公众（患者）	ECT 机房
10	注射操作室楼下地面 170cm 处	0.461	注射 1min×20 次×250 天	1/5	0.008	公众	走道
11	注射后候诊室东墙外 30cm 处	3.896	候诊 30min×10 次×250 天	1	4.871	工作人员	PET/CT 机房
12	注射后候诊室南墙外 30cm 处	1.461	保守估计经过此区域患者停留 10s	1/5	<0.001	公众（患者）	患者通道
13	注射后候诊室西南侧防护门外 30cm 处	1.781	保守估计经过此区域患者停留 10s	1/8	<0.001	公众（患者）	患者通道
14	注射后候诊室西墙外 30cm 处	4.637	候诊 30min×10 次×250 天	1/4	2.898	公众（患者）	抢救室/观察室
15	注射后候诊室北墙外 30cm 处	0.833	候诊 30min×10 次×250 天	1/16	0.065	公众	室外临空

16	注射后候诊室楼上地面 100cm 处	0.371	候诊 30min×10 次×250 天	1/8	0.058	公众（患者）	运动室、医生走道
17	注射后候诊室楼下地面 170cm 处	0.593	候诊 30min×10 次×250 天	1/16	0.046	公众	放射生物室、病案资料室
18	PET/CT 机房东侧防护门外 30cm 处	0.338	检查 20min×10 次×250 天	1/8	0.035	工作人员	PET/CT 操作间
19	PET/CT 机房东侧观察窗外 30cm 处	0.558	检查 20min×10 次×250 天	1	0.465	工作人员	PET/CT 操作间
20	PET/CT 机房东墙外 30cm 处	0.367	检查 20min×10 次×250 天	1/16	0.019	公众	卫生间
21	PET/CT 机房南墙外 30cm 处	0.424	检查 20min×10 次×250 天	1/5	0.071	公众（患者）	患者通道
22	PET/CT 机房南侧防护门外 30cm 处	0.417	检查 20min×10 次×250 天	1/8	0.043	公众（患者）	患者通道
23	PET/CT 机房西墙外 30cm 处	0.555	检查 20min×10 次×250 天	1/16	0.029	公众（患者）	注射后候诊室
24	PET/CT 机房北墙外 30cm 处	0.449	检查 20min×10 次×250 天	1/16	0.023	公众	室外临空
25	PET/CT 机房楼上地面 100cm 处	0.153	检查 20min×10 次×250 天	1/4	0.032	公众（患者）	注射后候诊室、医生走道
26	PET/CT 机房楼下地面 170cm 处	0.245	检查 20min×10 次×250 天	1/16	0.013	公众	验证设备间、物理室
27	摆位/取消摆位	26.278	（摆位 1min+取消摆位 1min)×10 次×250 天	1	2.190	工作人员	PET/CT 机房
28	PET/MRI 机房东墙外 30cm 处	0.387	检查 20min×10 次×250 天	1/5	0.064	公众	走道
29	PET/MRI 机房东侧观察窗外 30cm 处	0.507	检查 20min×10 次×250 天	1	0.422	工作人员	PET/MRI 操作间
30	PET/MRI 机房东侧防护门外 30cm 处	0.406	检查 20min×10 次×250 天	1/8	0.043	工作人员	PET/MRI 操作间
31	PET/MRI 机房南墙外 30cm 处	0.874	检查 20min×10 次×250 天	1	0.728	工作人员	医生办公室
32	PET/MRI 机房西墙外 30cm 处	0.413	检查 20min×10 次×250 天	1/16	0.022	工作人员	设备间
33	PET/MRI 机房北墙外 30cm 处	0.643	保守估计经过此区域患者停留 10s	1/5	<0.001	公众（患者）	患者通道
34	PET/MRI 机房北侧防护门外 30cm 处	0.480	检查 20min×10 次×250 天	1/8	0.050	公众（患者）	患者通道
35	PET/MRI 机房楼上地面 100cm 处	0.153	检查 20min×10 次×250 天	1	0.128	工作人员	ECT 机房
36	PET/MRI 机房楼下地面 170cm 处	0.245	检查 20min×10 次×250 天	1/16	0.013	公众（患者）	走道、TPS 计划室

37	摆位/取消摆位	26.278	（摆位 1min+取消摆位 1min)×10 次×250 天	1	2.190	工作人员	PET/MRI 机房
38	抢救室/观察室东墙外 30cm	4.092	留观 10min×20 次×250 天	1/16	0.213	公众（患者）	注射后候诊室
39	抢救室/观察室南侧防护门外 30cm	0.902	留观 10min×20 次×250 天	1/8	0.094	公众（患者）	患者通道
40	抢救室/观察室南墙外 30cm	0.969	留观 10min×20 次×250 天	1/16	0.050	公众	缓冲间
41	抢救室/观察室西墙外 30cm	2.421	留观 10min×20 次×250 天	1/40	0.050	公众	电梯
42	抢救室/观察室北墙外 30cm	1.313	留观 10min×20 次×250 天	1/16	0.068	公众	室外临空
43	抢救室/观察室楼上地面 100cm 处	0.270	留观 10min×20 次×250 天	1/4	0.056	公众（患者）	注射室、高活性室
44	抢救室/观察室楼下地面 170cm 处	0.432	留观 10min×20 次×250 天	1/16	0.023	公众	更衣室、保洁间、走道

核医学诊断项目过程中，工作人员主要受照射环节为分装、注射过程及患者扫描诊断过程。一般情况下，取药过程约 1 分钟，送至注射窗口、注射过程约 1 分钟，扫描过程约 20 分钟。预测本项目运行后，PET/CT 诊断项目日接诊量最大为 10 人次。本项目 PET/CT 以 CT 模式运行的时间较短，平均每名患者约 20s，机房内 CT 出束致公众及辐射工作人员年有效剂量估算见表 11-8。

表 11-8 PET/CT 机房内 CT 出束致公众及辐射工作人员年有效剂量估算

点位	参考点位置	CT 致参考点辐射水平（μSv/h）	参考点处受 CT 影响的时间	居留因子	CT 致参考点人员有效剂量（mSv/a）	关注对象	位置
18	PET/CT 机房东侧防护门外 30cm 处	＜0.001	检查 20s×10 次×250 天	1/8	＜0.001	工作人员	PET/CT 操作间
19	PET/CT 机房东侧观察窗外 30cm 处	＜0.001		1	＜0.001	工作人员	PET/CT 操作间
20	PET/CT 机房东墙外 30cm 处	＜0.001		1/16	＜0.001	公众	卫生间
21	PET/CT 机房南墙外 30cm 处	＜0.001		1/5	＜0.001	公众	患者通道
22	PET/CT 机房南侧防护门外 30cm 处	＜0.001		1/8	＜0.001	公众	患者通道
23	PET/CT 机房西墙外 30cm 处	＜0.001		1/16	＜0.001	公众	注射后候诊室
24	PET/CT 机房北墙外 30cm 处	＜0.001		1/16	＜0.001	公众	室外临空

25	PET/CT 机房楼上地面 100cm 处	＜0.001		1/4	＜0.001	公众	注射后候诊室、医生走道
26	PET/CT 机房楼下地面 170cm 处	＜0.001		1/16	＜0.001	公众	验证设备间、物理室

根据上述估算结果，取药过程中工作人员受到的年有效剂量＜0.001mSv，注射过程中工作人员受到的年有效剂量为 0.064mSv，PET/CT 扫描过程中工作人员受到的年有效剂量约为 2.655mSv（0.465mSv/a+＜0.001mSv/a+2.190mSv/a），PET/MRI 运行过程中工作人员受到的年有效剂量约为 2.610mSv（0.422mSv/a+2.190mSv/a）。医院拟为本项目安排 2 名护士（负责分装及注射）、2 名医师及 2 名技师（负责操作设备、指导病人摆位）。医院拟合理安排各辐射工作人员工作量，根据理论估算可知，均能够满足职业人员年有效剂量不超过 5mSv 的限值要求。

根据上述估算结果，本项目工作过程中，周围公众（控制区外）年有效剂量最大为 0.068mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）对公众受照剂量限值要求以及本项目剂量约束值要求（公众年有效剂量不超过 0.1mSv）。

本项目 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所上方为 ECT 工作场所，各机房屏蔽防护效果均满足相关标准要求，ECT 工作场所距本项目最近距离约 3m，且由实体墙隔开，故 ECT 工作场所内辐射源对本项目核医学科的辐射影响较小。

二、放射性“三废”影响分析

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目运行过程中会产生含 ^{18}F 的放射性废水，核素操作过程中会产生少量放射性气溶胶。

1、放射性废气

在进行液态放射性药物活度操作过程中，若放射性药物液面处于开放状态，空气中可能挥发微量放射性同位素，污染途径为放射性药物在空气中挥发散逸造成人员吸入的内照射。本项目 PET/CT 工作场所分装注射室设有 1 个 ^{18}F 专用手套箱（40mm 铅当量），本项目核素操作均在手套箱中进行，手套箱内保持负压且设有排风系统（设计通风速率不少于 0.5m/s，排放口高于本建筑屋顶），满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）中“排气口应高于本建筑物屋顶”的要求，能够有效防止放射性废气对周围环境产生的影响，符合放射性工作场所相关要求。同时医院拟在手套箱管道内及屋顶排放口处设置活性炭过滤吸附装置，对放射性气溶胶进行吸附，降低放射性

气溶胶外排浓度，吸附材料应定期更换（一年更换1～2次）并作为放射性固体废物处理。整个核医学科工作场所均拟设置新风系统及独立的排风系统。

2、放射性废水

来自本项目工作场所给药后患者专用卫生间等高活区的放射性废水，含有^{18}F等放射性核素，由独立下水管道统一集中到核医学科现有的衰变池中。

本项目新建短半衰期衰变池组建设在原衰变池南侧，采用3级衰变的混凝土池体，每个衰变池采用不低于30cm混凝土浇筑，单个槽体容积≥6m³（2m×1.5m×2m）。各个池体并联设计，当第一个槽体注满后，自动关闭（开始计算衰变期），开启第二个槽体，当第二个槽体注满后，自动关闭，开启第三个槽体，在第三个槽体未注满前第一个槽体达到规定存储时间后开始排放，当第三个槽体注满后，自动关闭，开启第一个槽体，依次循环；整体运行由控制系统进行监控管理。系统末端设计自动取样监测系统，废液经检测符合国家要求后方排放。

本次新增PET/CT和PET/MRI诊断项目日最大接诊量均为10人次，放射性废水产生量按8L/人次计算，3楼核医学科工作场所每天的清洗废水约为150L，则3楼放射性废水排放总量为310L/d（10人/次×2×8L/人次+150L/d）。

根据该放射性废水衰变池设计原理，该衰变系统（衰变池容积为18m³）内可存放放射性废水约58d，故本项目衰变系统能够满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中“所含核素半衰期小于24小时的放射性废液暂存时间超过30天后可直接解控排放”的要求。

本项目对^{18}F放射性核素进行管道外辐射剂量计算。将专用管道中的放射性废水看作线源，其对周围环境产生的辐射影响参照《辐射防护导论》（方杰主编）中相关公式进行计算：

$$\dot{K}=\frac{2A\Gamma_K}{Lr}tg^{-1}\frac{L}{2r} \qquad \text{公式 11-6}$$

式中：K—比释动能率，$Sv\cdot s^{-1}$；

A—总活度，Bq；

Γ_K—距源1m处的周围剂量当量率常数，$Sv\cdot m^2\cdot Bq^{-1}\cdot h^{-1}$；

L—线源长度，m；

r—线源到考察点的距离，m。

表 11-9 核医学中心专用管道外剂量估算结果

参数	取值
单次排放 ^{18}F 核素活度 1)	3mCi
	1.11×10^{8}Bq
Γ_K：距源 1m 处的周围剂量当量率常数（$Sv\cdot m^2\cdot Bq^{-1}\cdot h^{-1}$）2)	0.143×10^{-12}
L：线源长度（m）	0.5
r：线源到考察点的距离（m）3)	0.3
屏蔽材料及厚度（mm）	5mm 铅
参考点处辐射剂量率（μSv/h）	＜0.001
周围公众受照时间（s）	1s/次×（20 次/天+20 次/天）×250 天
周围公众受照剂量（mSv/a）	＜0.01

注：1、单次 PET/CT 诊断项目患者，排泄物内核素活度排泄比率保守按 30%进行计算，则单次排放 ^{18}F 核素活度为 10mCi×30%=3mCi/次；

2、距源 1m 处的周围剂量当量率常数取自《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）附录 H 表 H.1；

3、本项目工作场所位于 9 号楼 3 楼，放射性废水管道经由地下通到衰变池，管道无暴露部分，线源到参考点距离 r 保守取 0.3m。同时管道外采用 5mmPb 铅皮包覆进行辐射防护。

由表 11-9 可知，放射性废水专用管道对周围公众产生的辐射影响较小。

3、放射性固体废物

核医学科产生的放射性固体废物主要有废弃的注射器、一次性手套、棉签、滤纸等。本项目工作场所设有放射性废物库，注射操作室、注射后候诊室等房间且房间内均拟设置 1～2 个放射性废物桶（防护厚度不低于 20mmPb，以保证其外表面 30cm 处的周围剂量当量率小于 2.5μSv/h）。

根据医院对本项目规划的工作量估算每年产生放射性固体废物量，PET 诊断项目日接诊量最大为 20 人次，放射性固体废物产生量按 0.02kg/人次计算，则放射性固体废物产生量为 0.4kg/d（体积约为 $1m^3$/月），核医学科各房间内放射性废物桶放置点应避开工作人员与其它人员经常走动的地方，并设置有电离辐射警告标志。

核医学科各房间收集的含放射性废物应分别标记、分开贮存（标记主要核素类型、收集时间等）后集中到放射性废物间中的铅桶（放射性废物间中设置若干铅桶，防护厚度不低 10mmPb）中暂存，在放射性废物间内暂存时间超过 30 天，经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平、α表面污染小于 $0.08Bq/cm^2$、β表面污染小于 $0.8Bq/cm^2$

的，作为医疗废物进行处理。

手套箱通风管道内更换下来的废活性炭，在放射性废物间内暂存时间超过 30 天，经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平、α表面污染小于 0.08Bq/cm^2、β表面污染小于 0.8Bq/cm^2 的，作为医疗废物进行处理。

本项目核医学科的放射性废物间面积约为 3.0m^2，总容积约为 9.0m^3。放射性废物间的有效使用面积按房间总容积的 30%计算，约为 2.7m^3，该放射性废物间容积能够满足放射性固体废物贮存 30 天的要求。

三、非放射性“三废”影响分析

1、废气

PET/CT 机房内的空气在 X 射线、γ射线作用下分解产生少量的臭氧、氮氧化物等气体，通过动力排风装置排入大气，臭氧常温下约 50min 可自行分解为氧气，对周围环境影响较小。

2、废水

工作人员和部分患者产生的医疗废水和生活污水，由院内污水处理站统一处理。

3、固体废物

工作人员和病人产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理。

事故影响分析

本项目新增 PET/CT 为Ⅲ类射线装置，核医学科工作场所为丙级非密封放射性物质工作场所。医院在开展放射诊断过程中，如果安全管理或防护不当，可能对人员产生误照射。因此本项目主要事故风险为：

（1）PET/CT 工作状态下，未按工作流程进行清场，人员误留、误入机房内，导致发生误照射。

（2）PET/CT 机房门机联锁失效，导致防护门无法自动关闭，开机时防护门外工作人员或公众受到误照射。

（3）操作人员违反操作规程或误操作，造成意外超剂量照射。

（4）核医学科药物注射时，注射器排气有可能挤出放射性药物，注射器有损漏以及注射针头没有装牢固，造成放射性药物泼洒或者散逸挥发，产生γ辐射，操作台面或仪器设备受到放射性污染。

（4）注射药物的患者未按要求停留于控制区，导致公众遭受较大剂量照射。

（5）由于保管或管理工作不到位，导致 ^{18}F 放射性核素的丢失、被盗，使公众受到误照射。

（6）放射性废水专用管道长期使用老化破裂，或衰变池渗漏，造成核医学科地面受到放射性污染。

针对本项目可能发生的辐射事故，可采取以下的处理措施：

（1）发生误照射（人员误留、误入机房内；操作人员违反操作规程或误操作；机房门-机联锁装置失效，导致防护门无法自动关闭），应立即按下急停开关，确保 PET/CT 停止工作。

（2）迅速安排受照人员接受医学检查和救治。

（3）发生非密封放射性物质污染，封闭工作场所，控制人员走动，以避免放射性污染扩散，并进行场所和人员的去污。

（4）药物注射前，告知患者注意事项，使之了解放射性药物对他人的危害，并加强对带药患者的监督管理。

（5）对发生事故的射线装置，请有关供货单位或相关检测部门进行检测或维修，分析事故发生的原因，并提出改进意见。

（6）医院应定期对核医学科工作场所辐射安全措施进行检查、维护，发现问题及时维修；每次工作前均应检查相应辐射安全装置的有效性，定期对工作场所进行检测。医院还应在平时工作中加强工作人员的辐射防护知识的培训，尽可能避免辐射事故的发生。

（7）事故发生后，积极配合生态环境等管理部门做好事故调查和善后处理工作。

医院应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，在事故发生后 1 小时内向所在地生态环境和公安部门报告，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》。造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；对于可能受到大剂量照射的人员，迅速安排医学检查和救治，积极配合政府管理部门做好事故调查和善后工作。

表 12　辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置

常州市第一人民医院拟在门急诊医技楼地下一层核医学科新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目，用于医疗诊断。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用丙级非密封放射性物质工作场所和使用Ⅲ类射线装置的单位，应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以文件形式明确管理人员职责。从事辐射工作的人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并考核。

根据上述要求，常州市第一人民医院已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。医院应根据本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目修订相关文件，明确医院相关辐射项目的管理人员及其职责，将该项目辐射安全管理纳入全院的辐射安全管理工作中。医院拟为本项目配备 6 名辐射工作人员，为医院原有辐射工作人员。辐射安全管理人员与辐射工作人员须通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规，辐射安全管理人员应参加“辐射安全管理”辐射防护上岗考核。核医学科的辐射工作人员“核医学”辐射安全与防护考核，考核合格后方可上岗；同时如有辐射培训证书到期人员还应及时参加生态环境部的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并通过考核。

辐射安全管理规章制度

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的有关要求，使用射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施”。目前常州市第一人民医院已制定相关辐射安全与防护管理制度。医院现有管理制度内容较为全面，基本满足医院从事相关辐射活动辐射安全和防护管理的要求，拟根据本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目的特点及以下内容制定并完善相关制度，并落实到实际

工作中，严格执行，加强辐射安全管理。

1）操作规程：明确辐射工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的具体防护措施及步骤。重点是：

①提高辐射工作人员对放射性药物操作的熟练程度，尽量减少辐射工作人员与放射性药物的近距离接触时间；

②确保开展辐射工作时所有辐射屏蔽措施均已到位，严格按照规定操作流程操作，防止发生辐射事故；

③从事辐射工作时必须佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪；

④在工作场所严禁吸烟、进食；

⑤放射性“三废”的处理需严格按照操作规程执行。

2）岗位职责：明确射线装置、放射性药品使用工作人员、台帐管理人员、药物注射人员及辐射安全管理人员的岗位责任，并落实到个人，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任。

3）辐射防护和安全保卫制度：根据射线装置及放射性药物操作的具体情况制定相应的辐射防护和安全保卫制度。重点是：

①定期检查相关的辐射安全装置及检测仪器，发现问题及时修理或更换，确保辐射安全联锁装置、个人剂量报警仪、环境辐射剂量监测仪和表面沾污仪保持良好工作状态；

②工作人员定期开展个人剂量检测和职业健康监护；

③放射性药物注射后患者应严格限制在控制区内；

④当注射后候诊室内有多位注射放射性药物的患者同时候诊时，建议医院在患者之间采用铅屏风进行隔离，减少患者间的交叉辐射影响。

4）设备维修制度：明确射线装置和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，并做好记录。确保射线检测装置、安全措施（联锁装置、警示标志、工作指示灯、急停按钮）、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。

5）放射性同位素使用登记制度：建立放射性同位素台帐，重点是：放射性药物的使用、贮存情况等由专人负责登记、专人形成台帐、每月核对，确保帐物相符。

6）人员培训计划和健康管理制度：明确培训对象、内容、周期、方式以及考核

的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。相关辐射工作人员应及时学习最新的国家政策法规及标准，熟练掌握放射性防护知识、最新的操作技术。根据18号令及《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并通过考核。医院应组织新进辐射工作人员定期参加职业健康体检（不少于1次/2年），并为其建立辐射工作人员职业健康监护档案。

7）监测方案：明确监测频次和监测项目。监测结果定期上报生态环境行政主管部门。为了确保非密封放射性物质工作场所及III类射线装置的辐射安全，该单位应制定监测方案，重点是：

①明确监测项目和频次；

②辐射工作人员个人剂量监测数据应建立个人剂量档案，依据《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正），在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理；

③对发生放射性药物泼洒的事故处理进行全程监测；

④医院应当按照有关标准、规范的要求定期对工作场所及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测，发现异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告；

⑤委托有资质监测单位对本单位的放射性同位素和射线装置的安全和防护状况进行年度检测，每年1月31日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，年度评估发现安全隐患的，应当立即整改。医院2022年度评估报告已上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，且医院现有核技术利用项目辐射防护检测结果满足相关标准要求。

辐射监测

根据辐射管理要求，常州市第一人民医院拟配备辐射巡测仪1台、表面污染仪1台、个人剂量报警仪共4台，用于辐射防护监测和报警，同时结合本项目实际情况，拟制定如下监测计划，见表12-1：

表 12-1 本项目拟制定监测计划

监测内容		监测方式	监测点位	监测频次	备注
工作场所监测	辐射水平	自检	控制区和监督区所有工作人员和公众可能居留的有代表性的点位和存有放射性物质的装置/设备表面	不少于 1 次/月	保留自检记录
		委托有资质单位	项目周围环境	1～2 次/年	出据检测报告
	表面放射性污染	自检	放射性核素操作台、设备表面、墙面和地面，给药后患者候诊室，核素治疗场所的设施、墙面和地面等，放射性废物桶和包装袋表面，工作人员的手、皮肤暴露部分及工作服、手套、鞋、帽等。	每次工作结束后对核医学工作场所进行表面放射性污染检测	保留自检记录
个人剂量		委托有资质单位	辐射工作人员配备的个人剂量计	不少于 1 次/季	建立个人剂量档案
职业健康体检		委托有资质单位	辐射工作人员	不少于 1 次/2 年	建立个人职业健康档案

当出现外照射事故，立即采取应急措施，并在 1 小时之内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

常州市第一人民医院已根据上述监测计划，明确监测项目，定期（不少于 1 次/季）使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，并保留自检记录，每年委托有资质的单位定期对项目周围环境 X-γ辐射剂量率进行监测，监测结果上报生态环境行政主管部门。

常州市第一人民医院已为辐射工作人员配备个人剂量计，组织辐射工作人员进行个人剂量监测（1 次/季）和职业健康体检（1 次/2 年），医院公共卫生科负责全院人员个人剂量的收发和管理，职业健康监护、个人剂量监测档案均存放于公共卫生科。

常州市第一人民医院每年编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告年度评估报告，包括放射性同位素与射线装置台账、辐射安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容，每年 1 月 31 日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。

辐射事故应急

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关规定，辐射事故应急预案应明确以下几个方面：

①应急机构和职责分工；

②应急的具体人员和联系电话；

③应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；

④辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；

⑤辐射事故调查、报告和处理程序。

对于在医院定期监测或委托监测时发现异常情况的，医院应根据《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》(原国家环保总局，环发[2006]145号）和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，并在事故发生后1小时内向所在地生态环境和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。

常州市第一人民医院已经制定了《放射事故应急预案》，该预案已包括成立辐射事故应急处理领导小组、应急预案领导小组的职责、放射性事故应急处理的责任划分、放射性事故应急处理程序和放射性事故的调查等内容。由辐射事故应急处理领导小组组织各相关科室，定期（1 次/年）开展应急培训演练，在物资、通讯、技术、人员、经费等准备方面均加以落实。医院开展核技术利用项目至今，暂未发生辐射事故。

表 13　结论与建议

结论

一、项目概况

常州市第一人民医院位于常州市局前街 185 号。为了适应医院发展要求，服务患者，常州市第一人民医院拟将 9 号楼放疗楼 3 楼现有放疗科工作场所改建成 PET/CT 和 PET/MRI 核医学科工作场所，并新增 1 台 PET/CT（属Ⅲ类射线装置）和 1 台 PET/MRI。本项目拟使用放射性核素 ^{18}F 配合 PET/CT 和 PET/MRI 开展核素显像诊断。本项目拟建成后医院 9 号楼 3 楼核医学科工作场所为丙级非密封放射性物质工作场所。本项目利用医院拟新建的 1 组短半衰期衰变池组对放射性废水进行处置。

二、项目建设的必要性及产业政策符合性

本项目的建设可为医院提供多种诊断手段，有着重要临床应用价值，可为患者提供放射诊断服务，并可提高当地医疗卫生水平。对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年修订），不属于“限制类”或“淘汰类”项目，符合国家现行的产业政策。

三、实践正当性

本项目的运行，具有良好的社会效益和经济效益，经落实辐射防护屏蔽设计和安全管理措施后，本项目的建设和运行对受照个人和社会公众所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

四、选址合理性

常州市第一人民医院位于常州市局前街 185 号，医院东侧和南侧为唐家湾路，西侧为晋陵中路，北侧为局前街。

本次新增 PET/CT 和 PET/MRI 工作场所位于医院 9 号楼放疗楼 3 楼，9 号楼放疗楼东侧为 1 号楼门急诊大楼，南侧隔院内道路为 3 号楼综合病房大楼，西侧为院内停车场，北侧为 10 号楼锅炉房、11 号楼实验楼和护王府遗址。

本项目 PET/CT 机房东侧为 PET/CT 操作间，南侧为患者通道，西侧为注射后候诊室，北侧室外临空，上方为 ECT 注射后候诊室，下方为物理室和验证设备间。本项目 PET/MRI 机房东侧为 PET/MRI 操作间，南侧为医生办公室，西侧为设备间，北侧

患者通道，上方为 ECT 机房和操作室，下方为 TPS 计划室。本项目衰变池位于医院 9 号楼东北角空地地下。

本项目工作场所周围 50m 评价范围均位于医院内，无学校、居民区等环境敏感点。项目运行后的环境保护目标主要为核医学辐射工作人员、评价范围内其他医务人员、病患及其他公众等。

本项目核医学科工作场所拟划分控制区及监督区，其中核医学科工作场所控制区和监督区内患者及医护人员均具有独立的出入口和流动路线，相关配套布局能够保证工作程序沿着相关房间单向开展，能够有效防止交叉污染，核医学科工作场所控制区内设置有患者专用卫生间，避免公众、工作人员受到不必要的外照射，布局合理。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目所在地块位于江苏常州市中心城区（天宁区）重点管控单元（编码：ZH32040223869）内，不在常州市生态保护红线内，评价范围内也不涉及优先保护单元和一般管控单元。本项目核技术利用项目，满足重点管控单元管控要求（详见附件 8，江苏省生态环境分区管控综合查询报告书）。本项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。

五、辐射环境现状评价

常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目拟建址及其周围环境γ辐射剂量率在 59nGy/h～111nGy/h 之间，检测结果位于江苏省环境天然贯穿辐射水平涨落区间；常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目拟建址及其周围环境β表面污染水为 0.11Bq/cm^2~0.15Bq/cm^2。

六、环境影响评价

根据预测估算结果，常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目在落实本报告提出的各项辐射安全与防护措施的情况下，核医学工作场所各控制区内房间防护门、观察窗和墙壁外表面的周围剂量当量率小于 2.5μSv/h，控制区内屏蔽体外表面 0.3m 处的周围剂量当量率控制目标值不大于 25μSv/h，满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）和《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）中的要求。项目投入运行后对辐射工作人员和公众所受辐射剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众年有效剂量限值要求以及本项目剂量约束值要求（职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过

0.1mSv）。

七、“三废”的处理处置

核医学科核素操作均在手套箱中进行，手套箱内保持负压且设有排风系统（通风速率不少于0.5m/s，9号楼核医学科总排放口高于本建筑屋脊），管道内及外排放口处设置活性炭过滤吸附装置，能够有效防止放射性废气对周围环境产生的影响；来自核医学科工作场所的注射操作室、给药后患者专用卫生间等高活区的放射性废水，含有^{18}F放射性核素，由独立下水管道（管道无室外暴露部分同时管道外采用铅皮包裹）统一集中到医院拟新建的1套短半衰变期衰变池组中（衰变池位于9号楼东北角空地地下），衰变30天满足排放标准后流入医院污水处理系统作为医疗废水处理；核医学科产生的放射性固体废物集中到放射性废物间中的放射性废物桶中暂存，在放射性废物间内自然衰变30天后，作为医疗废物进行处理。

PET/CT机房内的空气在X射线、γ射线作用下分解产生少量的臭氧、氮氧化物等气体，通过动力排风装置排入大气，臭氧常温下约50min可自行分解为氧气，对周围环境影响较小；工作人员和部分患者产生的生活污水，由院内污水处理站统一处理；工作人员和病人产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

八、主要污染源及拟采取的主要辐射安全防护措施

常州市第一人民医院新增PET/CT和PET/MRI诊断项目，根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），确定9号楼3楼核医学科工作场所为丙级非密封放射性物质工作场所。

核医学科PET/CT机房扫描时产生的X射线；^{18}F放射性核素在取药、分装、注射、注射后候诊、扫描等操作过程中产生的γ射线，以上射线会造成医务人员和公众的外照射。本项目工作场所控制区出入口拟设置“当心电离辐射”警告标志；PET/CT机房入口处拟设置“当心电离辐射”警告标识和工作状态灯。PET/CT机房设置有门机联锁装置，机房内外均设置有急停按钮，核医学科工作场所控制区出入口设置单向门禁系统，符合《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）及《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中的安全管理要求。

九、辐射安全管理评价

常州市第一人民医院已设立辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院拟制定辐射安全管理制度，建议根据本报告的要求，对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，建立符合本院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度，并在日常工作中落实。

常州市第一人民医院已为本项目辐射工作人员配置个人剂量计，定期送有资质部门监测个人剂量，建立个人剂量档案；定期进行健康体检，建立个人职业健康监护档案。常州市第一人民医院已为核医学配备辐射巡测仪 1 台、表面沾污仪 1 台及个人剂量报警仪共 4 台。此外，医院应根据相关标准要求，为核医学诊断项目工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述，常州市第一人民医院新增 PET/CT 和 PET/MRI 诊断项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。

建议和承诺

1、该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

2、根据防护与安全的最优化原则，进一步优化完善辐射工作场所屏蔽措施。

3、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

4、定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。

5、医院取得本项目环评批复后，应及时申请辐射安全许可证，按照法规要求开展竣工环境保护验收工作，环境保护设施的验收期 限一般不超过 3 个月，最长不超过 12 个月。

辐射污染防治“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施		预期效果	预计投资（万元）
辐射安全管理机构	建立辐射安全与环境保护管理机构，或配备不少于 1 名大学本科以上学历人员从事辐射防护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。		满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。	/
辐射安全和防护措施	防护措施	屏蔽措施：核医学科工作场所四侧墙体采用铅板进行辐射防护，顶部采用混凝土+铅板进行辐射防护，地面采用硫酸钡涂料进行辐射防护，各防护门均采用铅防护门，观察窗均为铅玻璃观察窗进行辐射防护。详见表 10-6。	满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目的目标管理值要求。	
	安全措施	核医学科工作场所控制区入口处（包括 PET/CT 机房、PET/MRI 机房、注射操作室、放射性废物间、注射后候诊室、抢救室/观察室等）、放射性废物桶表面设置电离辐射警告标志，同时在 PET/CT 机房防护门处设置工作状态指示灯及闭门装置，并设置急停按钮及对讲装置，核医学科控制区出入口设置单向门禁系统。	满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）及《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。	
	放射性“三废”处理措施： 本项目核素操作均在手套箱中进行，手套箱内保持负压且设有排风系统（通风速率不少于 0.5m/s，排放口高于本建筑屋脊），管道内及外排放口处设置活性炭过滤吸附装置，符合非密封放射性物质工作场所相关要求。 本项目产生的放射性废水由专用下水管道统一集中到医院 1 套短半衰变期衰变池组中（衰变池位于 9 号楼东北角空地地下），衰变 30 天满足排放标准后流入医院污水处理系统作为医疗废水处理。 本项目产生的放射性固体废物集中到放射性废物间中的铅桶中暂存，在放射性废物间内自然衰变 30 天后，作为医疗废物进行处理。		满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）、《操作非密封源的辐射防护规定》（GB 11930-2010）及《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）的相关要求。	
人员配备	辐射安全管理人员和辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并考核，考核合格后上岗。		满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。	
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计，并定期送检（两次监测的时间间隔不应超过 3 个月），加强个人剂量监测，建立个人剂量档案。			

	辐射工作人员定期进行职业健康体检（不少于 1 次/2 年），并建立辐射工作人员职业健康档案。		
监测仪器和防护用品	拟配备辐射巡测仪 1 台。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求。	
	拟配备表面沾污仪 1 台。		
	拟配备个人剂量报警仪 4 台。		
	本项目工作场所拟配备 1 个手套箱，放射性污染防护服若干。	满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）及《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。	
辐射安全管理制度	制定操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度：根据环评要求，按照项目的实际情况，补充相关内容，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》有关要求。	/
总计	/	/	

以上污染防治的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。