

核技术利用建设项目

江苏省苏北人民医院

扩建 2 台 DSA 项目环境影响报告表



江苏省苏北人民医院

2026 年 4 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

江苏省苏北人民医院

扩建 2 台 DSA 项目环境影响报告表

建设单位名称：江苏省苏北人民医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：江苏省扬州市广陵区南通西路 98 号

邮政编码：

联系人：

电子邮箱：

联系电话：

# 目 录

表 1 项目基本情况.....	- 1 -
表 2 放射源.....	- 5 -
表 3 非密封放射性物质.....	- 5 -
表 4 射线装置.....	- 6 -
表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）.....	- 7 -
表 6 评价依据.....	- 8 -
表 7 保护目标与评价标准.....	- 11 -
表 8 环境质量和辐射现状.....	- 15 -
表 9 项目工程分析与源项.....	- 23 -
表 10 辐射安全与防护.....	- 30 -
表 11 环境影响分析.....	- 38 -
表 12 辐射安全管理.....	- 60 -
表 13 结论与建议.....	- 66 -
表 14 审批.....	- 71 -
附图 1-1 江苏省苏北人民医院本部院区扩建 DSA 项目地理位置示意图.....	- 72 -
附图 1-2 江苏省苏北人民医院开发区院区扩建 DSA 项目地理位置示意图.....	- 73 -
附图 2-1 江苏省苏北人民医院本部院区平面布局及周围环境示意图.....	- 74 -
附图 2-2 江苏省苏北人民医院开发区院区平面布局及周围环境示意图.....	- 75 -
附图 3-1 本部院区九号楼一楼 DSA 手术室平面布置及周围环境示意图（改造前）.....	- 76 -
附图 3-2 本部院区九号楼一楼 DSA 手术室平面布置及周围环境示意图（改造后）.....	- 77 -
附图 4 开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室平面布置及周围环境示意图.....	- 78 -
附图 5 本部院区九号楼负一楼平面布局示意图.....	- 79 -
附图 6 本部院区九号楼一楼平面布局示意图.....	- 80 -
附图 7 本部院区九号楼二楼平面布局示意图.....	- 81 -
附图 8 开发区院区医技楼二楼平面布局示意图.....	- 82 -
附图 9 开发区院区医技楼三楼平面布局示意图.....	- 83 -
附图 10 开发区院区医技楼四楼平面布局示意图.....	- 84 -
附件 1：项目委托书.....	- 85 -

附件 2: 射线装置使用承诺书 .....	- 86 -
附件 3: DSA 机房屏蔽设计说明 .....	- 88 -
附件 4: 辐射安全许可证 .....	- 89 -
附件 5: 辐射环境现状监测报告 .....	- 98 -
附件 7: 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 .....	- 111 -
附件 8: 医院现有核技术应用项目基本情况一览表 .....	- 118 -
附件 9: 个人剂量监测报告 .....	- 122 -

表 1 项目基本情况

建设项目名称		江苏省苏北人民医院扩建 2 台 DSA 项目			
建设单位		江苏省苏北人民医院 (统一社会信用代码: 12321000468830683C)			
法人代表	■	联系人	■	联系电话	■
注册地址		江苏省扬州市广陵区南通西路 98 号			
项目建设地点		扬州市广陵区南通西路 98 号、扬州市邗江区定浦路 6 号			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资 (万元)	■	项目环保总投资 (万元)	■	投资比例(环保 投资/总投资)	■
项目性质		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他		占地面积 (m <sup>2</sup> )	/
应用 类型	放射源	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> I 类 (医疗使用) <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
	非密封 放射性 物质	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> 制备 PET 用放射性药物		
		<input type="checkbox"/> 销售	/		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙		
	射线 装置	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input checked="" type="checkbox"/> 使用	<input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
	其他	/			
	<p><b>项目概述:</b></p> <p><b>一、建设单位基本情况、项目建设规模及由来</b></p> <p>江苏省苏北人民医院(以下简称“医院”)创建于 1900 年,其前身是美国浸礼会创办的扬州浸会医院。1949 年江苏省立扬州医院改名为江苏省苏北人民医院,1953 年迁入扬州浸会医院旧址。1994 年,医院被原卫生部评定为江苏省首批三级甲等综合性医院。医院现有本部院区(扬州市邗江区定浦路 6 号)和开发区院区(扬州市广陵区南通西路 98 号)共 2 个院区,开放床位 2556 张,承担扬州及毗邻地区近千万人口</p>				

的医疗和保健任务。2024年，医院门、急诊病人220.1万人次，出院病人14.8万人次，手术总量5.54万台。

为改善医疗条件，适应医院发展需要，满足日益增长的患者就诊需求，医院拟在本部院区和开发区院区各扩建1台DSA，均用于医疗诊断和引导介入手术。本部院区拟将九号楼一楼现有外科诊室、骨科诊室等区域改造为1间DSA机房及配套辅助用房并拟配备1台Allia IGS Pulse型DSA，单球管，其最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA；开发区院区拟于医技楼三楼新建1间DSA机房及配套辅助用房并拟配备1台Optima IGS Ultra型DSA，单球管，其最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA。

根据医院提供资料并从保守估算考虑，本项目投运后，每台DSA开展手术量约为1500台。江苏省苏北人民医院现有38名DSA工作人员，其中医生22人、护士8人、技师8人；本次扩建2台DSA，医院拟再新招聘8名DSA医生、4名技师、4名护士，与医院现有DSA工作人员一起由医院统筹安排工作班次。每名医生年承担手术量不超过300台，护士和技师每年承担手术量不超过500台。每名医生的年工作负荷约为摄影0.88h、透视123.3h；每名技师的年工作负荷约为310.6h；每名护士的年工作负荷约为摄影1.46h、透视205.6h，护士在手术过程中护士承担记录手术情况、传递医疗器械及辅助医生手术的工作，既有同室操作又有隔室操作，同室时间按总时间的1/3考虑（即68.5h），隔室时间按总时间的2/3考虑（即137.1h）。

为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律、法规和部门规章，江苏省苏北人民医院扩建2台DSA项目需进行环境影响评价。受江苏省苏北人民医院的委托，南京瑞森辐射技术有限公司承担了扩建2台DSA项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年第66号），本项目DSA为血管造影用X射线装置，属II类射线装置。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号，2021年版），本项目扩建2台DSA，属于“172 核技术利用建设项目”中的“使用II类射线装置的”项目，确定为编制环境影响报告表。南京瑞森辐射技术有限公司在资料调研、项目工程分析、现场勘察及现场监测等工作的基础上，编制了该项目环境影响报告表。

江苏省苏北人民医院扩建 2 台 DSA 项目射线装置使用情况见表 1-1:

表 1-1 扩建 2 台 DSA 项目射线装置使用情况一览表

射线装置									
序号	射线装置名称型号	数量	最大管电压(kV)	最大管电流(mA)	射线装置类别	工作场所名称	活动种类	环评情况	备注
1	DSA (Allia IGS Pulse)	1	125	1000	II 类	本部院区九号楼一楼 DSA 手术室	使用	本次环评	单球管, 拟新购
2	DSA (Optima IGS Ultra)	1	125	1000	II 类	开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室	使用	本次环评	单球管, 拟新购

## 二、项目周边保护目标及项目选址情况

### 1、本部院区

江苏省苏北人民医院本部院区位于扬州市广陵区南通西路 98 号, 本部院区东侧为汶河南路及临街商铺, 南侧为南通西路, 西侧为淮海路, 北侧为甘泉路。本项目地理位置示意图附图 1-1, 本部院区平面布置及周围环境示意图附图 2-1。

本部院区扩建的 DSA 位于九号楼一楼, 九号楼位于院区东南部, 九号楼东侧、南侧均为院区道路, 西侧为院区道路和门诊楼, 北侧为院区道路及五号楼(脑科医疗中心)。DSA 拟建址现为外科诊室、骨科诊室等区域, 改造后, DSA 手术室东侧为控制室、换床间, 南侧为药房, 西侧为楼外道路, 北侧为污洗间及库房, 楼上为诊室, 楼下为库房。

本部院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围东侧至院外汶河南路及临街商铺(立聪堂助听器店、耳聪听力助听器店), 南侧、西侧、北侧均位于本部院区边界内。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、汶河南路和临街商铺的其他公众等。本项目周围无显著环境制约因素, 选址基本合理; DSA 均配套独立用房, 房间由射线装置机房和控制室组成, 控制室与机房分开布置, 区域划分明确, 项目布局合理。

### 2、开发区院区

江苏省苏北人民医院开发区院区东侧为马港河及马港河路, 南侧为施沙路, 西侧为规划道路, 北侧为扬子津路。本项目地理位置示意图附图 1-2, 开发区院区平面布置及周围环境示意图附图 2-2。

开发区院区扩建的 DSA 位于医技楼三楼, 医技楼位于院区东部, 医技楼东侧为院区道路和绿化区域, 南侧为院区道路及住院楼, 西侧、北侧均为院区道路和绿化区

域。DSA 拟建址东侧为控制室及设备间，南侧为污物通道，西侧为过道及楼梯间，北侧为清洁走廊，楼上为办公室、过道、维修间、备件间等区域，楼下为过道及配药室。

开发区院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围均位于开发区院区边界内。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属和其他公众等。本项目 DSA 配套独立用房，房间由射线装置机房和控制室组成，控制室与机房分开布置，区域划分明确，项目布局合理。

### 三、原有核技术利用项目许可情况

江苏省苏北人民医院辐射安全许可证证书编号为“苏环辐证[00547]”，许可种类和范围为“使用 III 类、V 类放射源；使用 II 类、III 类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所”，有效期至 2028 年 12 月 25 日。医院辐射安全许可证正副本见附件 4。

医院现有的核技术利用项目均已履行环保手续，无历史遗留环保问题。医院现有核技术应用项目基本情况见附件 8。

江苏省苏北人民医院已成立放射防护与辐射安全领导小组，负责全院的放射防护与辐射安全管理工作；医院现有辐射工作人员及辐射安全管理人员均已取得辐射安全与防护考核合格证书，辐射工作人员均进行个人剂量监测和职业健康体检；医院已建立辐射安全管理规章制度并严格执行，满足医院现有核技术利用项目的辐射安全管理；医院已委托有资质单位对医院核技术利用项目开展年度监测，并在日常工作中开展自主监测；医院已制定辐射事故应急措施预案并定期组织演练，医院开展核技术利用项目以来，未发生过辐射事故（事件）；医院现有核技术利用项目的“三废”排放情况均在其原有环评及批复范围内，无异常情况；医院已为现有核技术利用项目工作人员配备必要的个人防护用品及辅助防护设施；医院每年对已开展的核技术利用项目进行年度评估，编写年度评估报告并按时提交至全国核技术利用辐射安全申报系统。

### 四、实践正当性分析

本项目的运行，可为患者提供放射诊疗服务，并可提高当地医疗卫生水平，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全管理后，本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) ×枚数	类别	活度种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)

表 3 非密封放射性物质

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大操作量 (Bq)	日等效最大操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)。

表 4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量 (MeV)	额定电流 (mA) / 剂量率 (Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二) X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	DSA	II类	1台	Allia IGS Pulse	125	1000	医用诊断/引导介入手术	本部院区九号楼一楼 DSA 手术室	单球管
2	DSA	II类	1台	Optima IGS Ultra	125	1000	医用诊断/引导介入手术	开发区院区医技楼三 楼 DSA 手术室	单球管
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大靶电流 (μA)	中子强度 (n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物	固体	/	/	约 25kg	约 300kg	/	暂存在机房内的废物桶	手术结束后集中收集,作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。
臭氧、氮氧化物	气态	/	/	少量	少量	/	不暂存	通过排风系统排入外环境,臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气。
生活污水	液体	/	/	少量	少量	/	依托医院现有生活污水处理设施处理	处理达标后,排入市政污水管网
生活垃圾	固体	/	/	少量	少量	/	依托医院现有生活垃圾收集设施分类收集	由市政环卫部门定期清运

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m<sup>3</sup>；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m<sup>3</sup>）和活度（Bq）。

表 6 评价依据

<p>法规 文件</p>	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，中华人民共和国主席令 第九号，2015年1月1日起实施；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令 第七十七号，2002年10月28日发布，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第一次修正，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正；</p> <p>(3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令 第六号，2003年10月1日起实施；</p> <p>(4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令 第449号，2005年12月1日起施行；2019年修改，国务院令 第709号，2019年3月2日施行；</p> <p>(5) 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令 第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）修订，2017年10月1日起施行；</p> <p>(6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），生态环境部令 第20号，2021年1月4日起施行；</p> <p>(7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令 第16号，2021年1月1日起施行；</p> <p>(8) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令 第18号，2011年5月1日起施行；</p> <p>(9) 《关于发布〈射线装置分类〉的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年 第66号，2017年12月5日起施行；</p>
------------------	---

	<p>(10) 《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2023年修改), 国家发展和改革委员会2023年令 第7号, 2024年2月1日起施行;</p> <p>(11) 《江苏省辐射污染防治条例》(2018年修正本), 江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第2号公告, 2018年5月1日起实施;</p> <p>(12) 《关于发布〈建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法〉配套文件的公告》, 生态环境部公告 2019年 第38号, 2019年10月25日发布;</p> <p>(13) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》, 生态环境部公告 2019年 第39号, 2019年10月25日发布;</p> <p>(14) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》, 生态环境部公告 2019年 第57号, 2019年12月24日发布;</p> <p>(15) 《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》, 生态环境部令 第9号, 2019年11月1日起施行;</p> <p>(16) 《省政府关于印发江苏省国土空间规划(2021—2035年)的通知》, 苏政发〔2023〕69号, 2023年8月16日发布;</p> <p>(17) 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境影响报告书(表)编制单位监管工作的通知》, 苏环办〔2021〕187号, 2021年5月28日发布;</p> <p>(18) 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》, 苏政发〔2020〕1号, 2020年1月8日发布;</p> <p>(19) 《江苏省生态环境厅关于印发辐射安全许可证办理等工作程序和规范的通知》, 苏环规〔2025〕1号, 2025年9月21日起施行;</p> <p>(20) 《江苏省辐射事故应急预案》(2020年修订版), 苏政办函〔2020〕26号, 2020年2月19日发布;</p> <p>(21) 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》, 苏政发〔2020〕49号, 2020年6月21日发布。</p>
<p>技术 标准</p>	<p>(1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002);</p> <p>(2) 《医用电气设备 第1-3部分: 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准: 诊断X射线设备的辐射防护》(GB 9706.103-2020);</p> <p>(3) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016);</p> <p>(4) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的</p>

	<p>内容和格式》（HJ 10.1-2016）；</p> <p>（5）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）；</p> <p>（6）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）</p> <p>（7）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）；</p> <p>（8）《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）；</p> <p>（9）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）；</p> <p>（10）《外照射放射防护剂量转换系数标准》（WS/T 830-2024）。</p>
其他	<p>附件：</p> <p>（1）项目委托书；</p> <p>（2）射线装置使用承诺书；</p> <p>（3）DSA 机房屏蔽设计情况；</p> <p>（4）辐射安全许可证；</p> <p>（5）辐射工作人员培训证书；</p> <p>（6）辐射环境现状监测报告；</p> <p>（7）江苏省生态环境分区管控综合查询报告书；</p> <p>（8）医院现有核技术应用项目基本情况一览表。</p>

表 7 保护目标与评价标准

评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的规定，结合本项目的特点，确定本项目评价范围为本次扩建 2 台 DSA 项目工作场所实体屏蔽边界外周围 50m 范围内区域，评价范围详见附图 2-1、附图 2-2。

保护目标

本部院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围东侧至院外汶河南路及临街商铺（立聪堂助听器店、耳聪听力助听器店），南侧、西侧、北侧均位于本部院区边界内。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、汶河南路和临街商铺的其他公众等；开发区院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围均位于开发区院区边界内，项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属和其他公众等。

本项目环境保护目标详见表 7-1 和表 7-2。

表 7-1 本部院区扩建 DSA 环境保护目标一览表

序号	场所	保护目标	方位	最近距离	保护对象类别	人口规模	剂量约束值
1	本部院区九号楼一楼 DSA 手术室	操作技师	控制室	毗邻	辐射工作人员	2 人	5mSv/a (职业人员)
		医生、护士	机房内	同室操作		6 人	
2	急诊中心 (九号楼)	其他医务人员	机房四周及楼上、楼下	毗邻	公众	约 180 人	0.1mSv/a (公众)
		病患、周围公众				约 60 张床位,其余为流动人员	
3	门诊楼	其他医务人员	西侧	约 18m	公众	约 230 人	
		病患、周围公众				流动人员	
4	五号楼	其他医务人员	北侧	约 40m	公众	约 90 人	
		病患、周围公众				流动人员	

5	院内道路公众		四周	约 2m	公众	流动人员
6	立聪堂助听器店	固定工作人员	东侧	约 45m	公众	约 6 人
		其他公众				流动人员
7	耳聪听力助听器店	固定工作人员	东侧	约 35m	公众	约 6 人
		其他公众				流动人员

注：本项目 DSA 位于九号楼一楼，保护目标为地面人员时，本项目工作场所与保护目标最近距离保守取其水平距离；保护目标为相邻上下楼层人员时，最近距离保守取其垂直距离。

表 7-2 开发区院区扩建 DSA 环境保护目标一览表

序号	场所	保护目标	方位	最近距离	保护对象类别	人口规模	剂量约束值
1	开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室	操作技师	控制室	毗邻	辐射工作人员	2 人	5mSv/a (职业人员)
		医生、护士	机房内	同室操作		6 人	
2	医技楼	其他医务人员	机房四周及楼上、楼下	毗邻	公众	约 180 人	0.1mSv/a (公众)
		病患、周围公众				流动人员	
3	住院楼	其他医务人员	南侧	约 27m	公众	约 480 人	0.1mSv/a (公众)
		病患、周围公众				约 240 张床位,其余为流动人员	
4	院区道路公众		四周	约 8m	公众	流动人员	

注：本项目 DSA 位于医技楼三楼，保护目标为地面人员时，本项目工作场所与保护目标最近距离保守取其水平距离；保护目标为相邻上下楼层人员时，最近距离保守取其垂直距离。

## 评价标准

### 1.剂量限值：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的个人剂量限值，见表 7-2。

表 7-2 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

照射类型	剂量限值
职业照射	应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv ②任何一年中的有效剂量，50mSv。

公众照射

实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值：  
①年有效剂量，1mSv；  
②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。

## 2.剂量约束值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录B的要求并结合本项目特点，确定本项目剂量约束值为：

- a) 职业人员年有效剂量不超过5mSv，
- b) 公众年有效剂量不超过0.1mSv。

## 3.剂量率控制水平：

根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）“6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：a) 具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；c) 具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如DR、CR、屏片摄影）机房外的周围剂量当量率应不大于25μSv/h，当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于0.25mSv”的要求，确定本项目机房外的周围剂量当量率参考控制水平为：距DSA机房墙体、门、观察窗表面外30cm处、顶棚上方（楼上）距顶棚地面100cm处、地面下方（楼下）距楼下地面170cm处的辐射剂量率目标控制值均为2.5μSv/h。

## 4.辐射环境质量现状检测评价参考值

根据《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第13卷第2期，1993年3月，江苏省环境监测站）确定本项目建设址的辐射环境质量现状检测评价参考值，见表7-3。

表7-3 江苏省全省环境天然γ辐射水平调查结果（单位：nGy/h）

	原野剂量率	道路剂量率	室内剂量率
测值范围	33.1~72.6	18.1~102.3	50.7~129.4
均值	50.4	47.1	89.2
标准差（s）	7.0	12.3	14.0

注：测量值已扣除宇宙射线响应值，现状评价时取测值范围作为本底参考水平。

## 5.参考资料：

- （一）《辐射防护导论》，方杰主编；

(二) 《辐射防护手册（第一分册）》，李德平、潘自强主编。

表 8 环境质量和辐射现状

## 环境质量和辐射现状

### 一、项目位置、布局和周边环境

#### 1、本部院区

江苏省苏北人民医院本部院区位于扬州市广陵区南通西路 98 号，本部院区东侧为汶河南路及临街商铺，南侧为南通西路，西侧为淮海路，北侧为甘泉路。

本部院区扩建的 DSA 位于九号楼一楼，九号楼位于院区东南部，九号楼东侧、南侧均为院区道路，西侧为院区道路和门诊楼，北侧为院区道路及五号楼（脑科医疗中心）。DSA 拟建址现为外科诊室、骨科诊室等区域，改造后，DSA 手术室东侧为控制室、换床间，南侧为药房，西侧为楼外道路，北侧为污洗间及库房，楼上为诊室，楼下为库房。

本部院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围东侧至院外汶河南路及临街商铺（立聪堂助听器店、耳聪听力助听器店），南侧、西侧、北侧均位于本部院区边界内。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、汶河南路和临街商铺的其他公众等。

本部院区 DSA 拟建址及周围见图 8-1 至图 8-7。

拟建址

图 8-1 DSA 手术室拟建址现状（诊室）

图 8-2 DSA 手术室拟建址东侧过道

图 8-3 DSA 手术室拟建址南侧药房

图 8-4 DSA 手术室拟建址西侧院区道路

图 8-5 DSA 手术室拟建址北侧诊室

图 8-6 DSA 手术室拟建址楼上诊室

图 8-7 DSA 手术室拟建址楼下仓库

## 2、开发区院区

江苏省苏北人民医院开发区院区东侧为马港河及马港河路，南侧为施沙路，西侧为规划道路，北侧为扬子津路。

开发区院区扩建的 DSA 位于医技楼三楼，医技楼位于院区东部，医技楼东侧为院区道路和绿化区域，南侧为院区道路及住院楼，西侧、北侧均为院区道路和绿化区域。DSA 拟建址东侧为控制室及设备间，南侧为污物通道，西侧为过道及楼梯间，北侧为清洁走廊，楼上为办公室、过道、维修间、备件间等区域，楼下为过道及配药室。

开发区院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围均位于开发区院区边界内。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属和其他公众等。

开发区院区 DSA 拟建址及周围环境见图 8-8 至图 8-14。

图 8-8 DSA 手术室拟建址

图 8-9 DSA 手术室拟建址东侧控制室

图 8-10 DSA 手术室拟建址南侧污物通道

图 8-11 DSA 手术室拟建址西侧楼梯间

图 8-12 DSA 手术室拟建址北侧洁净走廊

图 8-13 DSA 手术室拟建址楼下配药室

图 8-14 DSA 手术室拟建址楼上办公室、过道、  
维修间、备件间等区域

## 二、辐射环境现状调查

根据《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）相关方法和要求，在进行环境现场调查时，于本次扩建 2 台 DSA 项目建设址周围进行布点，测量 $\gamma$ 辐射剂量率。监测结果见表 8-2、表 8-3，监测点位示意图见图 8-15、图 8-16。

监测单位：南京瑞森辐射技术有限公司

监测项目： $\gamma$ 辐射剂量率

检测仪器：BG9511 型环境监测用 X、 $\gamma$ 辐射吸收剂量率仪（设备编号：NJRS-221，  
检定有效期：2025 年 10 月 22 日~2026 年 10 月 21 日，检定单位：江苏省计量科学  
研究院，检定证书编号：Y2025-0103723）

能量范围：35keV~3MeV

剂量率范围：10nGy/h~600 $\mu$ Gy/h

监测日期及环境条件见表 8-1。

表 8-1 监测日期及环境条件

日期	环境条件
2025 年 11 月 27 日	天气：阴 温度：10℃ 湿度：25%RH
2026 年 2 月 3 日	天气：多云 温度：9℃ 湿度：44%RH

监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）有关布点原则进行布点。

质量控制：本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过检验检测机构资质认定（证书编号：221020340350，检测资质见附件 5），具备相应的检测资质和检测能力，监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）要求，实施全过程质量控制。

监测人员、监测仪器及监测结果：监测人员均经过考核，监测仪器经过计量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过检验，监测报告实行三级审核。

数据记录及处理： $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率监测每个点位读取 10 个数据，读取间隔不小于 10s，并待计数稳定后读取数值。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。

评价方法：参照江苏省环境天然 $\gamma$ 辐射剂量水平调查结果，评价项目周围的辐射环境质量。

表 8-2 本部院区扩建 DSA 项目拟建址及其周围环境 $\gamma$ 辐射水平检测结果

测点编号	测点描述	测量结果 (nGy/h)	标准差	备注
1	DSA 手术室拟建址（石膏房）	68	1	楼房室内
2	DSA 手术室拟建址（外科诊室）	69	1	楼房室内
3	DSA 手术室拟建址（骨科诊室）	69	1	楼房室内
4	DSA 手术室拟建址（轻疮诊室）	69	1	楼房室内
5	DSA 手术室拟建址东侧过道	71	1	楼房室内
6	DSA 手术室拟建址南侧药房	65	2	楼房室内
7	DSA 手术室拟建址西侧院区道路	51	1	室外道路

8	DSA 手术室拟建址北侧诊室	65	1	楼房室内
9	DSA 手术室拟建址楼上诊室	70	2	楼房室内
10	DSA 手术室拟建址楼下库房	58	2	楼房室内
11	5号楼南侧道路	51	1	室外道路
12	门诊楼东侧道路	51	1	室外道路
13	立聪堂助听器店门口	58	1	室外道路
14	耳聪听力助听器店门口	58	1	室外道路

注：1.上表数据已扣除检测仪器宇宙射线响应值。环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量结果按照《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中公式 $\dot{D} = C_f(E_f\bar{X} - \mu_c\bar{X}_c')$ 计算，其中， $C_f$ 为仪器量程检定/校准因子，本项目为 1.11； $E_f$ 为仪器检验源效率因子，本项目取 1； $\bar{X}$ 为现场监测时仪器  $n$  次读数的平均值； $\mu_c$ 为建筑物对宇宙射线带电粒子和光子的屏蔽因子，楼房取值为 0.8，平房取值为 0.9，原野、道路取值为 1； $\bar{X}_c'$ 为测点处仪器对宇宙射线的响应值，本仪器的宇宙射线响应值为 7nGy/h。

2.现场检测期间，周围无其他射线装置开机运行；

3.检测仪器相对固有误差为-11.6%。

由表 8-2 监测结果可知，江苏省苏北人民医院本部院区扩建 1 台 DSA 项目拟建址及其周围楼房室内环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 58nGy/h~71nGy/h 之间，属江苏省建筑物室内 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 50.7nGy/h~129.4nGy/h 范围内；周围道路环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 51nGy/h~58nGy/h 之间，属江苏省道路 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 18.1nGy/h~102.3nGy/h 范围内。

表 8-3 开发区院区扩建 DSA 项目拟建址及其周围环境 $\gamma$ 辐射水平检测结果

测点编号	测点描述	测量结果 (nGy/h)	标准差	备注
1	DSA 手术室拟建址东部	69	1	楼房室内
2	DSA 手术室拟建址中间	70	1	楼房室内
3	DSA 手术室拟建址西部	70	1	楼房室内
4	DSA 手术室拟建址东侧控制室	68	1	楼房室内
5	DSA 手术室拟建址东侧设备间	68	1	楼房室内
6	DSA 手术室拟建址南侧过道	67	1	楼房室内
7	DSA 手术室拟建址西侧楼梯道	57	1	楼房室内
8	DSA 手术室拟建址北侧过道	68	1	楼房室内

9	DSA 手术室拟建址楼上	70	2	楼房室内
10	DSA 手术室拟建址楼下	74	1	楼房室内
11	医技楼东侧道路	49	1	室外道路
12	医技楼南侧道路	49	2	室外道路
13	医技楼西侧道路	51	1	室外道路
14	医技楼北侧道路	51	1	室外道路
15	住院楼北侧道路	51	1	室外道路

注：1.上表数据已扣除检测仪器宇宙射线响应值。环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量结果按照《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中公式 $\dot{D} = C_f(E_f\bar{X} - \mu_c\bar{X}_c')$ 计算，其中， $C_f$ 为仪器量程检定/校准因子，本项目为 1.11； $E_f$ 为仪器检验源效率因子，本项目取 1； $\bar{X}$ 为现场监测时仪器  $n$  次读数的平均值； $\mu_c$ 为建筑物对宇宙射线带电粒子和光子的屏蔽因子，楼房取值为 0.8，平房取值为 0.9，原野、道路取值为 1； $\bar{X}_c'$ 为测点处仪器对宇宙射线的响应值，本仪器的宇宙射线响应值为 7nGy/h。

2.现场检测期间，周围无其他射线装置开机运行；

3.检测仪器相对固有误差为-11.6%。

由表 8-1 监测结果可知，江苏省苏北人民医院开发区院区扩建 1 台 DSA 项目拟建址及其周围楼房室内环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 57nGy/h~74nGy/h 之间，属江苏省建筑物室内 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 50.7nGy/h~129.4nGy/h 范围内；周围道路环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 49nGy/h~51nGy/h 之间，属江苏省道路 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 18.1nGy/h~102.3nGy/h 范围内。



图 8-15 本部院区检测点位示意图




图 8-16 开发区院区检测点位示意图

表 9 项目工程分析与源项

工程设备与工艺分析

一、工程设备

DSA 因其整体结构像大写的“C”，因此也称作 C 形臂 X 光机，DSA 由 X 线发生装置（包括 X 射线球管及其附件、高压发生器、X 射线控制器等）和图像检测系统（包括光栅、影像增强管、光学系统、线束支架、检查床、输出系统等）组成。常见 DSA 外观图见图 9-1。



图 9-1 常见 DSA 外观示意图

本项目拟配备的 DSA 主要设备技术参数见表 9-1，配套设备配置情况见表 9-2。

表 9-1 本项目 DSA 主要设备技术参数

项目	技术参数	
型号	Allia IGS Pulse	Optima IGS Ultra

数量	1 台	1 台
位置	本部院区九号楼一楼 DSA 手术室	开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室
最大管电压	125kV	125kV
最大管电流	1000mA	1000mA
X 射线球管滤过条件	固有滤过 2.5mmAl+附加滤过	固有滤过 2.5mmAl+附加滤过
球管类型及射线方向	单球管，即使旋转机头，有用线束仍朝向顶部照射	单球管，即使旋转机头，有用线束仍朝向顶部照射
焦皮距	≥45cm	≥45cm
照射野	最小照射野：11cm×11cm 最大照射野：30cm×38cm	最小照射野：11cm×11cm 最大照射野：30cm×38cm

注：本项目 DSA 技术参数由建设单位和供货商提供。

表 9-2 每台 DSA 配套设备一览表

序号	名称	数量	用途	位置
1	电源柜	1 套	DSA 配电	设备间
2	高压发生柜	1 套	DSA 高压装置	设备间
3	系统控制柜	1 套	设备控制和数据传输	设备间
4	控制系统	1 套	DSA 设备操作	控制室

## 二、工作原理及工作流程

### （一）工作原理

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA 是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，获得一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其是与骨骼重叠的血管能清楚地显示；由于造影剂用量少、浓度低、损伤小、较安全，节省胶片使造影价格低于常规造影。通过医用血管造影 X 射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA 系统结构图见图

9-2。

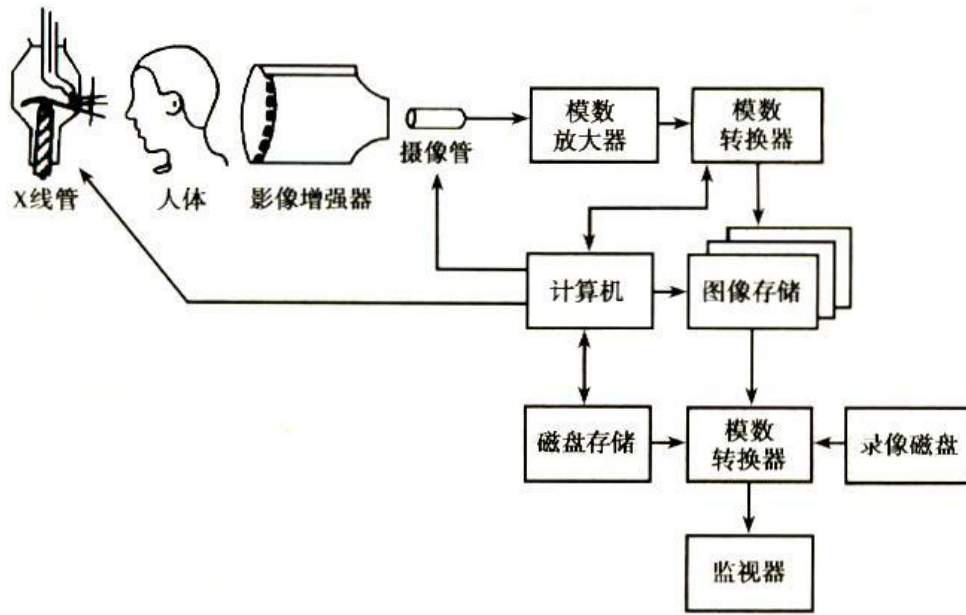


图 9-2 DSA 系统结构图

DSA 是引导介入手术治疗的重要医学影像设备,通过置入体内的各种导管(约 1.5~2 毫米粗)的体外操作和独特的处理方法,对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点,目前,基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械,介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构(消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等),以及某些特定部位,对许多疾病实施局限性治疗。

## (二) 工作流程及产污环节分析

本项目 DSA 在进行曝光时分为两种情况:

### 1. 医疗诊断

DSA 检查(诊断)采用是根据采集的造影部位图像,对患者病变部位进行诊断,以选择合适的治疗方案。具体方式是受检者位于检查床上,医护人员指导患者摆位并调整 X 射线球管、人体、影像接收器三者之间的距离,然后进行出束摄影,获取底片;下一步为患者注射造影剂、出束摄影或透视,获取样片。计算机将样片信号减去底片信号后,得到仅显示造影剂分布的图像,即血管图像。医护人员根据该图像识别、判断患者病变的具体部位、病变程度及类型,以选择合适的治疗方案。

### 2. 引导介入手术

介入手术是医生、护士在 DSA 出束曝光条件下,根据影像引导,为患者实施如血管扩张、清淤、送入支架等治疗操作。具体方式是受检者位于检查床上,医护人员指导

患者摆位并调整 X 射线球管、人体、影像接收器三者之间的距离，然后进行出束曝光，获取底片；下一步为患者注射造影剂，再次出束曝光，获取样片。计算机将样片信号减去底片信号后，得到仅显示造影剂分布的图像，即血管图像。介入治疗手术过程中，DSA 间歇多次出束透视，获取手术过程中的动态图像，医护人员根据图像引导完成治疗操作。

#### DSA 的产污环节分析：

本项目采用先进的数字显影技术，电脑成像，不使用显（定）影液，不产生废显影液、废定影液和废胶片，注入的造影剂不含放射性。设备运行过程中产生的污染物主要为 X 射线、少量臭氧和氮氧化物以及手术过程中产生的医疗废物。DSA 项目工作流程及产污环节如图 9-3。

图 9-3 DSA 项目工作流程及产污环节示意图

### 三、原有工艺不足及改进情况

医院现有 5 台 DSA 正常运行，均用于开展医疗诊断和引导介入手术，本项目 DSA 设备工艺流程和原有工艺一致，不存在不足或改进情况。本项目的建设可分担医院现有 DSA 的工作负荷，满足医院日益增长的介入诊疗需求。

### 四、工作负荷及人员配置

根据医院提供的资料，2024 年、2025 年全院 DSA 手术量分别为 5215 台、8734 台，手术量增长很快，预计到 2026 年可能突破 1 万台。本次扩建 2 台 DSA 后，医院将有 7

台 DSA 共同分担介入手术工作，平均每台 DSA 约承担 1429 台手术量。

出于保守估算考虑，本报告按照每 DSA 承担 1500 台手术量的工作负荷来估算手术曝光时间，详见表 9-3。

表 9-3 预估本项目每台 DSA 工作负荷

(1) 透视					
手术类别	年开展工作量		每台手术透视曝光时间		年透视曝光时间
血管外科介入	400 台		约 30min		约 200.0h
心脏介入	800 台		约 20min		约 266.7h
脑血管介入	300 台		约 30min		约 150.0h
小计	1500 台		/		约 616.7h
(2) 摄影					
手术类别	年开展工作量	单次采集时间	单台手术采集次数	单台手术最大采集时间	年采集时间
血管外科介入	400 台	0.5~1s	5~10 次	约 0.17min	约 1.13h
心脏介入	800 台	0.5~1s	7~11 次	约 0.18min	约 2.40h
脑血管介入	300 台	0.5~1s	3~10 次	约 0.17min	约 0.85h
小计	1500 台	/	/	/	约 4.38h
总 计					约 621.1h

江苏省苏北人民医院现有 38 名 DSA 工作人员，其中医生 22 人、护士 8 人、技师 8 人；本次扩建 2 台 DSA，医院拟再新招聘 8 名 DSA 医生、4 名技师、4 名护士，与医院现有 DSA 工作人员一起由医院统筹安排工作班次。项目开展后，护士在透视模式下主要承担在控制室隔室观察患者、记录手术情况的工作，少部分时间承担同室在铅屏风后传递医疗器械及辅助医生手术的工作，摄影模式下，护士在控制室隔室观察患者、记录手术情况；技师在透视模式和摄影模式下均位于控制室隔室操作；医生在透视模式下同室对患者进行手术操作，摄影模式下在控制室隔室观察患者情况，操作方式既有同室操作又有隔室操作。

由于医生的专业类型不同，不同手术类别的手术量也不同，因此每名医生的工作负荷不会平均分布。根据医院工作安排，每名医生每年最多承担 300 台手术量，则每

名医生的年工作负荷约为摄影 0.88h、透视 123.3h（即单台 DSA 五分之一的手术量）；每名技师最多承担 500 台手术量，则每名技师的年工作负荷约为 310.6h（即单台 DSA 三分之一的手术量）；每名护士最多承担 500 台手术量，则每名技师的年工作负荷约为摄影 1.46h、透视 205.6h（即单台 DSA 三分之一的手术量），护士在手术过程中护士承担记录手术情况、传递医疗器械及辅助医生手术的工作，既有同室操作又有隔室操作，同室时间按总时间的 1/3 考虑（即 68.5h），隔室时间按总时间的 2/3 考虑（即 137.1h）。

## 污染源项描述

### 一、放射性污染

DSA 在工作状态下会发出 X 射线，本项目拟新增的 DSA 最大管电压为 125kV、最大管电流为 1000mA，其主要用作血管造影检查及配合介入治疗，由于存在影像增强器，从而降低了造影所需的 X 射线能量，再加上一次血管造影检查需要时间很短，因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员有一定的附加辐射剂量。

DSA 产生的 X 射线是随机器的开、关而产生和消失，其穿透能力与 X 射线管的管电压和出口滤过有关。在开机出束期间，X 射线是主要污染因子。辐射场中的 X 射线包括有用线束（主束）、漏射线和散射线。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。

#### （一）有用线束

本项目 DSA 为单球管设备，即使旋转机头，其有用线束投射方向仍为由下至上，有用线束的射线能量、强度与 X 射线管靶物质、管电压、管电流有关。DSA 具有自动照射量控制调节功能（AEC），摄影时，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，照射量减小；如果受检者体型较胖，功率自动增强，照射量率增大。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和管电流通常与设备最大管电压和管电流之间留有一定的裕量。根据医院提供资料，DSA 正常运行时，透视模式的工况为（60~80）kV/（5~20）mA，摄影模式的工况为（60~80）kV/（100~500）mA。

DSA 运行时离靶 1 米处的 X 射线发射率根据运行时管电压和 DSA 的 X 射线管的过滤条件从《辐射防护导论》（方杰著）附图 3 中查取。本项目 DSA 过滤材料按照 2.5mmAl 滤片进行剂量预测，查《辐射防护导论》附图 3，本项目正常运行时最大电压为 80kV，离靶 1 米处的发射率约为 5mGy·m<sup>2</sup>/mA·min。

## （二）散射线

本项目 DSA 的散射线主要考虑有用线束照射到受检者人体产生的侧向散射线，其强度与有用线束的 X 射线能量、X 射线机的输出量、散射面积和距离等有关。

## （三）泄漏射线

根据国际放射防护委员会第 33 号出版物《医用外照射源的辐射防护》“（77）用于诊断目的的每一个 X 射线管必须封闭在管套内，以使得位于该套管内的 X 射线管在制造厂规定的每个额定值时，离焦点 1m 处所测得的泄漏辐射在空气中的比释动能不超过 1mGy/h”（在距离源 1m 处不超过 100cm<sup>2</sup> 的面积上或者在离管或源壳 5cm 处的 10cm<sup>2</sup> 面积上进行平均测量），以及《医用电气设备 第 1-3 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断 X 射线设备的辐射防护》（GB 9706.103-2020）中 12.4 的相应要求，取本项目 DSA 离焦点 1m 处的泄漏辐射空气比释动能率为 1.0mGy/h。

## 二、非放射性污染

### （一）废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。本项目 DSA 手术室均设计有动力通风装置，少量臭氧和氮氧化物可通过动力通风装置排至室外。臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，氮氧化物产量约为臭氧的三分之一，这部分废气对周围环境影响较小。

### （二）废水

主要是工作人员产生的生活污水。生活污水将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网。

### （三）固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后由市政环卫部门定期清运。

表 10 辐射安全与防护

项目安全措施

一、工作场所布局及分区

本部院区扩建的 DSA 位于九号楼一楼，DSA 拟建址现为外科诊室、骨科诊室等区域，改造后 DSA 手术室东侧为控制室、换床间，南侧为药房，西侧为楼外道路，北侧为污洗间及库房，楼上为诊室，楼下为配电房；开发区院区扩建的 DSA 位于医技楼三楼，DSA 拟建址东侧为控制室及设备间，南侧为污物通道，西侧为过道及楼梯间，北侧为清洁走廊，楼上为办公室、过道、维修间、备件间等区域，楼下为过道及配药室。本项目 2 台 DSA 均配套独立用房，控制室和设备间独立于 DSA 机房外，区域划分明确，平面和空间布局合理，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中关于选址与布局的规定。

本部院区拟将 DSA 所在机房作为辐射防护控制区，拟将与机房相邻的换床间、控制室、库房、刷手间、污洗间等划为监督区；开发区院区拟将 DSA 所在机房作为辐射防护控制区，拟将与机房相邻的控制室、设备间等划为监督区。医院拟在机房入口处粘贴电离辐射警告标志，在监督区入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。

本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。

关于控制区与监督区的管理措施，医院应做到：

1、控制区的管理措施：

（1）DSA 工作场所进、出口防护门外及其他适当位置处设立醒目的“当心电离辐射”警告标志。“当心电离辐射”警告标志须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 F 要求，如图 10-1 所示。



图 10-1 电离辐射警告标志

(2) 制定辐射防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序；

(3) 运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区；

(4) 在缓冲区备有个人防护用品、工作服；

(5) 定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。

## 2、监督区的管理措施

在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。

本项目平面布置、辐射防护分区与人流、物流路线示意图见图 10-2、图 10-3。



图 10-2 本部院区 DSA 手术室平面布置、辐射防护分区及患者、医护人员及污物路线示意图




图 10-3 开发区院区 DSA 手术室平面布置、辐射防护分区及患者、医护人员及污物路线示意图

## 二、辐射防护屏蔽设计

本部院区 DSA 手术室内最小矩形尺寸为 11.35m（长）×6.75m（宽），有效使用面积为 76.6m<sup>2</sup>；开发区院区 DSA 手术室内最小矩形尺寸为 7.2m（长）×7.1m（宽），有效使用面积为 51.1m<sup>2</sup>。本项目 DSA 机房具体屏蔽设计参数见表 10-1。

表 10-1 DSA 机房屏蔽设计一览表

场所名称	屏蔽位置	屏蔽材料及厚度	等效铅当量厚度
本部院区 DSA 手术室	东墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	南墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	西墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	北墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	顶面	12cm 混凝土+3mm 铅板	4.44mmPb

	地面	12cm 混凝土+2mm 铅当量硫酸钡水泥	3.44mmPb
	防护门	钢板内衬 4mm 铅板	4mmPb
	观察窗	4mm 铅当量铅玻璃	4mmPb
开发区院区 DSA 手术室	东墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	南墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	西墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	北墙	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb
	顶面	12cm 混凝土+3mm 铅板	4.44mmPb
	地面	12cm 混凝土+2mm 铅当量硫酸钡水泥	3.44mmPb
	防护门	钢板内衬 4mm 铅板	4mmPb
	观察窗	4mm 铅当量铅玻璃	4mmPb

注：1.混凝土密度为  $2.35\text{g/cm}^3$ ，铅密度为  $11.3\text{g/cm}^3$ ，硫酸钡水泥密度为  $2.7\text{g/cm}^3$ ；

2.等效铅当量计算过程详见表 11-3。

本部院区 DSA 手术室拟建址现状为诊室，改造时需先将原有装潢及墙体（西墙除外，西墙为建筑外立面墙体）拆除，然后按照本项目屏蔽设计方案使用轻钢龙骨焊接成网状骨架，上下两端通过角码和膨胀螺栓固定在顶部和地面，再将铅板固定在骨架上，铅板之间设置 1~2cm 的搭接，搭接处使用自攻螺丝或压条固定。铅板固定完成后，表面采用装饰盖板进行覆盖。机房顶面的铅板则铺设于机房上方的地面。地面的硫酸钡水泥施工时采用分层涂抹压实的工艺，最后再做找平层和装饰面层。开发区院区 DSA 手术室拟建址为前期预留位置，不涉及原有装潢、墙体的拆除，可直接按照本项目屏蔽设计方案进行施工，施工工艺与本部院区 DSA 手术室防护施工相同。

本项目 DSA 机房电缆线布设均采用电缆沟，通排风管道穿墙方式均为直穿式，为防止 X 射线泄漏，电缆孔处均拟设置 3mm 铅板进行防护（接口处四周包封），通风及排风管道口均拟设置 3mm 铅板进行防护（接口处进行包裹）。DSA 机房防护大门和防护小门均为电动推拉门，防护小门为手动平开门，门与墙体之间设置足够的搭接，在门的顶部和两端至少重叠 10 倍门与墙体（门框）之间的缝隙。

### 三、辐射安全和防护措施

#### （一）电离辐射警告标志

DSA 机房入口处设置有“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明。

## （二）门灯联动

本项目 DSA 机房防护大门均为电动推拉式机房门，其余防护门均为手动平开门，防护门均拟设自动闭门装置，防护大门均拟设防夹功能。防护大门上方均拟设置工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，且工作状态指示灯与防护大门能有效联动（防护门关闭时，红色警示语亮起；防护门打开时，警示语熄灭）。

## （三）急停按钮

控制室设置 1 个急停按钮，机房内的治疗床边操作面板自带 1 个急停按钮，均与 X 射线系统连接，在紧急情况下，按下任一急停按钮，即可停止 X 射线系统出束。

## （四）观察窗或摄像监控装置和对讲装置

DSA 机房与控制室之间的墙上均设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况。DSA 控制室与机房内均设置双向语音对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流。

## （五）防护用品

医院为本项目工作人员配备的辐射防护装置及个人防护用品主要有铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、剂量报警仪、个人剂量计等，医院已购置的各类防护用品除介入防护手套防护能力为 0.025mm 铅当量外，其余防护用品防护能力均为 0.5mm 铅当量。本项目 DSA 设备自带铅防护帘、床侧防护帘等辅助防护设施，其防护能力均为 0.5mm 铅当量。

## （六）人员监护

医院拟为扩建 2 台 DSA 项目配置 16 名辐射工作人员，均拟新招聘、新培训，每台 DSA 均拟配备 2 名技师、2 名护士及 4 名医生，年开展工作 250 天。医院拟为辐射工作人员配备个人剂量计，采用双剂量计监测方法，定期送检且需做好个人剂量档案管理工作；拟开展辐射工作人员的职业健康监护，定期安排其在有相应资质医院体检，建立职业健康监护档案。

## （七）规章制度

完善并落实射线装置相关的安全使用制度、管理制度，从事辐射工作的医务人员均须参加放射工作的培训与辐射安全培训考核。医务人员在操作过程中遵守以上制

度，严格按照操作程序，避免发生事故。

#### **(八) 其他辐射安全措施**

介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入治疗的效应和操作时，其辐射损伤必须加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X射线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，根据辐射防护“三原则”，医院还应在以下方面加强对介入治疗的防护工作：

1.操作中减少透视时间和减少照相的次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

2.一般说来，降低患者剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应该技术熟练、动作迅速，以减少患者和介入人员的剂量。

3.所有在介入治疗手术室内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，控制和减少工作人员的受照剂量。

4.引入的 DSA 及配套设备必须符合国际的或者国家的标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；设备应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，并尽可能提高图像质量。

5.介入人员应该结合 DSA 设备的特点，了解一些降低剂量的方法，比如脉冲透视、优化滤线器、除滤线栅、图像处理、低剂量透视等方法。

6.加强 DSA 设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其他相关设备应该定期进行检测。

7.临床介入手术时，介入医生需站在 DSA 床边操作，仅依赖于医务人员身着铅橡胶围裙、机器自带的铅防护帘等防护设备被动防护。一般来说，床下和床侧球管对医务人员的辐射剂量，由头、颈、胸至腹部呈现剂量逐渐上升的趋势，故操作人员除个人防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜及介入防护手套等）外，应着重考虑 X 射线机操作侧的屏蔽，该屏蔽要做到既不影响操作者的操作，又能达到防护目的，且能消毒。本项目 DSA 设备自带床侧防护帘、铅防护帘及铅悬挂防护屏，以上组合屏蔽防护措施的设置，能够有效降低介入手术医务人员的吸收剂量。

#### **四、监测仪器和防护用品**

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，开展放射诊疗的单位

应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

表 10-2 个人防护用品和辅助防护设施配置符合性

项目	分项		《放射诊断放射防护要求》 (GBZ130-2020) 要求	本项目每台 DSA 拟采取措施
扩建 2 台 DSA 项目	工作人员	个人防护用品	铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、 铅防护眼镜、介入防护手套 选配：铅橡胶帽子	拟配备 6 件铅橡胶围裙、6 件铅橡胶颈套、6 副铅橡 胶帽子、3 副铅防护眼镜、 3 副介入防护手套
		辅助防护设施	铅悬挂防护屏/铅防护帘、 床侧防护帘/床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风	拟配备铅防护帘、床侧 防护帘
	受检者	个人防护用品	铅橡胶性腺防护围裙(方形) 或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子	拟配备 2 件铅橡胶围裙、2 件铅橡胶颈套
		辅助防护设施	/	/

江苏省苏北人民医院本部院区、开发区院区各已配备辐射巡测仪 1 台，医院拟为本项目 2 台 DSA 各配备个人剂量报警仪 1 台。医院拟为辐射工作人员配备的铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜防护当量为 0.5mm 铅当量，介入防护手套防护当量为 0.025mm 铅当量。辐射工作人员工作时将佩戴个人剂量计，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员拟采用双剂量计监测方法，以监测累积受照情况。医院拟定期组织辐射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立辐射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

## 三废的治理

### 一、废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。本项目 DSA 手术室均设计有动力通风装置，少量臭氧和氮氧化物可通过动力通风装置排至室外。臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，氮氧化物产量约为臭氧的三分之一，这部分废气对周围环境影响较小。

### 二、废水

主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网，对周围环境影响较小。

### 三、固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

表 11 环境影响分析

## 建设阶段对环境的影响

江苏省苏北人民医院本部院区扩建的 DSA 位于九号楼一楼，将现状外科诊室、骨科诊室等区域改造为 DSA 手术室；开发区院区扩建的 DSA 位于医技楼三楼，DSA 拟建址为前期预留区域。本项目建设时主要工作为原有装潢和墙体的拆除、新增隔断和门窗、机房内饰装潢与 DSA 设备安装，将产生施工噪声、扬尘和建筑垃圾污染，建设施工时对环境会产生如下影响：

一、大气：本项目在建设施工期需进行的内饰装潢等作业，各种施工将产生扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施：及时清扫施工场地，设立围挡，并保持施工场地一定的湿度。

二、噪声：整个建筑施工阶段，如内饰装潢、设备安装等施工中都将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的标准，尽量采用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。

三、固体废物：项目施工期间，会产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。

四、废水：项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，对这些废水进行初级沉淀处理，用于施工场地洒水降尘；施工人员会产生少量生活污水，可依托医院现有生活废水处理设施处理达标后排入市政污水管网，对环境影响较小。

医院在施工阶段计划采取上述污染防治措施，将施工期的影响控制在医院内部，对周围环境影响较小。

本项目 DSA 设备运输、安装和调试均由设备厂家专业人员进行操作，设备运输、安装、调试过程中，应加强辐射防护管理，在机房门外设立当心电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近；在设备的安装和调试过程中，射线源开关钥匙应安排专人保管和使用，并在机房入口等关键处设置醒目的警示牌。施工结束后，启动门灯联动并确认系统正常后才能启用射线装置。本项目 DSA 机房屏蔽设计满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求，射线装置的安装和调试均在机房内进行，经机房墙体、门屏蔽防护后，机房周围剂量率控制水平满足相关标准要求，对环境影响较小。

## 运行阶段对环境的影响

### 一、辐射环境影响分析

#### (一) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性分析评价

##### 1. 评价标准

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)表 3 规定,主束方向、非有用线束方向屏蔽体的铅当量均应不小于 2.0mmPb。

##### 2. 本项目 DSA 机房各屏蔽部位的铅当量厚度核算

本项目 DSA 均为单球管设备,其有用线束投射方向为由下至上,即使旋转机头,向上的散射线和漏射线的辐射影响要小于主束向上的影响,所以本项目将 DSA 机房顶部作为有用线束投射方向。由表 10-1 可知,本项目 DSA 机房使用的屏蔽材料除铅以外,还涉及顶面(有用线束投射方向)、地面(非有用线束投射方向)的混凝土、硫酸钡水泥等。本项目按额定管电压 125kV 的极端条件核算 DSA 机房各屏蔽部位屏蔽材料的等效铅当量厚度。

##### (1) 混凝土、实心砖的等效铅当量厚度核算

按照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 b) 给出的计算公式进行计算:

$$X = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln \left( \frac{B^{-\gamma} + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right) \quad \text{公式 11-1}$$

式中:  $X$ —不同屏蔽物质的铅当量厚度;

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —相应屏蔽物质(本项目为混凝土、实心砖)对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数;

$B$ —给定铅厚度的屏蔽透射因子;给定铅厚度的屏蔽透射因子  $B$  值对照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 a) 相应要求采用给出的计算公式进行计算:

$$B = \left[ \left( 1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{\frac{1}{\gamma}} \quad \text{公式 11-2}$$

式中:  $B$ —给定铅厚度的屏蔽透射因子;

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —铅对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数;

$X$ —铅厚度。

由 GBZ 130-2020 中表 C.2 查取 125kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关的拟合参数，由 NCRP147 报告 TABLE A.1、TABLE C.1 查取 80kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关的拟合参数和 70kV 管电压工况下 X 射线（散射）辐射衰减的有关的拟合参数，列于表 11-1：

表 11-1 不同管电压工况下 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数

管电压	屏蔽材料	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	备注
125kV（主束）	铅	████	████	████	额定最大管电压
	混凝土	██████	██████	████	
	实心砖	██████	██████	████	
80kV（主束）	铅	████	████	████	常用最大管电压
70kV（散射）	铅	████	████	████	

本项目机房屏蔽部位涉及的 120mm 混凝土，按公式 11-2、公式 11-1 计算其屏蔽透射因子  $B$ 、铅当量厚度  $X$ ，计算结果列于表 11-2。

表 11-2 混凝土屏蔽透射因子  $B$ 、铅当量厚度  $X$  计算结果

管电压	屏蔽材料	屏蔽透射因子 $B$	铅当量厚度 $X$ (mm)
125kV（主束）	120mm 混凝土	3.21E-03	1.44

## (2) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性

根据前述各屏蔽材料的等效铅当量厚度核算情况，可对本项目 DSA 机房屏蔽体等效铅当量进行汇总，结果见下表：

表 11-3 DSA 机房屏蔽体等效铅当量厚度核算及其与标准要求对比

工作场所	参数	屏蔽材料及厚度	125kV 等效铅当量	屏蔽要求 <sup>1)</sup>	评价
本部院区九号楼一楼 DSA 手术室	墙体 <sup>2)</sup>	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb	介入 X 射线设备机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向铅当量 2.0mm，非有用线束方向铅当量 2.0mm。	满足
	防护门 <sup>2)</sup>	钢板内衬 4mm 铅板	4mmPb		满足
	观察窗 <sup>2)</sup>	4mm 铅当量铅玻璃	4mmPb		满足
	顶面 <sup>3)</sup>	120mm 混凝土+3mm 铅板	4.44mmPb		满足
	地面 <sup>2)</sup>	120mm 混凝土+2mm 铅当量硫酸钡水泥	3.44mmPb		满足

	面积	有效使用面积为： 11.35m×6.75m=76.6m <sup>2</sup>		单管头 X 射线设备机房内最小有效新建面积不小于 20m <sup>2</sup> ，单边长度不小于 3.5m。	满足
开发区 院区医 技楼三 楼 DSA 手术室	墙体 <sup>2)</sup>	轻钢龙骨+3mm 铅板	3mmPb	介入 X 射线设备机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向铅当量 2.0mm，非有用线束方向铅当量 2.0mm。	满足
	防护门 <sup>2)</sup>	钢板内衬 4mm 铅板	4mmPb		满足
	观察窗 <sup>2)</sup>	4mm 铅当量铅玻璃	4mmPb		满足
	顶面 <sup>3)</sup>	120mm 混凝土+3mm 铅板	4.44mmPb		满足
	地面 <sup>2)</sup>	120mm 混凝土+2mm 铅当量硫酸钡水泥	3.44mmPb		满足
	面积	有效使用面积为： 7.2m×7.1m=51.1m <sup>2</sup>		单管头 X 射线设备机房内最小有效新建面积不小于 20m <sup>2</sup> ，单边长度不小于 3.5m。	满足

注：1.屏蔽要求引自《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3；

2.为非有用线束方向；

3.为有用线束方向。

由上表可知，本项目 DSA 机房在额定最大管电压 125kV 下屏蔽防护措施均能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

## （二）DSA 机房的辐射影响预测

为了进一步评价屏蔽效果和辐射防护效果，采用理论预测的方法进行辐射影响分析。本项目 DSA 设备主射线方向向上，介入手术过程中，DSA 图像增强器对 X 射线主束有屏蔽作用，NCRP147 号报告“Structural Shielding Design for Medical Imaging X-ray Facilities”4.1.6 节（Primary Barriers, P41-45）及 5.1 节（Cardiac Angiography, P72）指出，DSA 屏蔽估算时不需要考虑主束照射。因此本项目 DSA 需要屏蔽的辐射仅考虑泄漏辐射和散射辐射。

本项目 DSA 的辐射影响情况见表 11-4。

表 11-4 本项目 DSA 的辐射影响情况

操作模式	正常运行时最大工况	辐射影响对象
摄影模式	80kV/500mA	机房外公众、控制室操作人员
透视模式	80kV/20mA	机房外公众、控制室操作人员； 机房内介入治疗操作人员

于本部院区九号楼一楼 DSA 手术室和开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室周围、

第一术者位、第二术者位处选取预测计算参考点位如下：

- 1#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室东门外 30cm，控制室；
  - 2#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室东墙外 30cm，控制室；
  - 3#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室观察窗外 30cm，操作位；
  - 4#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室东墙外 30cm，设备间；
  - 5#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室南门外 30cm，污物通道；
  - 6#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室南墙外 30cm，污物通道；
  - 7#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室西墙外 30cm，楼梯间；
  - 8#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室北墙外 30cm，清洁走廊；
  - 9#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室防护大门外 30cm，清洁走廊；
  - 10#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室楼下地面 170cm 处，配药室、过道等；
  - 11#—开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室楼上地面 100cm 处，办公室及过道等；
  - 12#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室东门外 30cm 处，控制室；
  - 13#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室观察窗外 30cm 处，操作位；
  - 14#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室东墙外 30cm 处，控制室；
  - 15#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室东墙外 30cm 处，换床间；
  - 16#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室东门外 30cm 处，换床间；
  - 17#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室南墙外 30cm 处，药房；
  - 18#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室西墙外 30cm 处，室外道路；
  - 19#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室北门外 30cm 处，污洗间；
  - 20#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室北墙外 30cm 处，污洗间；
  - 21#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室北门外 30cm 处，库房；
  - 22#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室北墙外 30cm 处，库房；
  - 23#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室楼下地面 170cm 处，库房；
  - 24#—本部院区九号楼一楼 DSA 手术室楼上地面 100cm 处，诊室；
- 第一术者位，距球管约 1.0m 处；
- 第二术者位，距球管约 1.5m 处。

预测点布设见图 11-1 至图 11-4 所示。



图 11-1 开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室外预测计算参考点位示意图（平面图）




图 11-2 开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室外预测计算参考点位示意图（立面图）




图 11-3 开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室外预测计算参考点位示意图（立面图）




图 11-4 开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室外预测计算参考点位示意图（立面图）

## 1.关注点处散射辐射剂量率计算

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平 潘自强著）给出的X射线机散射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.10）进行推导，得到散射线在关注点处的有效剂量率  $H_s$  的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1），继而在公式中增加“有效剂量与空气比释动能转换系数”修正因子，得到散射辐射有效剂量率计算公式：

$$H_s = \frac{H_0 \cdot I \cdot a \cdot (s/400) \cdot B_s \cdot K}{d_0^2 \cdot d_s^2} \quad \text{公式 11-3}$$

式中： $H_s$ —关注点处散射辐射有效剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$H_0$ —X 射线机发射率常数（当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1m 处由主束产生的比释动能率）， $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，本项目取  $5\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，即  $300000\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ；

$I$ —管电流，mA；本项目透视、摄影模式下正常使用的最大管电流分取 20mA、500mA；

$a$ —人体对 X 射线的散射照射量与入射照射量之比值，由《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中查取。本项目常用最大管电压为 80kV，对于散射线向机房四侧墙体投射的情况，从《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中采用内插法查取散射角  $90^\circ$  时 80kV 对应的  $a$  值为 0.0008（该取值适用于机房四侧关注点相应预测计算）；对于散射线向机房地面投射的情况，因《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中无散射角  $180^\circ$  的数据，表中所列散射角中以  $135^\circ$  最接近  $180^\circ$ ，故从该表中散射角为  $135^\circ$ 、管电压为 70kV、100kV 对应的  $a$  值采用内插法求取 80kV 对应的  $a$  值为 0.0016（该取值适用于机房地面关注点相应预测计算）；对于散射线向机房顶面投射的情况，因《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中无散射角  $0^\circ$  的数据，表中所列散射角中以  $30^\circ$  最接近  $0^\circ$ ，故从该表中散射角为  $0^\circ$ 、管电压为 70kV、100kV 对应的  $a$  值采用内插法求取 80kV 对应的  $a$  值为 0.0009（该取值适用于机房顶面关注点相应预测计算）；

$S$ —主束在受照人体上的散射面积，根据建设单位提供参数，照射野最小为  $11\text{cm} \times 11\text{cm} = 121\text{cm}^2$ ，最大为  $30\text{cm} \times 38\text{cm} = 1140\text{cm}^2$ ，考虑手术需要的最大照射面积约为  $16\text{cm} \times 16\text{cm}$ ，本项目取  $256\text{cm}^2$ ；

$d_0$ —源至受照点的距离，根据设备参数确定，本项目球管的  $d_0$  取最小值

0.45m(符合 ICRP 33 号报告第 98 段关于使用固定式 X 线透视检查设备的焦皮距的要求)；

$d_s$ —受照体至关注点的距离，m；

$B_s$ —屏蔽材料对散射线的透射因子，无量纲，计算公式见式 11-2。此处散射线是指本项目常用最大管电压(80kV，即 0.08MV)下有用线束(初级 X 射线)的散射线，其能量偏保守取有用线束侧向(散射角 $\theta=90^\circ$ )的一次散射线能量，可借鉴康普顿散射定律计算一次散射线能量 E 与入射的初级 X 射线能量  $E_0$  之比  $E/E_0=1/[1+E_0(1-\cos\theta)/0.511]=1/[1+0.08\times(1-\cos90^\circ)/0.511]=0.865$ ，继而计算一次散射线能量 E 对应的 kV 值为  $80kV\times0.865=69.2kV$ ，近似取为 70kV。再将机房屏蔽体和介入操作人员防护用屏蔽物的铅当量厚度、表 11-1 中  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  值代入公式 11-2，计算相应的散射辐射屏蔽透射因子值，列于表 11-5；

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数，Sv/Gy，查《外照射放射防护剂量转换系数标准》(WS/T 830-2024)附录表 G.2，按前述  $90^\circ$  方向一次散射线能量对应的 kV 值为 70kV， $K$  值取 1.60。

将前述有关参数代入公式 11-3，计算 DSA 常用最大工况(管电压 80kV)运行时透视模式、摄影模式下 DSA 手术室外公众、控制室操作人员、机房内介入操作人员处散射辐射剂量率，计算结果见表 11-5。

表 11-5 DSA 手术室外注点处散射辐射剂量率计算结果

关注点位置	操作模式	$H_0$ ( $\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{h})$ )	$I$ (mA)	$X$ (mm)	$B_s$	$d_0$ (m)	$d_s$ (m)	$H_s$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )
1#—开发区院区 DSA 手术室东门外 30cm, 控制室	透视模式	■	■	■	■	■	■	2.16E-08
	摄影模式	■	■	■	■	■	■	5.40E-07
2#—开发区院区 DSA 手术室东墙外 30cm, 控制室	透视模式	■	■	■	■	■	■	6.19E-06
	摄影模式	■	■	■	■	■	■	1.55E-04
3#—开发区院区 DSA 手术室观察窗外 30cm, 操作位	透视模式	■	■	■	■	■	■	2.97E-08
	摄影模式	■	■	■	■	■	■	7.42E-07
4#—开发区院区 DSA 手术室东墙外 30cm, 设备间	透视模式	■	■	■	■	■	■	5.91E-06
	摄影模式	■	■	■	■	■	■	1.48E-04

5#—开发区院区 DSA 手术室南门外 30cm, 污物通道	透视模式							3.43E-08
	摄影模式							8.58E-07
6#—开发区院区 DSA 手术室南墙外 30cm, 污物通道	透视模式							6.95E-06
	摄影模式							1.74E-04
7#—开发区院区 DSA 手术室西墙外 30cm, 楼梯间	透视模式							5.86E-06
	摄影模式							1.47E-04
8#—开发区院区 DSA 手术室北墙外 30cm, 清洁走廊	透视模式							6.95E-06
	摄影模式							1.74E-04
9#—开发区院区 DSA 手术室防护大 门外 30cm, 清洁走 廊	透视模式							2.33E-08
	摄影模式							5.84E-07
10#—开发区院区 DSA 手术室楼地下 面 170cm 处, 配药 室、过道等	透视模式							1.84E-06
	摄影模式							4.59E-05
11#—开发区院区 DSA 手术室楼上地 面 100cm 处, 办公 室及过道等	透视模式							3.43E-09
	摄影模式							8.58E-08
12#—本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处, 控制室	透视模式							1.57E-08
	摄影模式							3.93E-07
13#—本部院区 DSA 手术室观察窗 外 30cm 处, 操作 位	透视模式							4.42E-08
	摄影模式							1.11E-06
14#—本部院区 DSA 手术室东墙外 30cm 处, 控制室	透视模式							9.21E-06
	摄影模式							2.30E-04
15#—本部院区 DSA 手术室东墙外 30cm 处, 换床间	透视模式							6.95E-06
	摄影模式							1.74E-04
16#—本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处, 换床间	透视模式							1.90E-08
	摄影模式							4.74E-07

17#—本部院区 DSA 手术室南墙外 30cm 处, 药房	透视模式							3.40E-06
	摄影模式							8.51E-05
18#—本部院区 DSA 手术室西墙外 30cm 处, 室外道路	透视模式							7.27E-06
	摄影模式							1.82E-04
19#—本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处, 污洗间	透视模式							1.36E-08
	摄影模式							3.40E-07
20#—本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处, 污洗间	透视模式							3.35E-06
	摄影模式							8.38E-05
21#—本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处, 库房	透视模式							1.69E-08
	摄影模式							4.24E-07
22#—本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处, 库房	透视模式							3.39E-06
	摄影模式							8.48E-05
23#—本部院区 DSA 手术室楼地下地 面 170cm 处, 库房	透视模式							1.84E-06
	摄影模式							4.59E-05
24#—本部院区 DSA 手术室楼上地 面 100cm 处, 诊室	透视模式							3.43E-09
	摄影模式							8.58E-08
第一 术者	铅衣内	透视模式						6.88
	铅衣外	透视模式						129.81
第二 术者	铅衣内	透视模式						3.06
	铅衣外	透视模式						57.69

## 2.关注点处泄漏辐射剂量率计算

泄漏辐射剂量率  $H_L$  采用下式计算:

$$H_L = \frac{H_i \cdot B}{r^2} \cdot K \quad \text{公式 11-4}$$

式中:  $H_L$ —关注点处泄漏辐射有效剂量率,  $\mu\text{Sv/h}$ ;

$H_i$ —距靶 1m 处泄漏射线的空气比释动能率,  $\text{mGy/h}$ 。本项目 1m 处泄漏射

线的空气比释动能率取 1.0mGy/h;

$B$ —机房各屏蔽体的泄漏射线屏蔽透射因子, 本项目 DSA 常用最大工况管电压 (80kV) 下机房屏蔽体及介入操作人员防护用屏蔽物的泄漏射线屏蔽透射因子见表 11-6;

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数, Sv/Gy, 查《外照射放射防护剂量转换系数标准》(WS/T 830-2024) 附录表 G.2, 对于本项目 DSA 运行时常用最大管电压 80kV,  $K$  值取 1.67。

将有关参数代入公式 11-4, 计算 DSA 常用最大工况 (管电压 80kV) 运行时透视模式、摄影模式下 DSA 机房外公众、控制室操作人员、机房内介入操作人员处泄漏辐射剂量率, 计算结果见表 11-6。

表 11-6 DSA 手术室外关注点处漏辐射剂量率计算结果

关注点位置	$H_i$ (mGy/h)	$X$ (mm)	$r$ (m)	$B$	$H_L$ ( $\mu$ Sv/h)
1#—DSA 手术室东门外 30cm, 控制室	█	█	█	█	4.01E-07
2#—DSA 手术室东墙外 30cm, 控制室	█	█	█	█	3.04E-05
3#—DSA 手术室观察窗外 30cm, 操作位	█	█	█	█	5.52E-07
4#—DSA 手术室东墙外 30cm, 设备间	█	█	█	█	2.91E-05
5#—DSA 手术室南门外 30cm, 污物通道	█	█	█	█	6.38E-07
6#—DSA 手术室南墙外 30cm, 污物通道	█	█	█	█	3.42E-05
7#—DSA 手术室西墙外 30cm, 楼梯间	█	█	█	█	2.88E-05
8#—DSA 手术室北墙外 30cm, 清洁走廊	█	█	█	█	3.42E-05
9#—DSA 手术室防护大门外 30cm, 清洁走廊	█	█	█	█	4.34E-07
10#—DSA 手术室楼下地面 170cm 处, 配药室、过道等	█	█	█	█	1.07E-05
11#—DSA 手术室楼上地面 100cm 处, 办公室及过道等	█	█	█	█	8.24E-08
12#—本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处, 控制室	█	█	█	█	2.92E-07
13#—本部院区 DSA 手术室观察窗外 30cm 处, 操作位	█	█	█	█	8.22E-07
14#—本部院区 DSA 手术室东墙外 30cm	█	█	█	█	4.53E-05

处, 控制室						
15#—本部院区 DSA 手术室东墙外 30cm 处, 换床间		█	█	█	█	3.42E-05
16#—本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处, 换床间		█	█	█	█	3.52E-07
17#—本部院区 DSA 手术室南墙外 30cm 处, 药房		█	█	█	█	1.67E-05
18#—本部院区 DSA 手术室西墙外 30cm 处, 室外道路		█	█	█	█	3.58E-05
19#—本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处, 污洗间		█	█	█	█	2.53E-07
20#—本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处, 污洗间		█	█	█	█	1.65E-05
21#—本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处, 库房		█	█	█	█	3.15E-07
22#—本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处, 库房		█	█	█	█	1.67E-05
23#—本部院区 DSA 手术室楼下地面 170cm 处, 库房		█	█	█	█	1.07E-05
24#—本部院区 DSA 手术室楼上地面 100cm 处, 诊室		█	█	█	█	8.24E-08
第一术者	铅衣内	█	█	█	█	2.39
	铅衣外	█	█	█	█	22.88
第二术者	铅衣内	█	█	█	█	1.06
	铅衣外	█	█	█	█	10.17

### 3.关注点处预测计算结果汇总

综上所述, 本项目 DSA 机房外关注点处的辐射剂量率理论估算结果汇总见表 11-7。

表 11-7 DSA 机房外关注点处辐射剂量率计算统计结果

关注点位置	操作模式	X 射线辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		
		散射线	漏射线	合计
1#—DSA 手术室东门外 30cm, 控制室	透视模式	2.16E-08	4.01E-07	4.23E-07
	摄影模式	5.40E-07		9.41E-07
2#—DSA 手术室东墙外 30cm,	透视模式	6.19E-06	3.04E-05	3.66E-05

控制室	摄影模式	1.55E-04		1.85E-04
3#—DSA 手术室观察窗外 30cm, 操作位	透视模式	2.97E-08	5.52E-07	5.81E-07
	摄影模式	7.42E-07		1.29E-06
4#—DSA 手术室东墙外 30cm, 设备间	透视模式	5.91E-06	2.91E-05	3.50E-05
	摄影模式	1.48E-04		1.77E-04
5#—DSA 手术室南门外 30cm, 污物通道	透视模式	3.43E-08	6.38E-07	6.72E-07
	摄影模式	8.58E-07		1.50E-06
6#—DSA 手术室南墙外 30cm, 污物通道	透视模式	6.95E-06	3.42E-05	4.11E-05
	摄影模式	1.74E-04		2.08E-04
7#—DSA 手术室西墙外 30cm, 楼梯间	透视模式	5.86E-06	2.88E-05	3.47E-05
	摄影模式	1.47E-04		1.75E-04
8#—DSA 手术室北墙外 30cm, 清洁走廊	透视模式	6.95E-06	3.42E-05	4.11E-05
	摄影模式	1.74E-04		2.08E-04
9#—DSA 手术室防护大门外 30cm, 清洁走廊	透视模式	2.33E-08	4.34E-07	4.57E-07
	摄影模式	5.84E-07		1.02E-06
10#—DSA 手术室楼下地面 170cm 处, 配药室、过道等	透视模式	1.84E-06	1.07E-05	1.26E-05
	摄影模式	4.59E-05		5.67E-05
11#—DSA 手术室楼上地面 100cm 处, 办公室及过道等	透视模式	3.43E-09	8.24E-08	8.58E-08
	摄影模式	8.58E-08		1.68E-07
12#—本部院区 DSA 手术室东 门外 30cm 处, 控制室	透视模式	1.57E-08	2.92E-07	8.38E-07
	摄影模式	3.93E-07		1.21E-06
13#—本部院区 DSA 手术室观 察窗外 30cm 处, 操作位	透视模式	4.42E-08	8.22E-07	8.66E-07
	摄影模式	1.11E-06		1.93E-06
14#—本部院区 DSA 手术室东 墙外 30cm 处, 控制室	透视模式	9.21E-06	4.53E-05	5.45E-05
	摄影模式	2.30E-04		2.75E-04
15#—本部院区 DSA 手术室东	透视模式	6.95E-06	3.42E-05	4.11E-05

	墙外 30cm 处, 换床间	摄影模式	1.74E-04		2.08E-04
16#	一本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处, 换床间	透视模式	1.90E-08	3.52E-07	3.71E-07
		摄影模式	4.74E-07		8.26E-07
17#	一本部院区 DSA 手术室南墙外 30cm 处, 药房	透视模式	3.40E-06	1.67E-05	2.02E-05
		摄影模式	8.51E-05		1.02E-04
18#	一本部院区 DSA 手术室西墙外 30cm 处, 室外道路	透视模式	7.27E-06	3.58E-05	4.30E-05
		摄影模式	1.82E-04		2.18E-04
19#	一本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处, 污洗间	透视模式	1.36E-08	2.53E-07	2.67E-07
		摄影模式	3.40E-07		5.93E-07
20#	一本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处, 污洗间	透视模式	3.35E-06	1.65E-05	1.98E-05
		摄影模式	8.38E-05		1.00E-04
21#	一本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处, 库房	透视模式	1.69E-08	3.15E-07	3.32E-07
		摄影模式	4.24E-07		7.39E-07
22#	一本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处, 库房	透视模式	3.39E-06	1.67E-05	2.01E-05
		摄影模式	8.48E-05		1.02E-04
23#	一本部院区 DSA 手术室楼下地面 170cm 处, 库房	透视模式	1.84E-06	1.07E-05	1.26E-05
		摄影模式	4.59E-05		5.67E-05
24#	一本部院区 DSA 手术室楼上地面 100cm 处, 诊室	透视模式	3.43E-09	8.24E-08	8.58E-08
		摄影模式	8.58E-08		1.68E-07
第一术者	铅衣内	透视模式	6.88	2.39	9.27
	铅衣外	透视模式	129.81	22.88	152.69
第二术者	铅衣内	透视模式	3.06	1.06	4.12
	铅衣外	透视模式	57.69	10.17	67.86

根据表 11-7 结果分析可知, 本项目开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室和本部院区九号楼一楼 DSA 手术室的屏蔽设计均能够满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020) 的要求。

### (三) 电缆沟、通排风管道辐射影响分析

本项目 DSA 机房电缆线布设采用电缆沟，通排风管道穿墙方式均为直穿式，为防止 X 射线泄漏，电缆孔处均拟设置 4mm 铅板（与防护门同等屏蔽防护）进行防护（接口处四周包封），通风及排风管道口均拟设置 4mm 铅板（与防护门同等屏蔽防护）进行防护（接口处进行包裹），管道系统均避开主射线方向，经过铅板屏蔽后，电缆沟、通排风管道出口处辐射剂量将在控制范围内。

### (四) 周围公众及辐射工作人员年有效剂量估算

#### 1. 年有效剂量估算模式

DSA 机房周围公众、控制室辐射工作人员年有效剂量计算采用联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）2000 年报告附录 A 中的计算公式进行估算：

$$H_{Er} = H_r \times T \times t \quad \text{公式 11-5}$$

式中： $H_{Er}$ —X 射线外照射年有效剂量，mSv/a；

$H_r$ —关注点处剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$T$ —居留因子；

$t$ —年照射时间，h。

DSA 机房内介入操作人员的外照射辐射年有效剂量计算借鉴《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）给出的公式进行估算：

$$E = \alpha H_u + \beta H_o \quad \text{公式 11-6}$$

式中： $\alpha$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.79，无屏蔽时，取 0.84；本项目取 0.79；

$H_u$ —铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，mSv；

$\beta$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.051，无屏蔽时，取 0.100；本项目取 0.051；

$H_o$ —铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，mSv。

#### 2. 年有效剂量估算

将有关参数代入公式 11-5，估算本项目 DSA 机房周围公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量，见表 11-8。

表 11-8 DSA 机房周围公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量

关注点位置	操作模式	$t$ (h)	$T$	辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	年有效剂量 $H_{Er}$ (mSv/a)
-------	------	---------	-----	-------------------------------	---------------------------

1#—DSA 手术室东门外 30cm, 控制室	透视模式	■		■	■	8.83E-08
	摄影模式	■		■	■	
2#—DSA 手术室东墙外 30cm, 控制室	透视模式	■		■	■	7.80E-06
	摄影模式	■		■	■	
3#—DSA 手术室观察窗外 30cm, 操作位	透视模式	■		■	■	1.21E-07
	摄影模式	■		■	■	
4#—DSA 手术室东墙外 30cm, 设备间	透视模式	■	■	■	■	1.40E-06
	摄影模式	■		■	■	
5#—DSA 手术室南门外 30cm, 污物通道	透视模式	■	■	■	■	5.26E-08
	摄影模式	■		■	■	
6#—DSA 手术室南墙外 30cm, 污物通道	透视模式	■	■	■	■	3.29E-06
	摄影模式	■		■	■	
7#—DSA 手术室西墙外 30cm, 楼梯间	透视模式	■	■	■	■	2.77E-06
	摄影模式	■		■	■	
8#—DSA 手术室北墙外 30cm, 清洁走廊	透视模式	■	■	■	■	3.29E-06
	摄影模式	■		■	■	
9#—DSA 手术室防护大门外 30cm, 清洁走廊	透视模式	■	■	■	■	3.58E-08
	摄影模式	■		■	■	
10#—DSA 手术室楼下一地面 170cm 处, 配药室、过道等	透视模式	■		■	■	8.01E-06
	摄影模式	■		■	■	
11#—DSA 手术室楼上一地面 100cm 处, 办公室及过道等	透视模式	■		■	■	5.37E-08
	摄影模式	■		■	■	
12#—本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处, 控制室	透视模式	■		■	■	1.74E-07
	摄影模式	■		■	■	
13#—本部院区 DSA 手术室观察窗外 30cm 处, 操作位	透视模式	■		■	■	1.81E-07
	摄影模式	■		■	■	

14#—本部院区 DSA 手术室东墙外 30cm 处，控制室	透视模式	■	■	■	■	1.16E-05
	摄影模式	■	■	■	■	
15#—本部院区 DSA 手术室东墙外 30cm 处，换床间	透视模式	■	■	■	■	6.57E-06
	摄影模式	■	■	■	■	
16#—本部院区 DSA 手术室东门外 30cm 处，换床间	透视模式	■	■	■	■	5.82E-08
	摄影模式	■	■	■	■	
17#—本部院区 DSA 手术室南墙外 30cm 处，药房	透视模式	■	■	■	■	1.29E-05
	摄影模式	■	■	■	■	
18#—本部院区 DSA 手术室西墙外 30cm 处，室外道路	透视模式	■	■	■	■	3.44E-06
	摄影模式	■	■	■	■	
19#—本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处，污洗间	透视模式	■	■	■	■	4.17E-08
	摄影模式	■	■	■	■	
20#—本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处，污洗间	透视模式	■	■	■	■	3.17E-06
	摄影模式	■	■	■	■	
21#—本部院区 DSA 手术室北门外 30cm 处，库房	透视模式	■	■	■	■	5.20E-08
	摄影模式	■	■	■	■	
22#—本部院区 DSA 手术室北墙外 30cm 处，库房	透视模式	■	■	■	■	3.21E-06
	摄影模式	■	■	■	■	
23#—本部院区 DSA 手术室楼下地面 170cm 处，库房	透视模式	■	■	■	■	2.00E-06
	摄影模式	■	■	■	■	
24#—本部院区 DSA 手术室楼上地面 100cm 处，诊室	透视模式	■	■	■	■	5.37E-08
	摄影模式	■	■	■	■	

由表 11-8 可知，本项目 DSA 手术室周围公众、控制室辐射工作人员的年附加剂量均不超过 0.01mSv，均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对公众的剂量限值要求和本项目剂量约束值要求。

将有关参数代入公式 11-6，计算第一术者、第二术者年有效剂量，结果列于表 11-9。

表 11-9 DSA 机房内术者位年有效剂量估算结果

位置	$\alpha$	$\beta$	部位	辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )			年照射时间 (h)	年有效剂量 (mSv)
				散射线	漏射线	合计		
第一术者	0.79	0.051	铅衣内	■	■	■	■	1.86
			铅衣外	■	■	■		
第二术者			铅衣内	■	■	■	■	0.46
			铅衣外	■	■	■		

第一术者位辐射工作由医生承担，第二术者位辐射工作由护士承担，则由表 11-9 计算结果可知，医生的年有效剂量最大为 1.86mSv；护士同室操作的剂量为 0.46mSv，隔室操作剂量保守参考控制室处可忽略不计，则护士的年有效剂量最大为 0.46mSv。上述结果均能满足工作人员剂量约束值 5mSv 的要求。

对于介入手术，由于其实际工作中 DSA 透视工况及操作时间的不确定性，辐射工作人员需要依靠佩戴个人剂量计进行跟踪监测才能准确地测定其受照剂量的大小，按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）要求进行佩戴，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员采用双剂量计监测方法，医院应加强对介入手术工作人员的个人剂量监测管理，在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。介入手术工作人员均按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）穿戴防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等），并充分利用自带的铅悬挂防护屏及床侧防护帘等做好自身防护，确保其年有效剂量满足标准限值要求。

综上所述，根据上述理论估算结果，本项目 DSA 机房在落实屏蔽防护措施后，对机房外辐射工作人员和周围公众的环境影响较小，同时在开展介入工作时，在采取有效的辐射防护措施和医院良好的管理情况下，辐射工作人员年有效剂量可以满足标准限值要求。

江苏省苏北人民医院现有 5 台 DSA 已投入使用，医院已配置 38 名 DSA 公众人员，含医生 22 人、护士 8 人、技师 8 人，由医院统一调配。根据医院提供资料，2025 年度 DSA 手术总量为 8734 台，平均每台 DSA 承担 1746 台手术量，平均每名医生承担 397 台、每名技师承担 1092 台、每名护士承担 1092 台手术量，工作负荷较高。根

据医院提供的个人剂量监测报告（详见附件9），近期一年内 DSA 工作人员的累积剂量均符合工作人员 5mSv/a 的剂量约束值要求。本次扩建 2 台 DSA 后，医院将有 7 台 DSA 共同分担介入手术工作；医院拟新招聘 8 名医生、4 名护士和 4 名技师，即使考虑到手术量增长，也可使 DSA 工作量控制在 1500 台/年，则每名工作量可控制在 300 台/年，护士和技师工作量可控制在 500 台/年，相比现有 DSA 工作人员工作负荷将会降低，则本项目投运后工作人员累计剂量相比 2025 年度将会降低，也能满足本项目剂量约束值要求。

## 二、三废的治理评价

### （一）废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。本项目 DSA 手术室均设计有动力通风装置，少量臭氧和氮氧化物可通过动力通风装置排至室外。臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，氮氧化物产量约为臭氧的三分之一，这部分废气对周围环境影响较小。

### （二）废水

工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理。

### （三）固体废物

工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理。

本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，由医院统一委托有资质单位进行处置。

## 事故影响分析

### 一、主要事故风险

本项目新增的 DSA 为 II 类射线装置，医院在开展医疗诊断和介入治疗过程中，如果安全管理或防护不当，可能对误入机房的受照人员产生较严重放射损伤。因此本项目主要事故风险为：

（一）在介入手术操作过程中，有未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品的公众误留手术室，室内人员位于手术室床旁，导致发生误照射；

（二）DSA 控制系统失灵持续摄影，而此时手术室内人员未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品，室内人员位于手术室床旁，导致发生误照射；

(三) 设备维护人员在维护 DSA 射线管或测量探测器时, 射线管正处于出束状态, 维修人员处于机头上方, 导致发生误照射;

(四) 防护门未关闭或未完全关闭到位, DSA 即出束照射, 使机房外的工作人员或公众受到误照射, 当个人剂量报警仪未正确使用或设备失效时, 不能及时发现事故状态, 使误照射剂量大幅增加;

(五) DSA 长期运行后, 机房墙体防护材料可能老化脱落, 防护门缝隙可能变大, 观察窗缝隙胶条可能老化失效使铅玻璃与窗框不能紧密贴合产生旷量、缝隙, 这些情况导致机房防护能力下降、射线泄漏, 若医院未按计划进行日常自主监测或自主监测仪器失效未能发现射线泄漏的情况, 会使机房周围人员长期受到异常照射。

## 二、事故预防和处理措施

医院可采取以下事故预防措施:

(一) 建立辐射安全管理机构, 制定完善的规章制度, 并在实际工作过程中严格执行;

(二) 加强辐射安全管理, 加强辐射工作人员技能培训和辐射安全与防护知识的培训, 提高个人的技能和辐射安全防范意识;

(三) 定期检查各辐射工作场所的辐射安全措施运行情况, 确保各项安全措施始终保持良好的工作状态;

(四) 个人剂量报警仪、辐射巡测仪等自主监测设备按要求定期检定/校准, 使其能正常、有效工作, 加强工作人员对自主监测仪器的使用培训;

(五) 按要求落实监测计划, 定期对工作场所辐射水平进行监测并保留监测记录。

针对本项目可能发生的辐射事故, 可采取以下处理措施:

(一) 当发生误照射时, 应立即按下急停开关, 确保 DSA 停止工作;

(二) 对工作人员造成额外照射时, 应及时检测个人剂量计, 剂量超标则人员应及时就医检查并调岗;

(三) 对发生事故的 DSA 或其他设备故障, 请设备厂家或相关单位进行维修, 分析事故发生原因, 不得擅自进行维修。

医院应定期对 DSA 机房辐射安全措施进行检查、维护, 发现问题及时维修; 每次工作前均应检查相应辐射安全装置的有效性, 定期对工作场所进行检测。医院还应在平时工作中加强工作人员的辐射防护知识的培训, 尽可能避免辐射事故的发生。

医院应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，在事故发生后1小时内向所在地生态环境和公安部门报告，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》。造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；对于可能受到大剂量照射的人员，迅速安排医学检查和救治，积极配合政府管理部门做好事故调查和善后工作。

表 12 辐射安全管理

### 辐射安全与环境保护管理机构的设置

江苏省苏北人民医院扩建 2 台 DSA 用于开展医疗诊断和介入治疗, DSA 属 II 类射线装置。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求, 使用 II 类射线装置的单位, 应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构, 或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作, 并以文件形式明确管理人员职责。从事辐射工作的人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并参加考核。

江苏省苏北人民医院已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构, 指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作, 组员覆盖各辐射科室, 并以文件形式明确管理人员职责。医院应根据本次扩建 2 台 DSA 项目修订相关文件, 明确医院相关辐射项目的管理人员及其职责, 将该项目辐射安全管理纳入全院的辐射安全管理工作中。本项目辐射工作人员和医院辐射安全管理人员均需通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规, 辐射工作人员参加“医用 X 射线诊断与介入放射学”类、辐射安全管理人员参加“辐射安全管理”类辐射安全与防护考核, 并取得培训合格证书后方可上岗。医院应及时关注辐射工作人员辐射安全和防护专业知识的培训时间, 如有辐射培训证书到期人员还应及时参加生态环境部的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并通过考核。

### 辐射安全管理规章制度

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的有关要求, 使用放射源和射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等, 并有完善的辐射事故应急措施”。目前江苏省苏北人民医院已制定相关辐射安全与防护管理制度, 如《苏北人民医院放射质量控制与安全防护管理制度》《苏北人民医院个人剂量监测管理制度》《苏北人民医院放射工作人员的放射防护要求》《介入放射安全管理制度》《辐射事故应急处置预案》《放射工作人员职业健康管理制度》《关于调整职业卫生管理领导小组和委

员会成员的通知》等，医院现有管理制度内容较为全面，基本满足医院从事相关辐射活动辐射安全和防护管理的要求。医院拟根据扩建 2 台 DSA 项目的特点及以下内容制定并完善相关制度，并落实到实际工作中，严格执行，加强辐射安全管理。

### **1.操作规程**

医院拟制定《DSA 操作规程》，明确辐射工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的具体防护措施及步骤。重点是：

(1) 确保开展辐射工作时所有辐射屏蔽措施均已到位，严格按照规定操作流程操作，防止发生辐射事故；

(2) 从事辐射工作时必须佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪；

(3) 在工作场所严禁吸烟、进食。

### **2.岗位职责**

医院拟制定《放射诊疗工作人员职责》，明确射线装置使用工作人员、台账管理人员及辐射安全管理人员的岗位责任，并落实到个人，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任。

### **3.辐射防护和安全保卫制度**

医院已根据射线装置的具体情况制定《苏北人民医院放射质量控制与安全防护管理制度》。重点是：

(1) 定期检查相关的辐射安全装置及检测仪器，发现问题及时修理或更换，确保辐射安全措施/设施、个人剂量报警仪、环境辐射剂量监测仪保持良好工作状态；

(2) 工作人员定期开展个人剂量监测和职业健康监护。

### **4.设备检修维护制度**

医院拟制定《设备维护检修制度》，明确射线装置和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，并做好记录。确保射线装置、安全措施（警示标志、工作状态指示灯、急停按钮）、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。

### **5.人员培训计划和健康管理制**

医院拟制定《放射工作人员培训制度》，明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。相关辐射工作人员应及时学习最新的国家政策法规及标准，熟练掌握辐射防护知识、最新的操作技术。根

据 18 号令及《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并通过考核。医院已制定《放射工作人员职业健康管理制度》，组织辐射工作人员定期参加职业健康体检（不少于 1 次/2 年），并为其建立辐射工作人员职业健康监护档案。

### 6. 辐射环境监测方案

医院拟制定《辐射环境监测方案》，明确监测频次和监测项目，按照有关标准、规范的要求定期对工作场所及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测，发现异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告；委托有资质监测单位对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度检测，每年 1 月 31 日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，年度评估发现安全隐患的，应当立即整改。

### 7. 个人剂量监测

医院已制定《苏北人民医院个人剂量监测管理制度》，委托有资质单位对辐射工作人员开展个人剂量监测，监测周期不少于 1 次/三个月。辐射工作人员个人剂量监测数据应建立个人剂量档案，依据《江苏省辐射污染防治条例》（2018 年修正），在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。

本项目辐射工作人员应在医院辐射安全与防护领导小组的领导下，继续明确各人员岗位职责，严格落实辐射安全管理规章制度，定期对设备的辐射安全措施进行检查。医院在之后的实际工作中还应不断根据法律法规及实际情况对各项管理制度进行补充和完善，使其具有较强的针对性和可操作性。

## 辐射监测

根据辐射管理要求，江苏省苏北人民医院本部院区、开发区院区已各配备辐射巡测仪 1 台，拟为本项目 2 台各配备个人剂量报警仪 1 台，用于辐射防护监测和报警。自主监测仪器应按规定进行定期检定/校准，同时结合本项目实际情况，拟制定如下监测计划：

一、委托有资质的单位定期对项目周围环境 X- $\gamma$  辐射剂量率进行监测，周期：1~2 次/年；

二、辐射工作人员配备个人剂量计监测累积剂量，定期（不少于1次/3个月）送有资质机构进行个人剂量监测，建立个人剂量档案；

三、定期使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，包括控制室工作位置和周围毗邻区域人员居留处，并保留自检记录；

四、所有辐射工作人员上岗前进行职业健康体检，以排除职业禁忌证。开展辐射工作后，定期开展职业健康体检（不少于1次/2年），并建立个人职业健康档案；

五、出现外照射事故，立即采取应急措施，并在1小时之内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

医院辐射工作场所监测计划一览表见表12-1。

表12-1 工作场所监测计划一览表

监测对象	监测项目	监测点位	监测类别	监测周期	监测方式
本项目2台DSA手术室	X-γ辐射剂量率	距墙体、门、窗表面30cm，楼上地面100cm，楼下地面170cm；操作位、电缆口外	验收监测	竣工后3个月内	委托有资质单位监测
			日常监测	不少于1次/3个月	自主监测
			年度监测	1~2次/年	委托有资质单位监测
辐射工作人员	个人剂量当量	/	日常监测	1次/3个月	委托有资质单位监测

江苏省苏北人民医院已根据上述监测计划，明确监测项目，定期（不少于1次/季）使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，并保留自检记录，每年委托有资质的单位定期对项目周围环境X-γ辐射剂量率进行监测，监测结果上报生态环境行政主管部门。2025年度医院已开展辐射工作场所的辐射安全与防护年度监测，监测结果均符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）、《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）、《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121-2020）、《放射治疗辐射防护与安全要求》（HJ 1198-2021）等国家相关标准要求，均未出现剂量率超标的情况。

江苏省苏北人民医院已为现有辐射工作人员配备个人剂量计，组织辐射工作人员进行个人剂量监测（1次/3个月）和职业健康体检（1次/2年），辐射安全领导管理小组负责全医院辐射工作人员个人剂量的收发和管理，职业健康监护、个人剂量监测档案均存放于公卫科。2025年度医院已委托南京瑞森辐射技术有限公司完成了辐射工

作人员的个人剂量监测，所有辐射工作人员监测结果均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）等国家相关标准要求，均未出现异常。

江苏省苏北人民医院每年编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，包括射线装置台账、辐射安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容，每年1月31日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。

根据医院《2025年度安全和防护状况年度评估报告》显示，2025年度医院未发生辐射事故，医院辐射安全和防护设施运行良好，定期开展了维护工作，定期检查防护情况，发现的隐患及时处理；医院已制定和完善了相应辐射安全和防护制度及措施，各项制度和措施得到了落实。医院自开展核技术利用项目以来未发生过辐射事故，暂无需要改进完善的情况。

## 辐射事故应急

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关规定，辐射事故应急预案应明确以下几个方面：

- 一、应急机构和职责分工；
- 二、应急的具体人员和联系电话；
- 三、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；
- 四、辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；
- 五、辐射事故调查、报告和处理程序。

对于在医院定期监测或委托监测时发现异常情况时，应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，在1小时之内向所在地生态环境和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的还应当同时向卫生健康部门报告。在发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。

江苏省苏北人民医院已经制定了《江苏省苏北人民医院辐射事故\事件应急预案》，该预案已包括成立辐射事故应急处理领导小组、应急预案领导小组的职责、放射性事故应急处理的责任划分、放射性事故应急处理程序和放射性事故的调查等内容。由辐

射事故应急处理领导小组组织辐射工作人员，定期（1次/年）开展应急培训演练，在物资、通讯、技术、人员、经费等准备方面均加以落实。医院开展核技术利用项目至今，未发生辐射事故。

表 13 结论与建议

## 结论

### 一、项目概况

江苏省苏北人民医院拟将本部院区九号楼一楼现有外科诊室、骨科诊室等区域改造为 1 间 DSA 机房及配套辅助用房并拟配备 1 台 Allia IGS Pulse 型 DSA，单球管，其最大管电压为 125kV，最大管电流为 1000mA；拟于开发区院区医技楼三楼新建 1 间 DSA 机房及配套辅助用房并拟配备 1 台 Optima IGS Ultra 型 DSA，单球管，其最大管电压为 125kV，最大管电流为 1000mA。DSA 属 II 类射线装置。

### 二、实践正当性

本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

### 三、项目产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年修改）中“限制类”“淘汰类”项目，项目符合国家产业政策。

### 四、选址布局合理性

江苏省苏北人民医院本部院区位于扬州市广陵区南通西路 98 号，本部院区东侧为汶河南路及临街商铺，南侧为南通西路，西侧为淮海路，北侧为甘泉路。

本部院区扩建的 DSA 位于九号楼一楼，九号楼位于院区东南部，九号楼东侧、南侧均为院区道路，西侧为院区道路和门诊楼，北侧为院区道路及五号楼（脑科医疗中心）。DSA 拟建址现为外科诊室、骨科诊室等区域，改造后，DSA 手术室东侧为控制室、换床间，南侧为药房，西侧为楼外道路，北侧为污洗间及库房，楼上为诊室，楼下为库房。

本部院区扩建的 DSA 周围 50m 评价范围东侧至院外汶河南路及临街商铺（立聪堂助听器店、耳聪听力助听器店），南侧、西侧、北侧均位于本部院区边界内。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、汶河南路和临街商铺的其他公众等。

本项目周围无显著环境制约因素，选址基本合理；DSA 均配套独立用房，房间由

射线装置机房和控制室组成，控制室与机房分开布置，区域划分明确，项目布局合理。

## 五、辐射环境现状评价

江苏省苏北人民医院本部院区扩建 2 台 DSA 项目拟建址及其周围环境 $\gamma$ 辐射剂量率检测结果均处于江苏省全省环境天然 $\gamma$ 辐射水平调查结果范围内，无异常情况。

## 六、环境影响评价

根据理论估算结果，江苏省苏北人民医院扩建 2 台 DSA 项目在做好个人防护措施和安全措施的情况下，项目对辐射工作人员及周围的公众产生的年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求和本项目剂量约束值要求（职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv）。

## 七、“三废”的处理处置

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。本项目 DSA 手术室均设计有动力通风装置，少量臭氧和氮氧化物可通过动力通风装置排至室外。臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，氮氧化物产量约为臭氧的三分之一，这部分废气对周围环境影响较小；工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小；本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。

## 八、主要污染源及拟采取的主要辐射安全防护措施

DSA 产生的 X 射线为主要辐射环境污染因素。本项目 DSA 机房入口处均设置“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明；DSA 手术室防护门均设有自动闭门装置，防护大门设有防夹功能，防护大门上方拟设置工作状态指示灯，且工作状态指示灯与机房门设置有效关联；控制室和机房内的治疗床边均设置急停按钮；控制室与手术室之间的墙体上设置有观察窗，控制室与手术室内设置双向语音对讲装置；医院本部院区、开发区院区均已配备有辐射巡测仪 1 台，医院拟为本项目辐射工作人员配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、剂量报警仪、个人剂量计等辐射防护装置及个人防护用品，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的安全管理要求。

## 九、辐射安全管理评价

江苏省苏北人民医院已设立辐射安全与环境保护管理机构,指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作,并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院已制定辐射安全管理制度,建议根据本报告的要求,对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,建立符合医院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度,并在日常工作中落实。

江苏省苏北人民医院拟为本项目辐射工作人员配置个人剂量计,定期送有资质单位监测个人剂量,建立个人剂量档案;定期进行职业健康检查,建立个人职业健康监护档案。医院本部院区、开发区院区均已配备有辐射巡测仪 1 台,拟为本项目 2 台 DSA 各配备个人剂量报警仪 1 台。此外,医院拟根据相关标准要求,为本项目工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述,江苏省苏北人民医院扩建 2 台 DSA 项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后,医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施,其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求,从环境保护角度论证,本项目的建设和运行是可行的。

## 建议和承诺

一、该项目运行中,应严格遵循操作规程,加强对操作人员的培训,杜绝麻痹大意思想,以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响,使对环境的影响降低到最低。

二、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行,严格按国家有关规定要求进行操作,确保其安全可靠。

三、定期进行辐射工作场所的检查及监测,及时排除事故隐患。

四、医院取得本项目环评批复后,应及时重新申领辐射安全许可证,按照法规要求开展竣工环境保护验收工作,环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月,最长不超过 12 个月。

## 辐射污染防治“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施	预期效果	预计投资 (万元)
辐射安全管理机构	建立辐射安全与环境保护管理机构，或配备不少于1名大学本科以上学历人员从事辐射保护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。	/
辐射安全和防护措施	屏蔽措施：DSA 机房四侧墙体采用轻钢龙骨+铅板、顶面采用混凝土+铅板、地面采用混凝土+硫酸钡水泥进行辐射防护，各防护门均采用铅防护门，观察窗均采用铅玻璃进行辐射防护。详见表10-1。	满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目剂量约束值要求。	195
	安全措施：本项目 DSA 机房入口处设置“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明；本部院区九号楼一楼 DSA 手术室防护大门为电动推拉式机房门、防护小门为手动平开门，开发区院区医技楼三楼 DSA 手术室防护门均为电动推拉式机房门，上述防护门均设有自动闭门装置，防护大门设有防夹功能，防护大门上方拟设置工作状态指示灯，且工作状态指示灯与机房门设置有效关联；控制室和机房内的治疗床边均设置急停按钮；控制室墙体上设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况；控制室设置对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流。	满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。	
人员配备	辐射安全管理人员和辐射工作人员通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并考核，考核合格后上岗。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。	/
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计，并定期送检（两次监测的时间间隔不应超过3个月），加强个人剂量监测，建立个人剂量档案。		
	辐射工作人员定期进行职业健康体检（不少于1次/2年），并建立辐射工作人员职业健康档案。		
监测仪器和防护用品	本部院区、开发区院区均已配备辐射巡测仪1台。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求。	1
	拟配备个人剂量报警仪2台		
	DSA 介入医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等，同时设置铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等	满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。	4

	防护用品。		
辐射安全管理制度	制定操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度：根据环评要求，按照项目的实际情况，补充相关内容，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》有关要求。	/
总计	/	/	200

以上污染防治的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

